




HOSPITAL EL ALTO SUR

ELECTROMEDICINA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA

Electrocardiografo

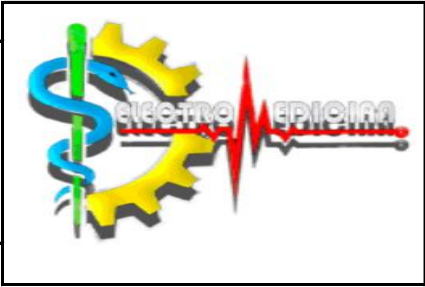

DATOS DEL EQUIPO		
UBICACIÓN:	Especialidades Clinicas	
SERVICIO:	fsfafsasf	
MARCA:	Nihon Kohden	
MODELO:	ECG-2150	
COD. ACTIVOS FIJOS:	asfasfasf	
PROCEDENCIA:	sfasf	
FABRICANTE:	asfasf	
GARANTIA:	Sin Garantía	
DATOS PROVEEDOR:	sf	
SERIE:	asfasfa	
AÑO FABRICACIÓN:	asfsf	
FECHA INSTALACIÓN:	2026-03-05	

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO		TECNOLOGIA PREDOMINANTE		CATEGORIZACIÓN	I	II	III		
VOLTAJE: POTENCIA REAL CONSUMIDA: FRECUENCIA DE RED: PESO: CORRIENTE: PUERTOS PARA TRANSDUCTORES: DIMENSIONES: RESOLUCIÓN DEL MONITOR:	ELÉCTRICO:	☐	HIDRÁULICO:	☒	1	Intercambiabilidad			X
	ELECTRÓNICO:	☒	NEUMÁTICO:	☐	2	Régimen operación			X
	MECÁNICO:	☐	VAPOR:	☐	3	Nivel de utilización			X
	TIPO ADQUISICIÓN		TIPO DE EQUIPO	4	Parámetro principal			X	
	COMPRA:	☐	FIJO:	☐	5	Mantenibilidad			X
	COMODATO:	☒	MOVIL:	☒	6	Conservabilidad			X
	DONACIÓN:	☐	PORTATIL:	☐	7	Grado de automatización			X
	EXISTENCIA DE REPUESTOS			8	Valor de compra			X	
	1			9	Factibilidad apropto			X	
	2			10	Seguridad operacional			X	
	3			11	Condiciones de explot.			X	
	4			12	Protección de MA			X	
	5			13	Edad del equipo			X	
				Categoría				X	

CONTEXTO OPERACIONAL	FUNCIONES DEL EQUIPO MEDICO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES A REALIZAR SI EL FALLO NO SE PUEDE PREVENIR
FALLAS FUNCIONALES	CAUSAS DE FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTOS DEL FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTO DE FALLO DEL EQUIPO EN EL ENTORNO

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR	REVISADO POR