

N.




HOSPITAL EL ALTO SUR

ELECTROMEDICINA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA

Autoclave

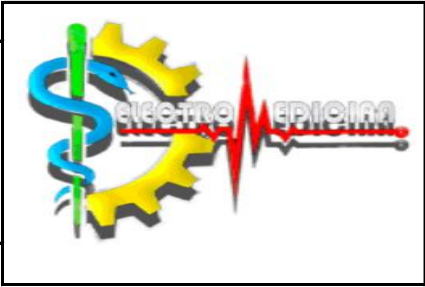

DATOS DEL EQUIPO			
UBICACIÓN:	Especialidades Clinicas		
SERVICIO:	baja		
MARCA:	Jibimed		
MODELO:	YX-24LD		
COD. ACTIVOS FIJOS:	baja		
PROCEDENCIA:	baja		
FABRICANTE:	baja		
GARANTIA:	Sin Garantía		
DATOS PROVEEDOR:	baja		
SERIE:	baja		
AÑO FABRICACIÓN:	asdasd		
FECHA INSTALACIÓN:	2026-07-14		



DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO		TECNOLOGIA PREDOMINANTE		CATEGORIZACIÓN	I	II	III		
VOLTAJE: POTENCIA REAL CONSUMIDA: FRECUENCIA DE RED: PESO: CORRIENTE: PUERTOS PARA TRANSDUCTORES: DIMENSIONES: RESOLUCIÓN DEL MONITOR:	ELÉCTRICO:	☐	HIDRÁULICO:	☐	1	Intercambiabilidad			X
	ELECTRÓNICO:	☒	NEUMÁTICO:	☐	2	Régimen operación			X
	MECÁNICO:	☐	VAPOR:	☐	3	Nivel de utilización			X
	TIPO ADQUISICIÓN		TIPO DE EQUIPO		4	Parámetro principal			X
	COMPRA:	☐	FIJO:	☒	5	Mantenibilidad			X
	COMODATO:	☒	MOVIL:	☐	6	Conservabilidad			X
	DONACIÓN:	☐	PORTATIL:	☐	7	Grado de automatización			X
EXISTENCIA DE REPUESTOS				8	Valor de compra			X	
1	Bateria recargable 12V			9	Factibilidad apropto			X	
2				10	Seguridad operacional			X	
3				11	Condiciones de explot.			X	
4				12	Protección de MA			X	
5				13	Edad del equipo			X	
				Categoría				X	

CONTEXTO OPERACIONAL	FUNCIONES DEL EQUIPO MEDICO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES A REALIZAR SI EL FALLO NO SE PUEDE PREVENIR

FALLAS FUNCIONALES	CAUSAS DE FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTOS DEL FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTO DE FALLO DEL EQUIPO EN EL ENTORNO

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR	REVISADO POR