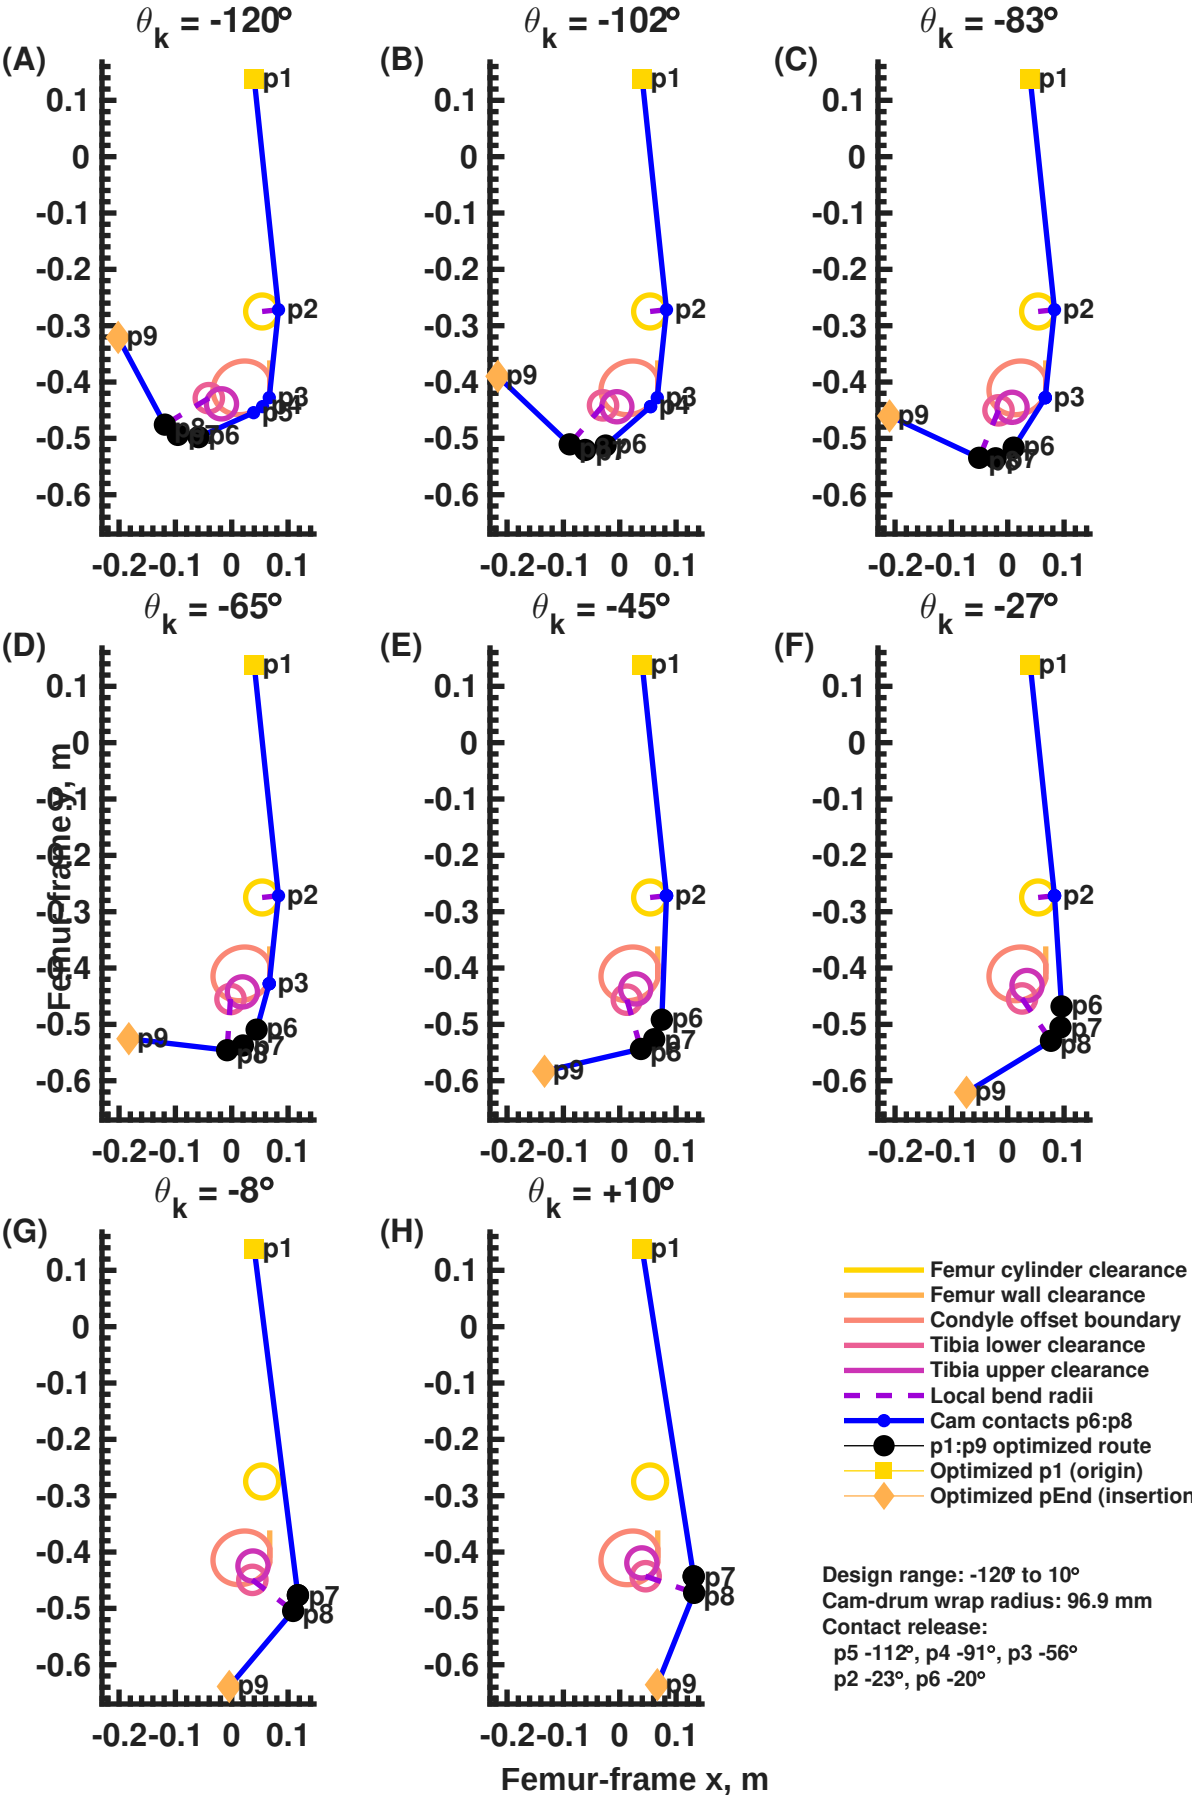

(A) θk = -120°
(B) θk = -102°
(C) θk = -83°
(D) θk = -65°
(E) θk = -45°
(F) θk = -27°
(G) θk = -8°
(H) θk = +10°
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
Femur-frame y, m
Femur-frame x, m
Femur cylinder clearance
Femur wall clearance
Condyle offset boundary
Tibia lower clearance
Tibia upper clearance
Local bend radii
Cam contacts p6:p8
p1:p9 optimized route
Optimized p1 (origin)
Optimized pEnd (insertion
Design range: -120° to 10°
Cam-drum wrap radius: 96.9 mm
Contact release:
p5 -112°, p4 -91°, p3 -56°
p2 -23°, p6 -20°