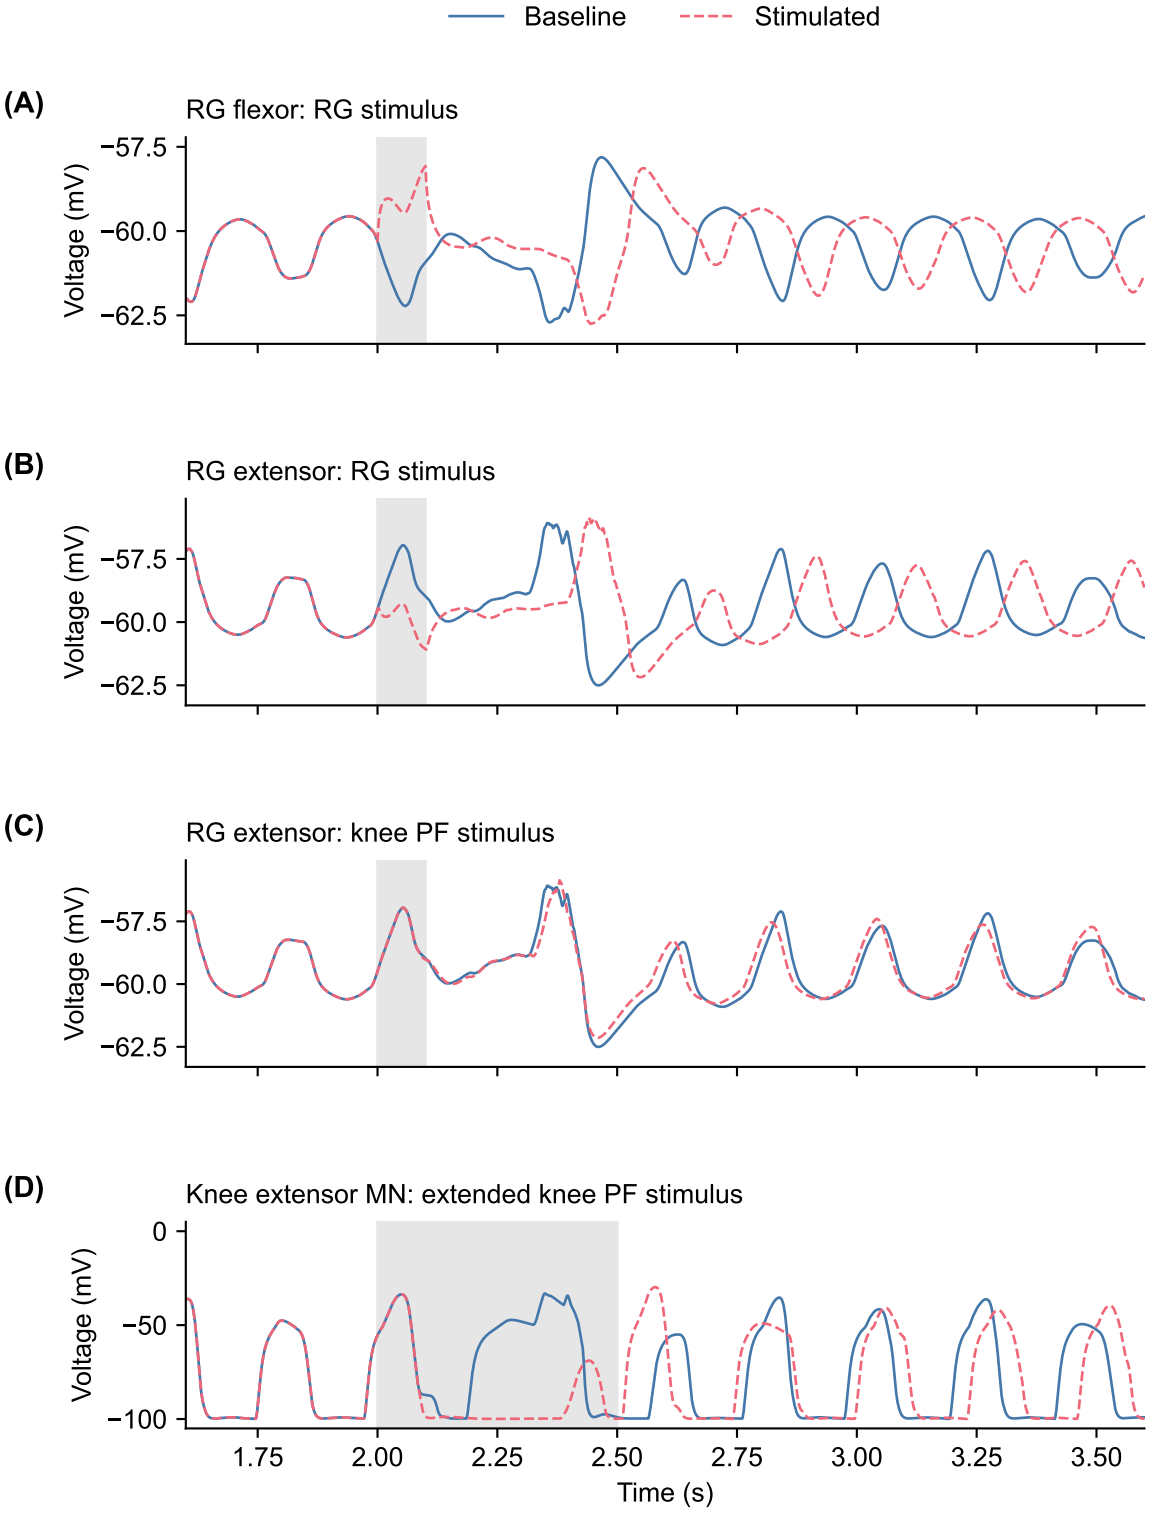
Baseline
Stimulated
(A)
RG flexor: RG stimulus
Voltage (mV)
−57.5
−60.0
−62.5
(B)
RG extensor: RG stimulus
Voltage (mV)
−57.5
−60.0
−62.5
(C)
RG extensor: knee PF stimulus
Voltage (mV)
−57.5
−60.0
−62.5
(D)
Knee extensor MN: extended knee PF stimulus
Voltage (mV)
0
−50
−100
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
Time (s)