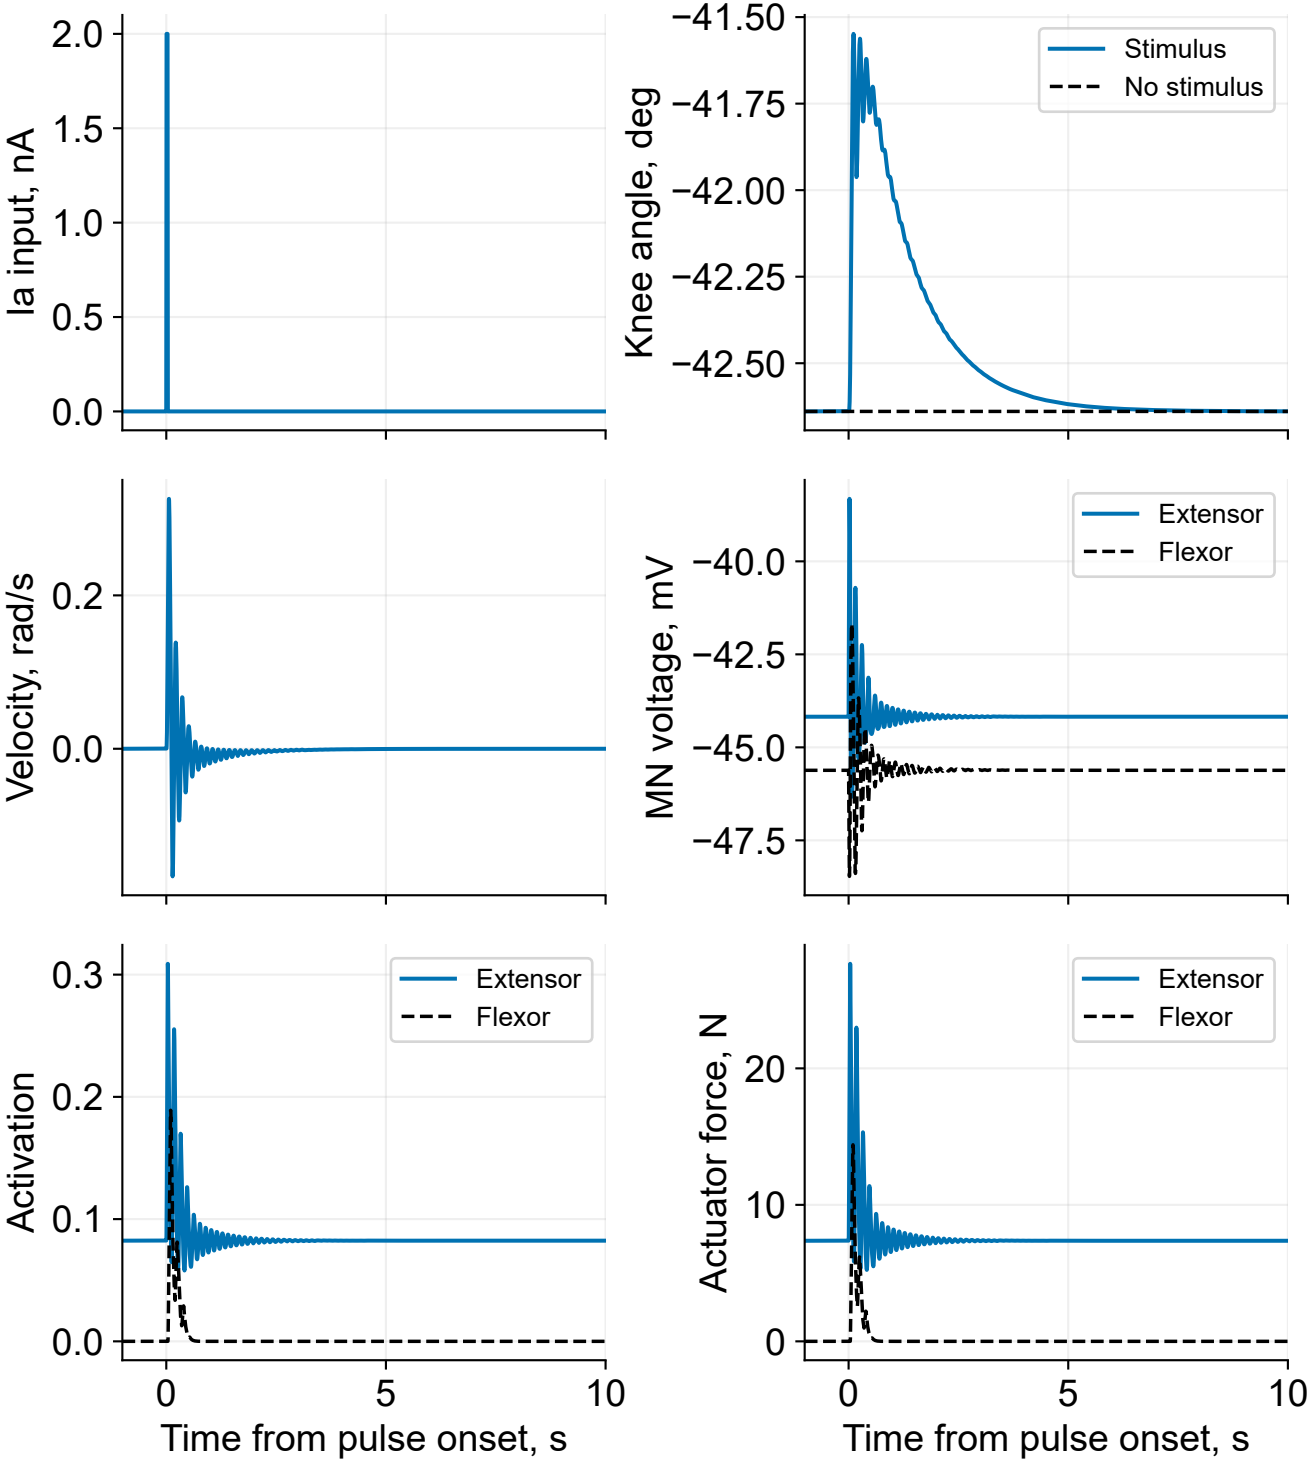
Ia input, nA
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Knee angle, deg
−41.50
−41.75
−42.00
−42.25
−42.50
Stimulus
No stimulus
Velocity, rad/s
0.2
0.0
MN voltage, mV
−40.0
−42.5
−45.0
−47.5
Extensor
Flexor
Activation
0.3
0.2
0.1
0.0
Actuator force, N
20
10
0
0
5
10
Time from pulse onset, s