
(a) OCT Instrument

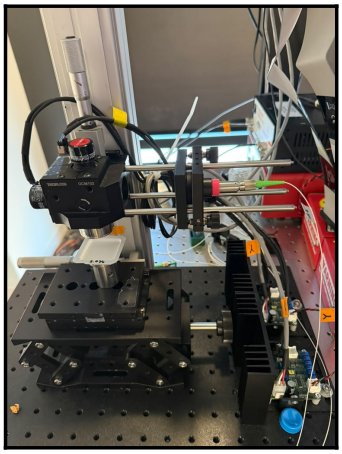

(b) OCT Parameters

$\lambda_0 = 1300\,\text{nm}$

$\Delta\lambda = 95\,\text{nm}$


NA ≈ 0.05

$\tilde{z}_{\text{FP, H}} = 201\,\text{px}, \quad \tilde{z}_{\text{FP, L}} = 130\,\text{px}$


Avg. N. Floor = 81 dB

Pixel size = $7.35\,\mu\text{m}$


(c) Liquid Intralipid Phantoms

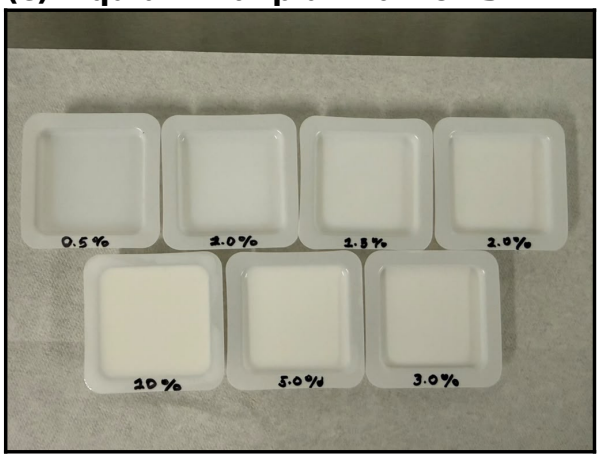


(d) OCT Phantom (3% Liquid IL)

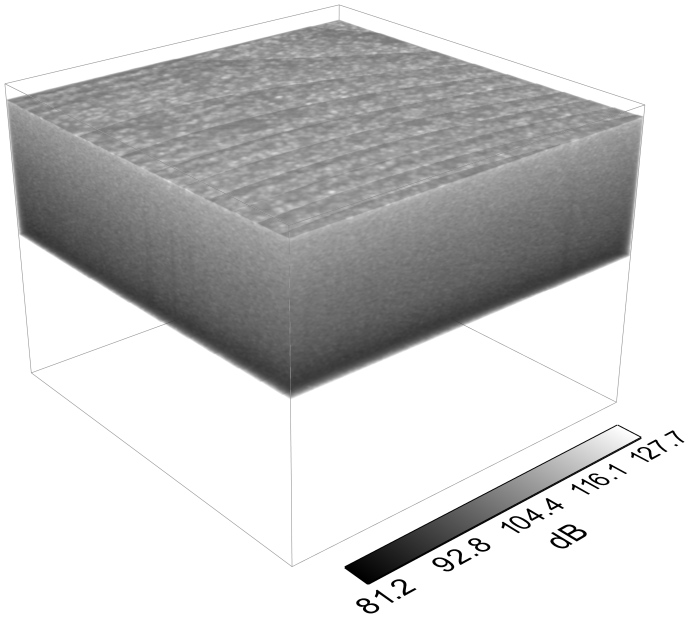

(e) Recovered μ (SS)

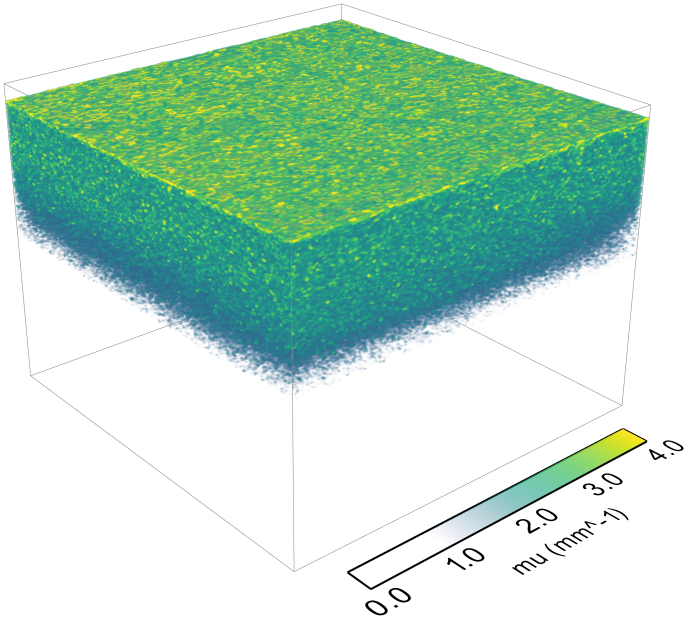

(f) Intralipid Concentration

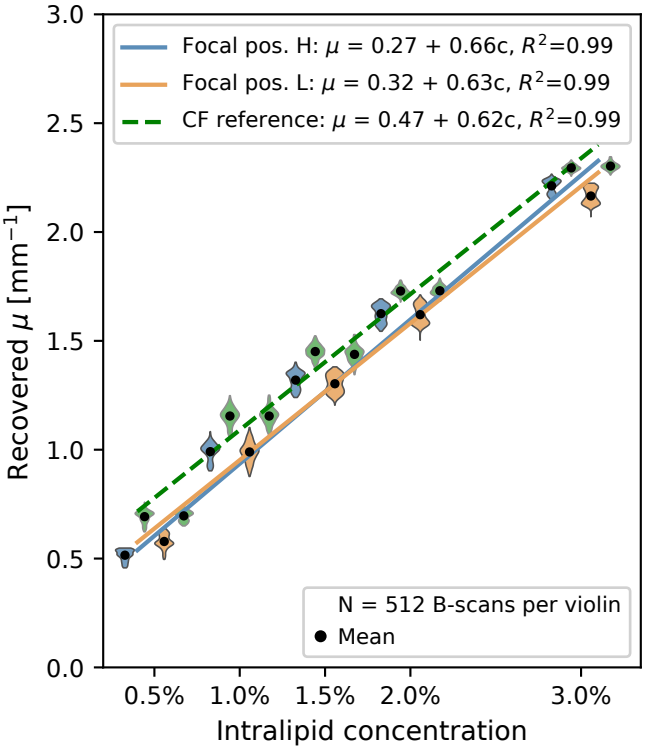

(g) Example A-lines

