
信号発生装置



正弦波


振幅2V

周波数100Hz

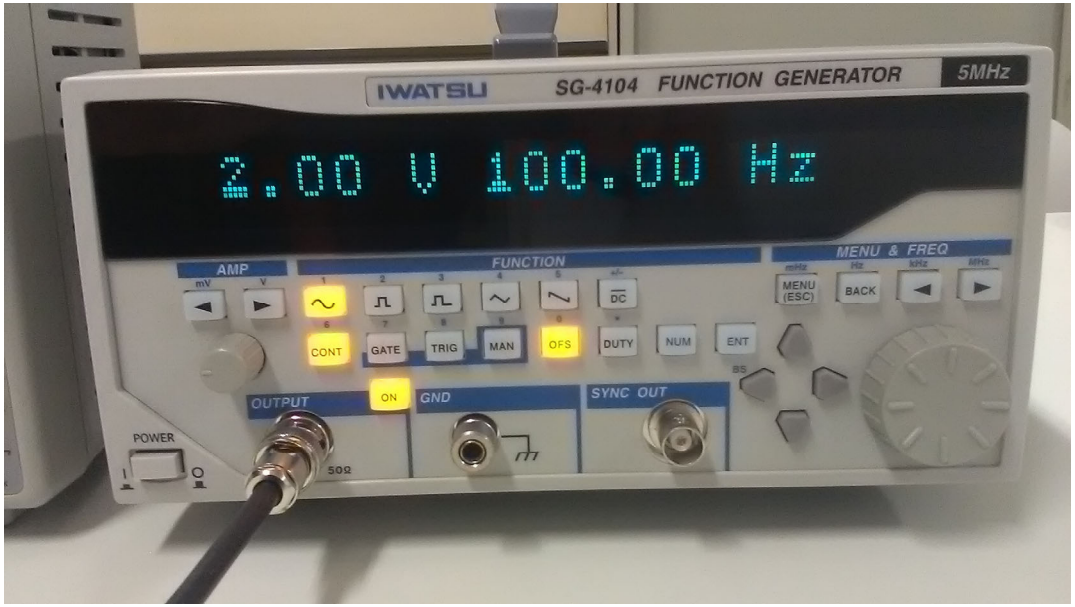


オフセット
（テキストではバイアス1V）

オシロスコープ（1/4）

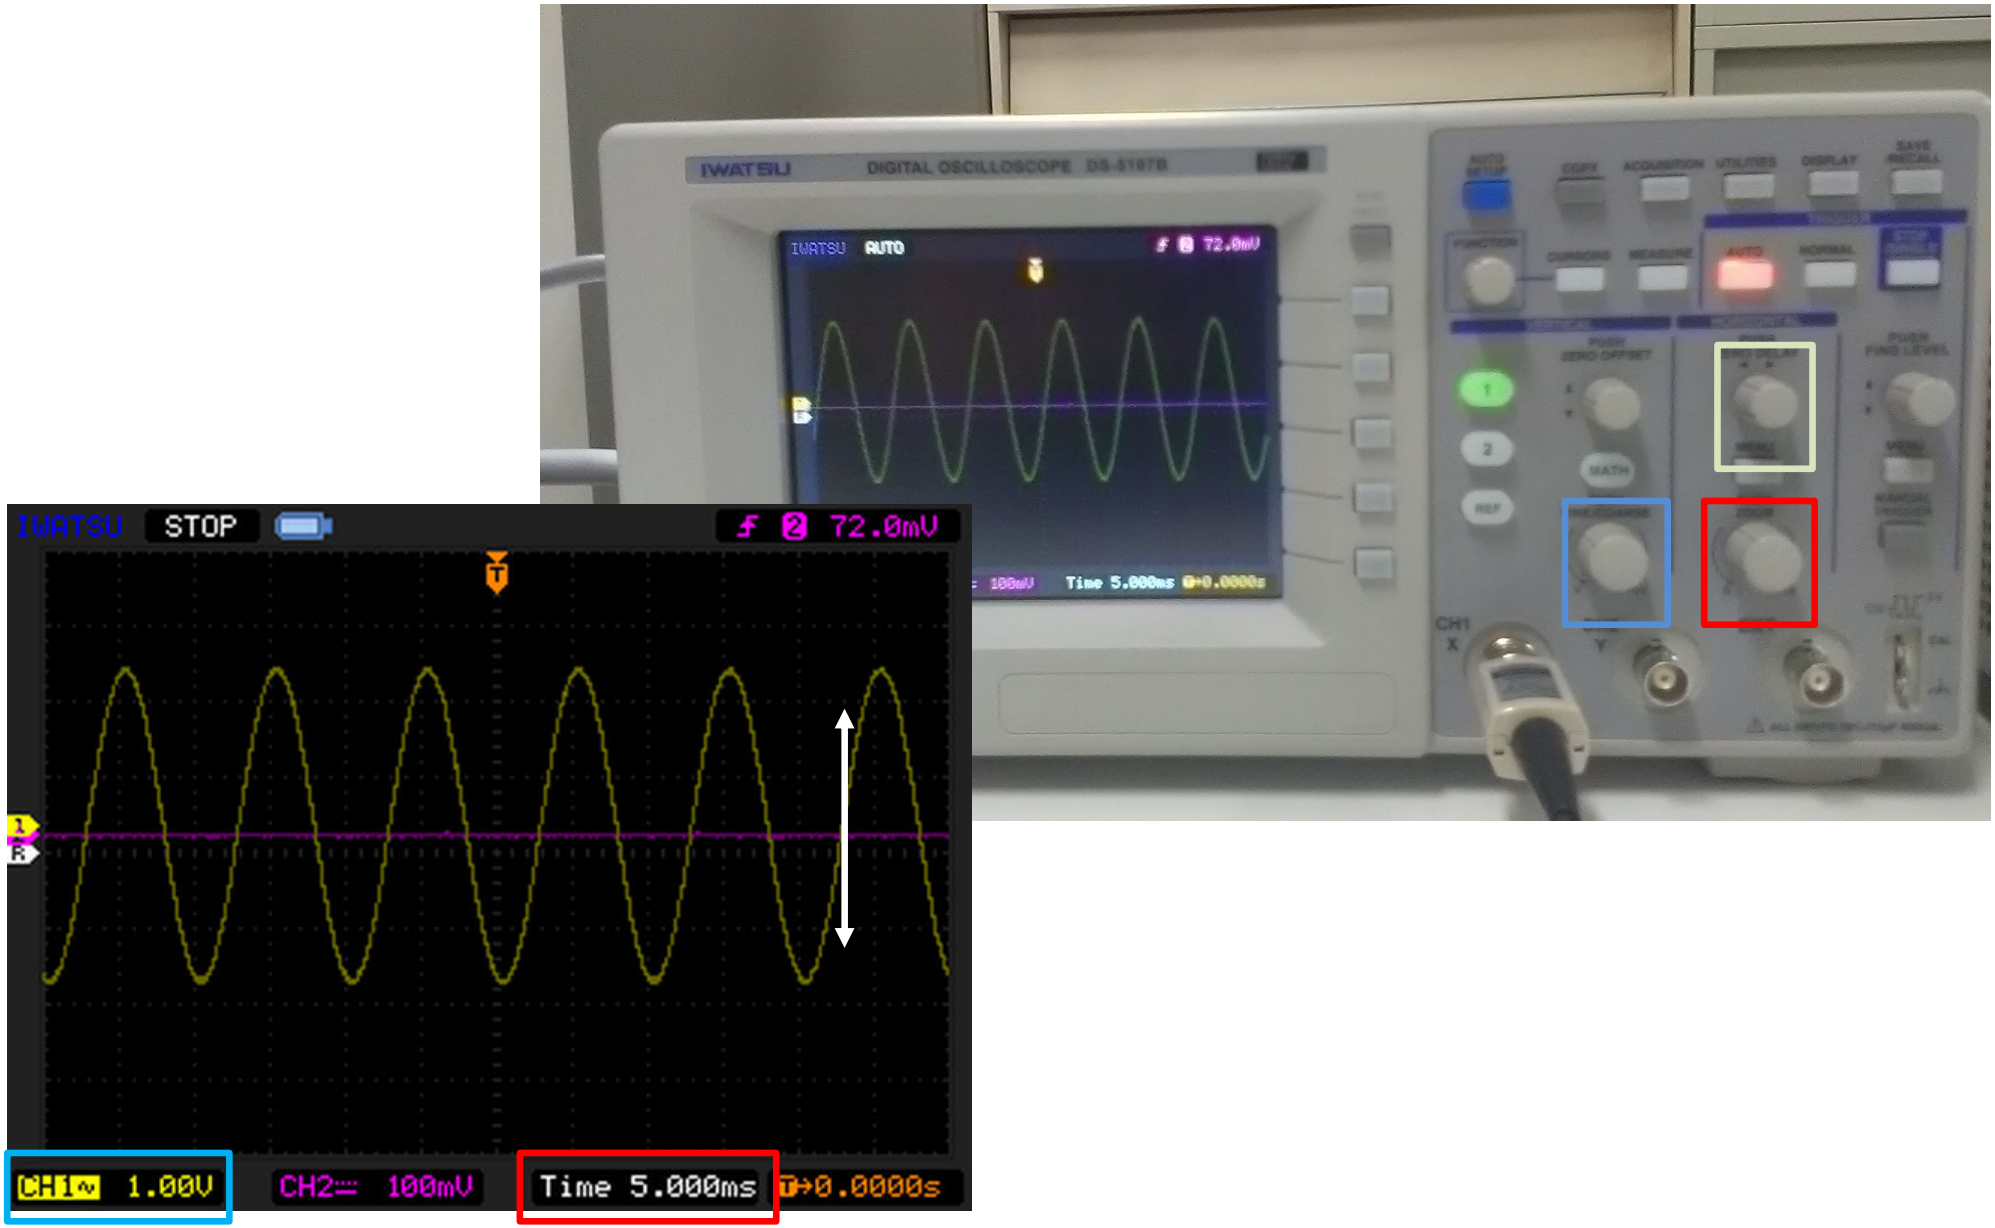

IWATSU
DIGITAL OSCILLOSCOPE
IWATSU
STOP
72.0mV
CH1 1.00V
CH2 100mV
Time 5.000ms
0.0000s

オシロスコープ（2/4）

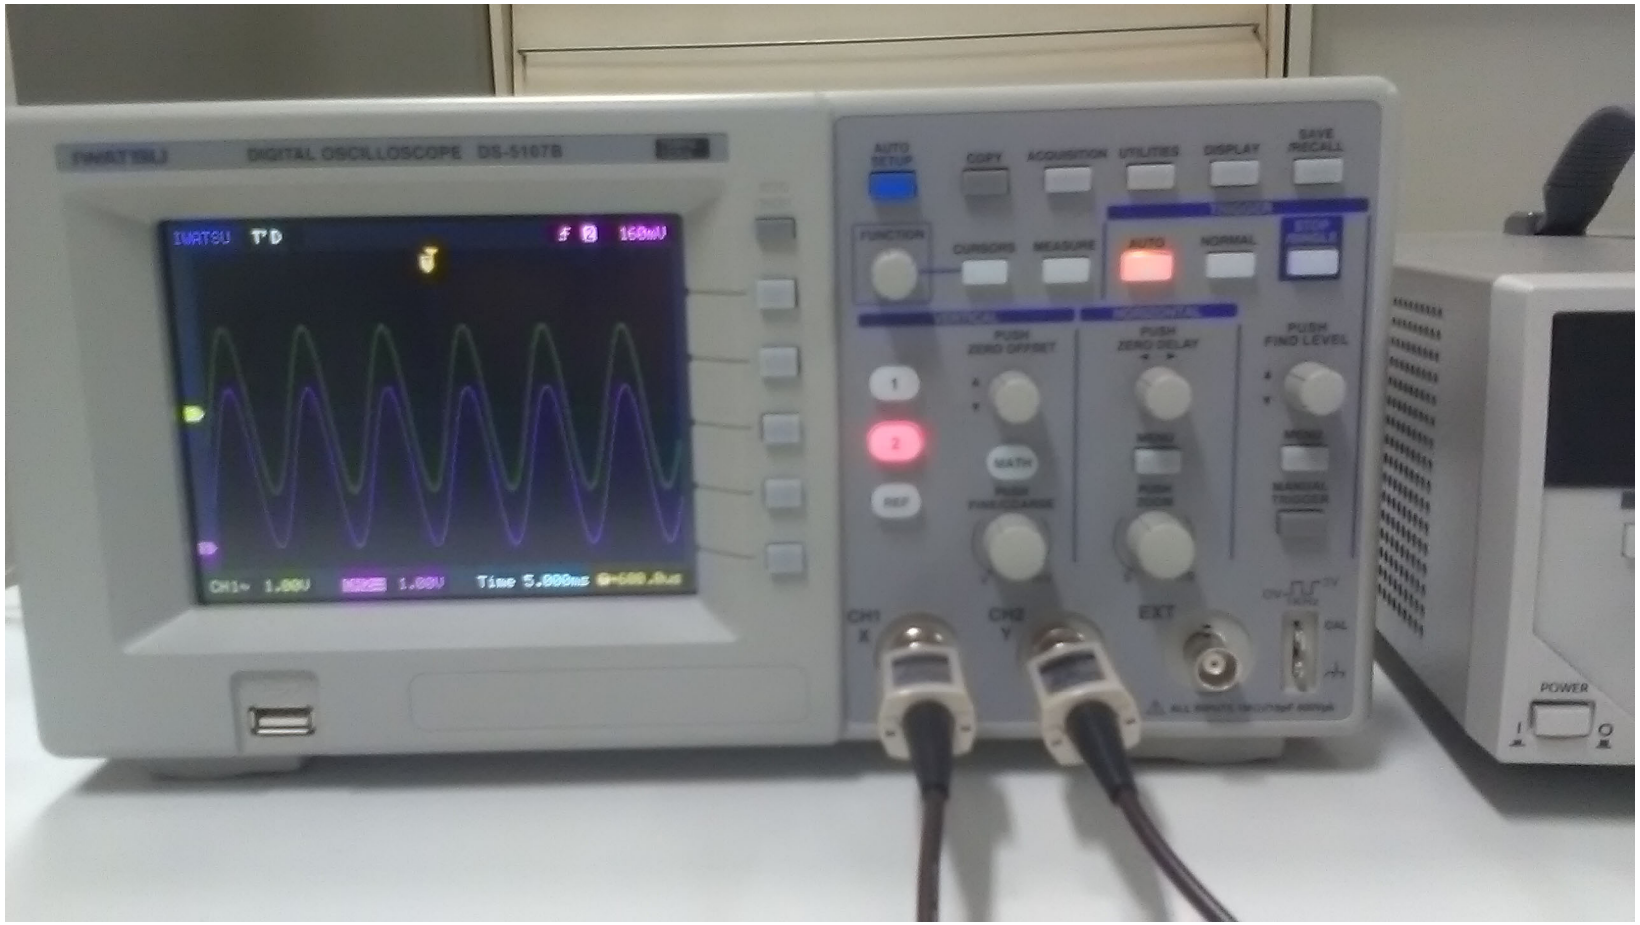

2チャネル表示


オシロスコープ（3/4）

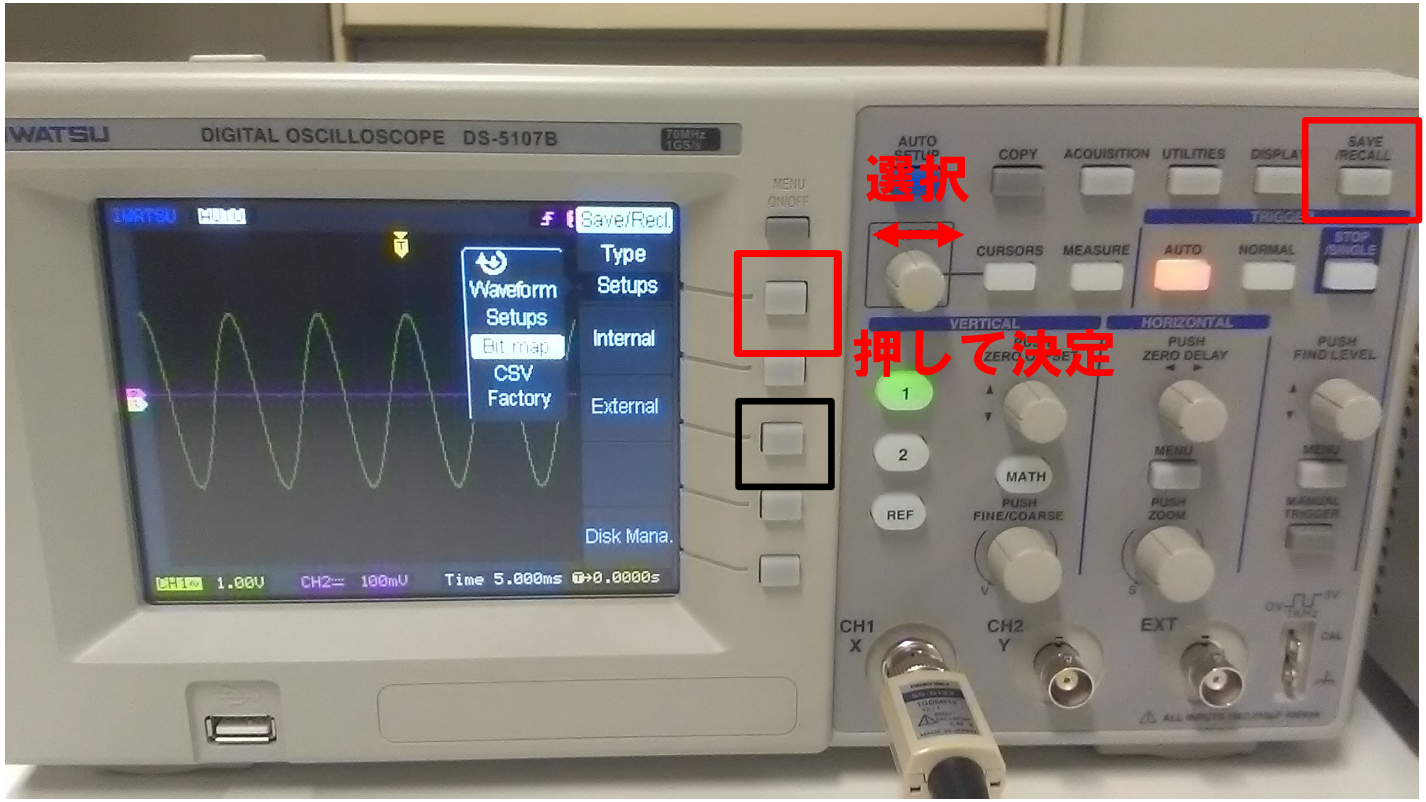


画面のセーブ(bmp)

USBメモリを接続してExternalで書き込み

オシロスコープ（4/4）

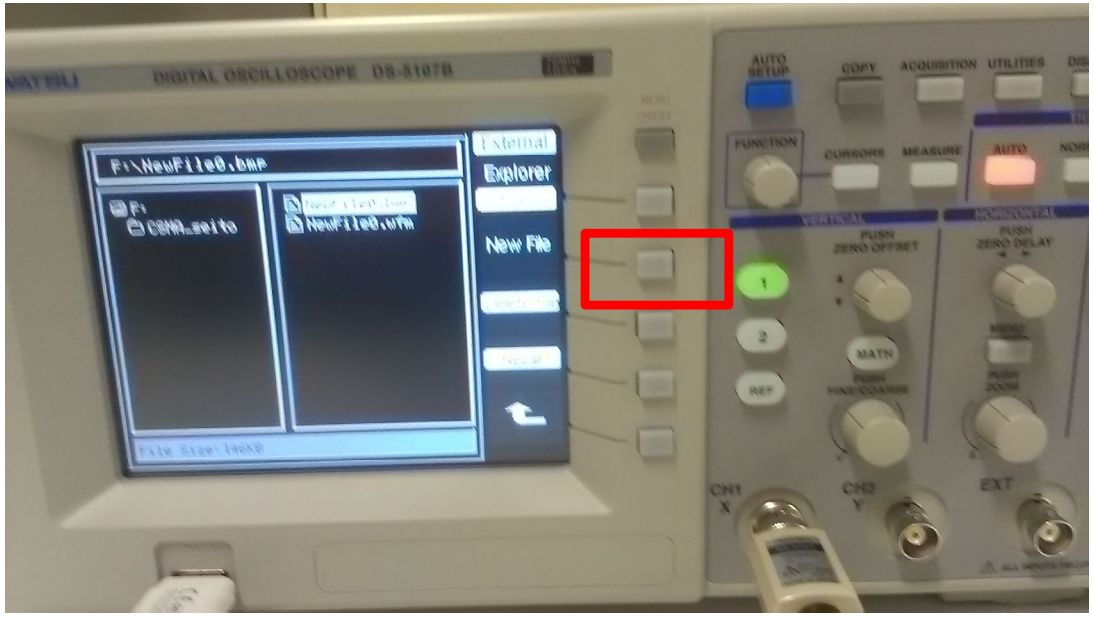

New File

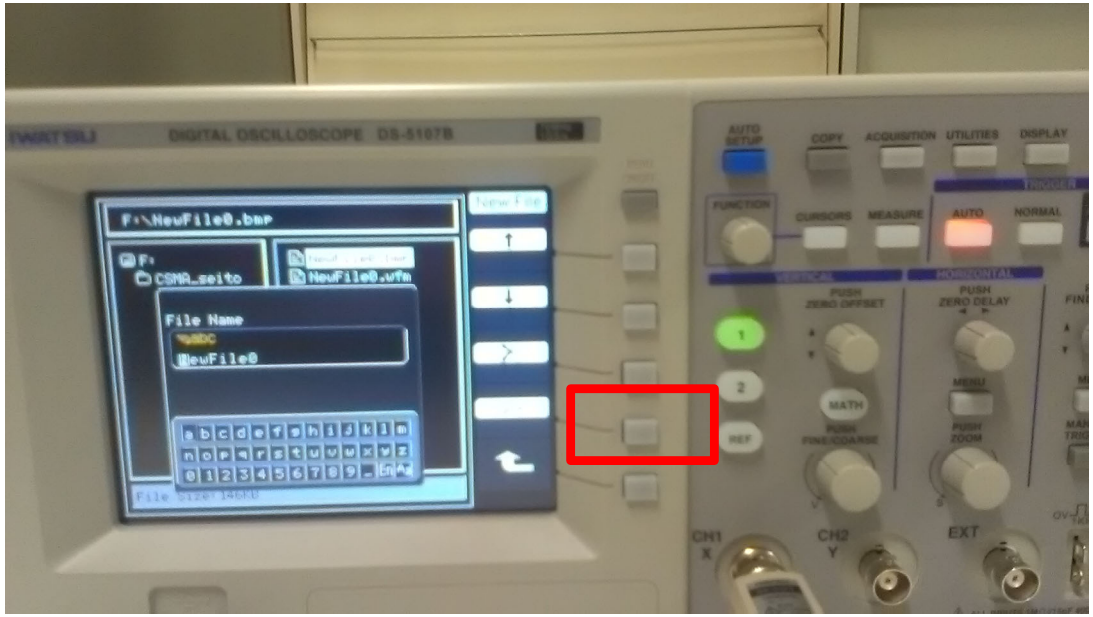

Save