




血氧探头 DB7

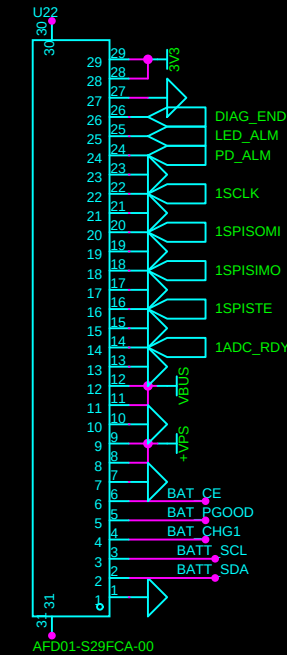


原理图	Top_4			创建日期	2026-05-09
板子	顶板_4			更新日期	2026-06-05
绘制		mairui N1			
审阅					
		版本	尺寸	页 1 共 6	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

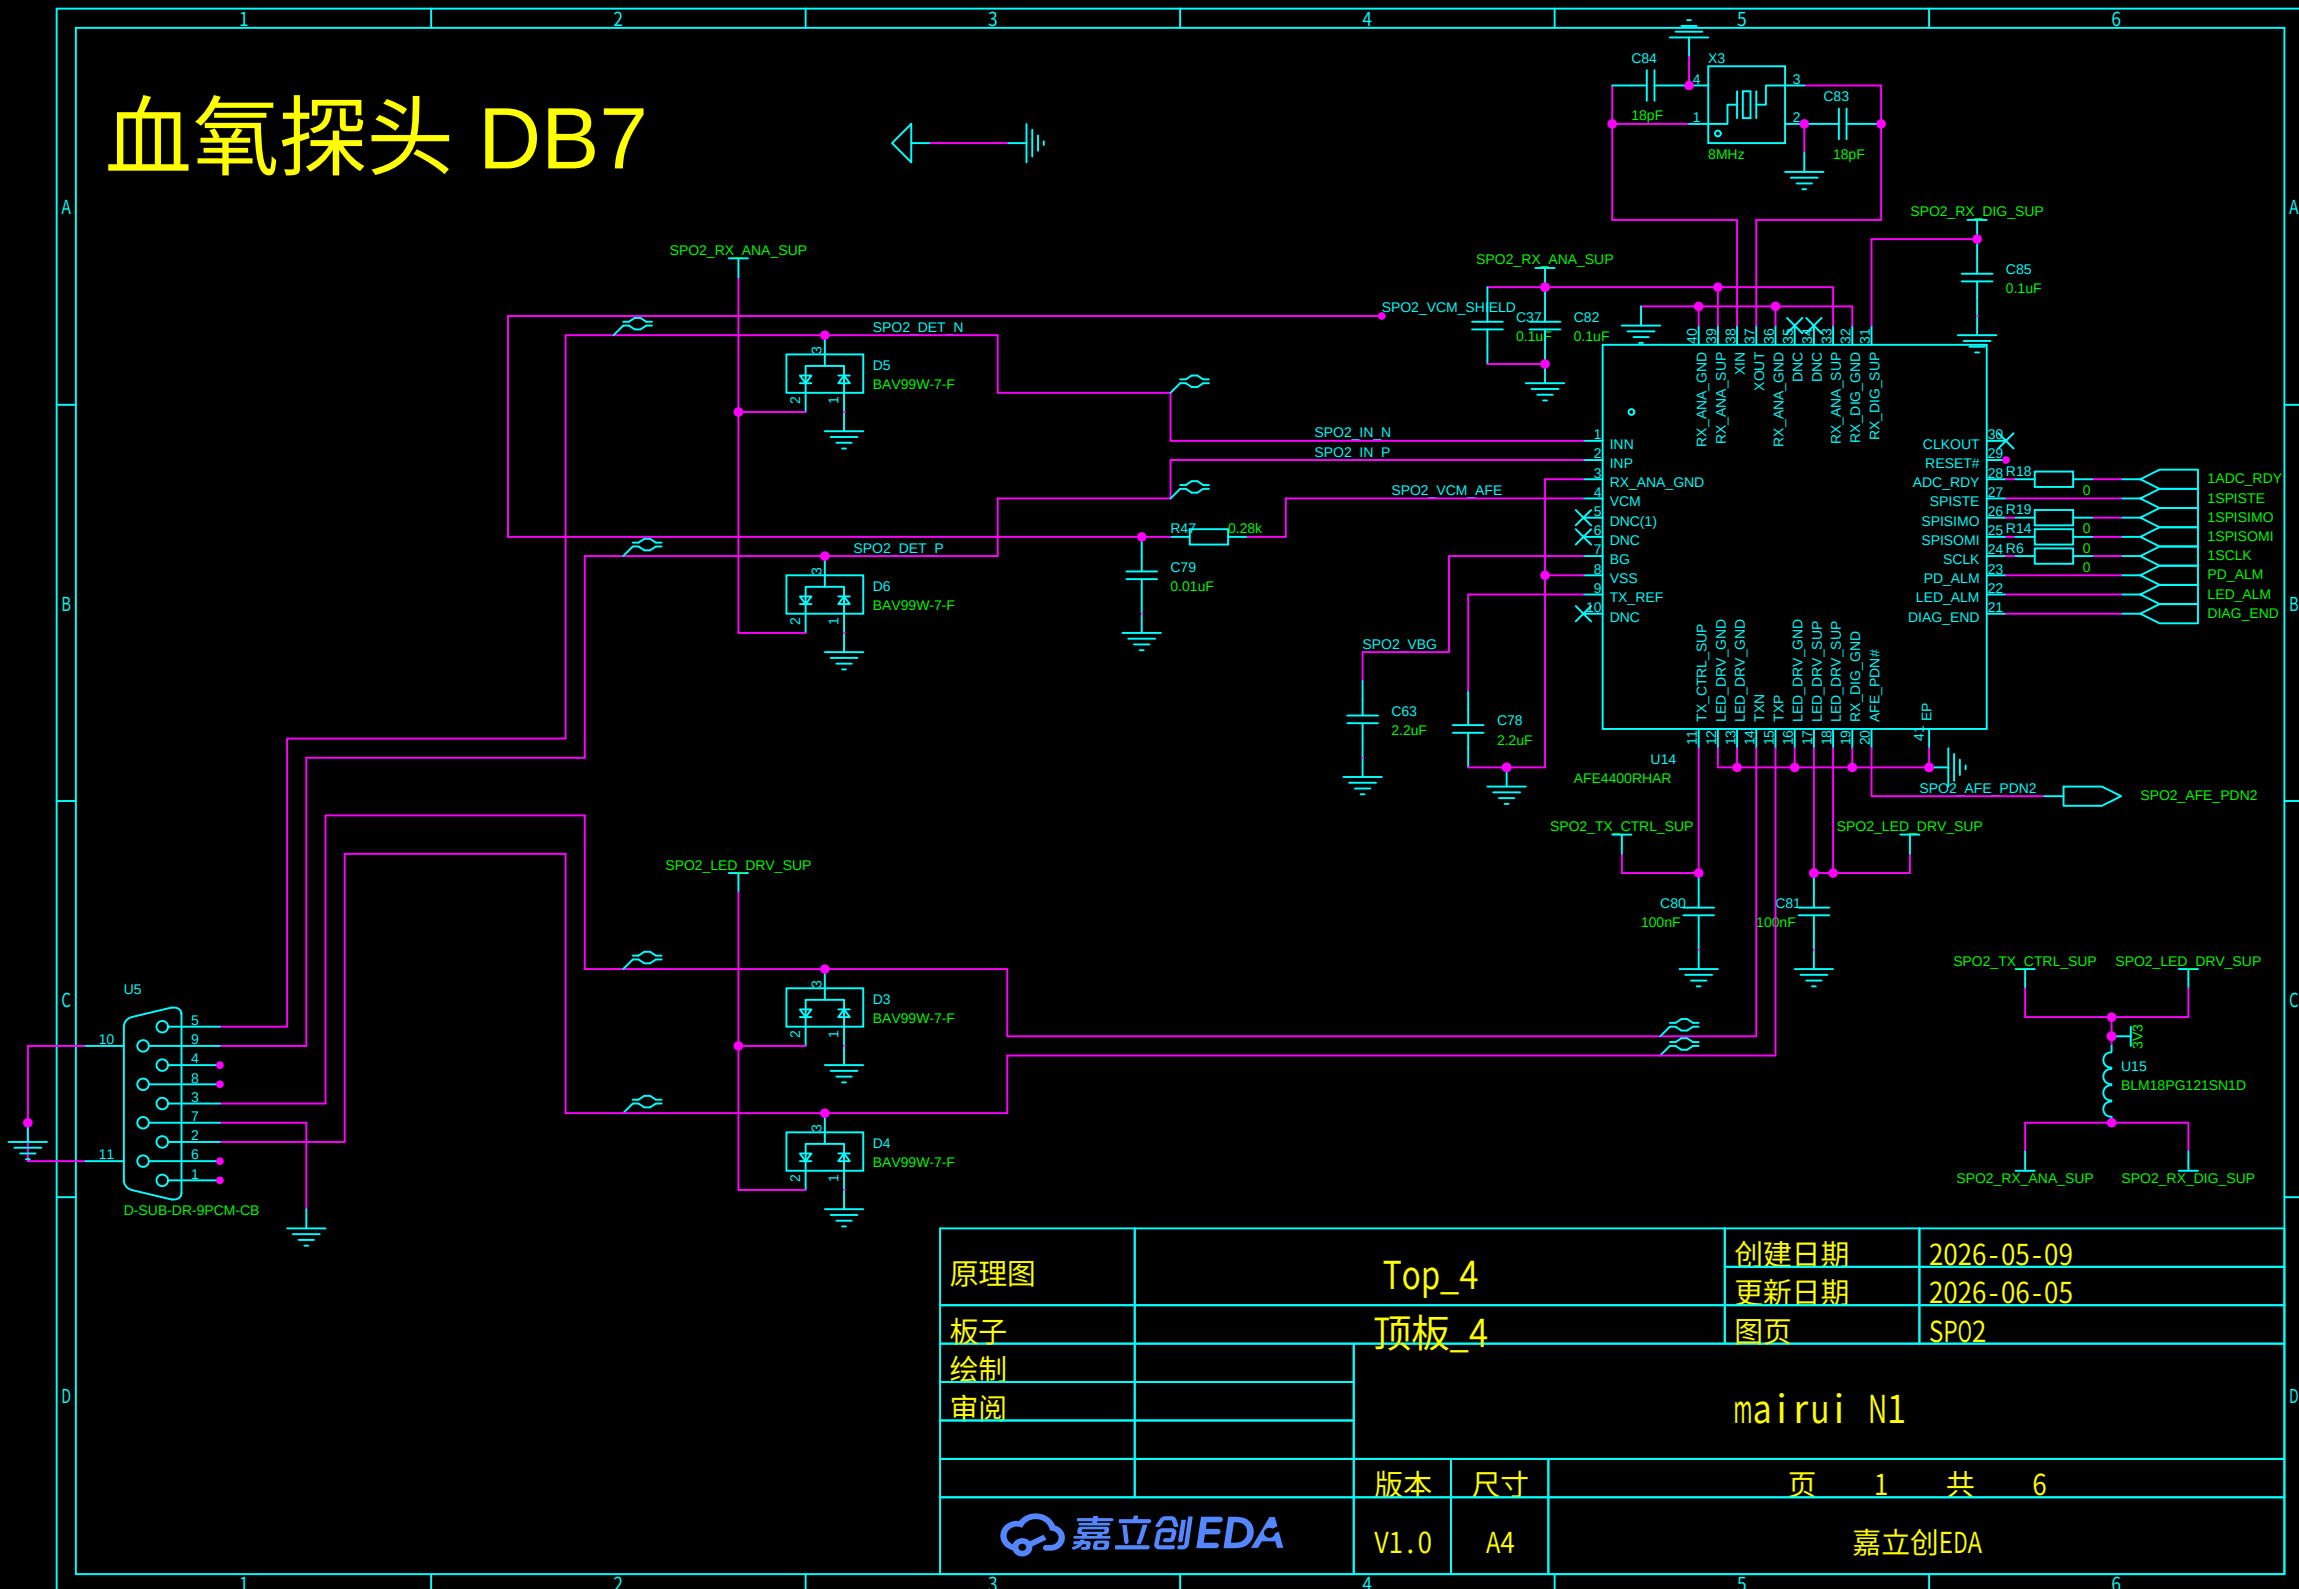

原理图	Top_4		创建日期	2026-05-09
板子	顶板_4		更新日期	2026-05-09
绘制		mairui N1		
审阅				
		版本	尺寸	页 3 共 6
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


[illegible]

当电池充满后，CHG 会变成高阻态。如果设备继续耗电，导致电池电压下降，芯片会自动触发“复充”把电池再次补满。但是！在这个自动补电的过程中，CHG 引脚依然会保持高阻态！
只有你重新插拔一次充电器，或者重新开关一次芯片的使能脚 (CE)，CHG 才会再次拉低



接入外部电源 BAT_PGOOD = L
正在充电 BAT_CHG1 = H
未充电 BAT_CHG = L
电池故障 BAT_CHG = 2Hz
CE -> H 断开外部电源

原理图	Top_4			创建日期	2026-05-09
				更新日期	2026-06-05
板子	顶板_4			图页	PWR
绘制		mairui N1			
审阅					
		版本	尺寸	页 4 共 6	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

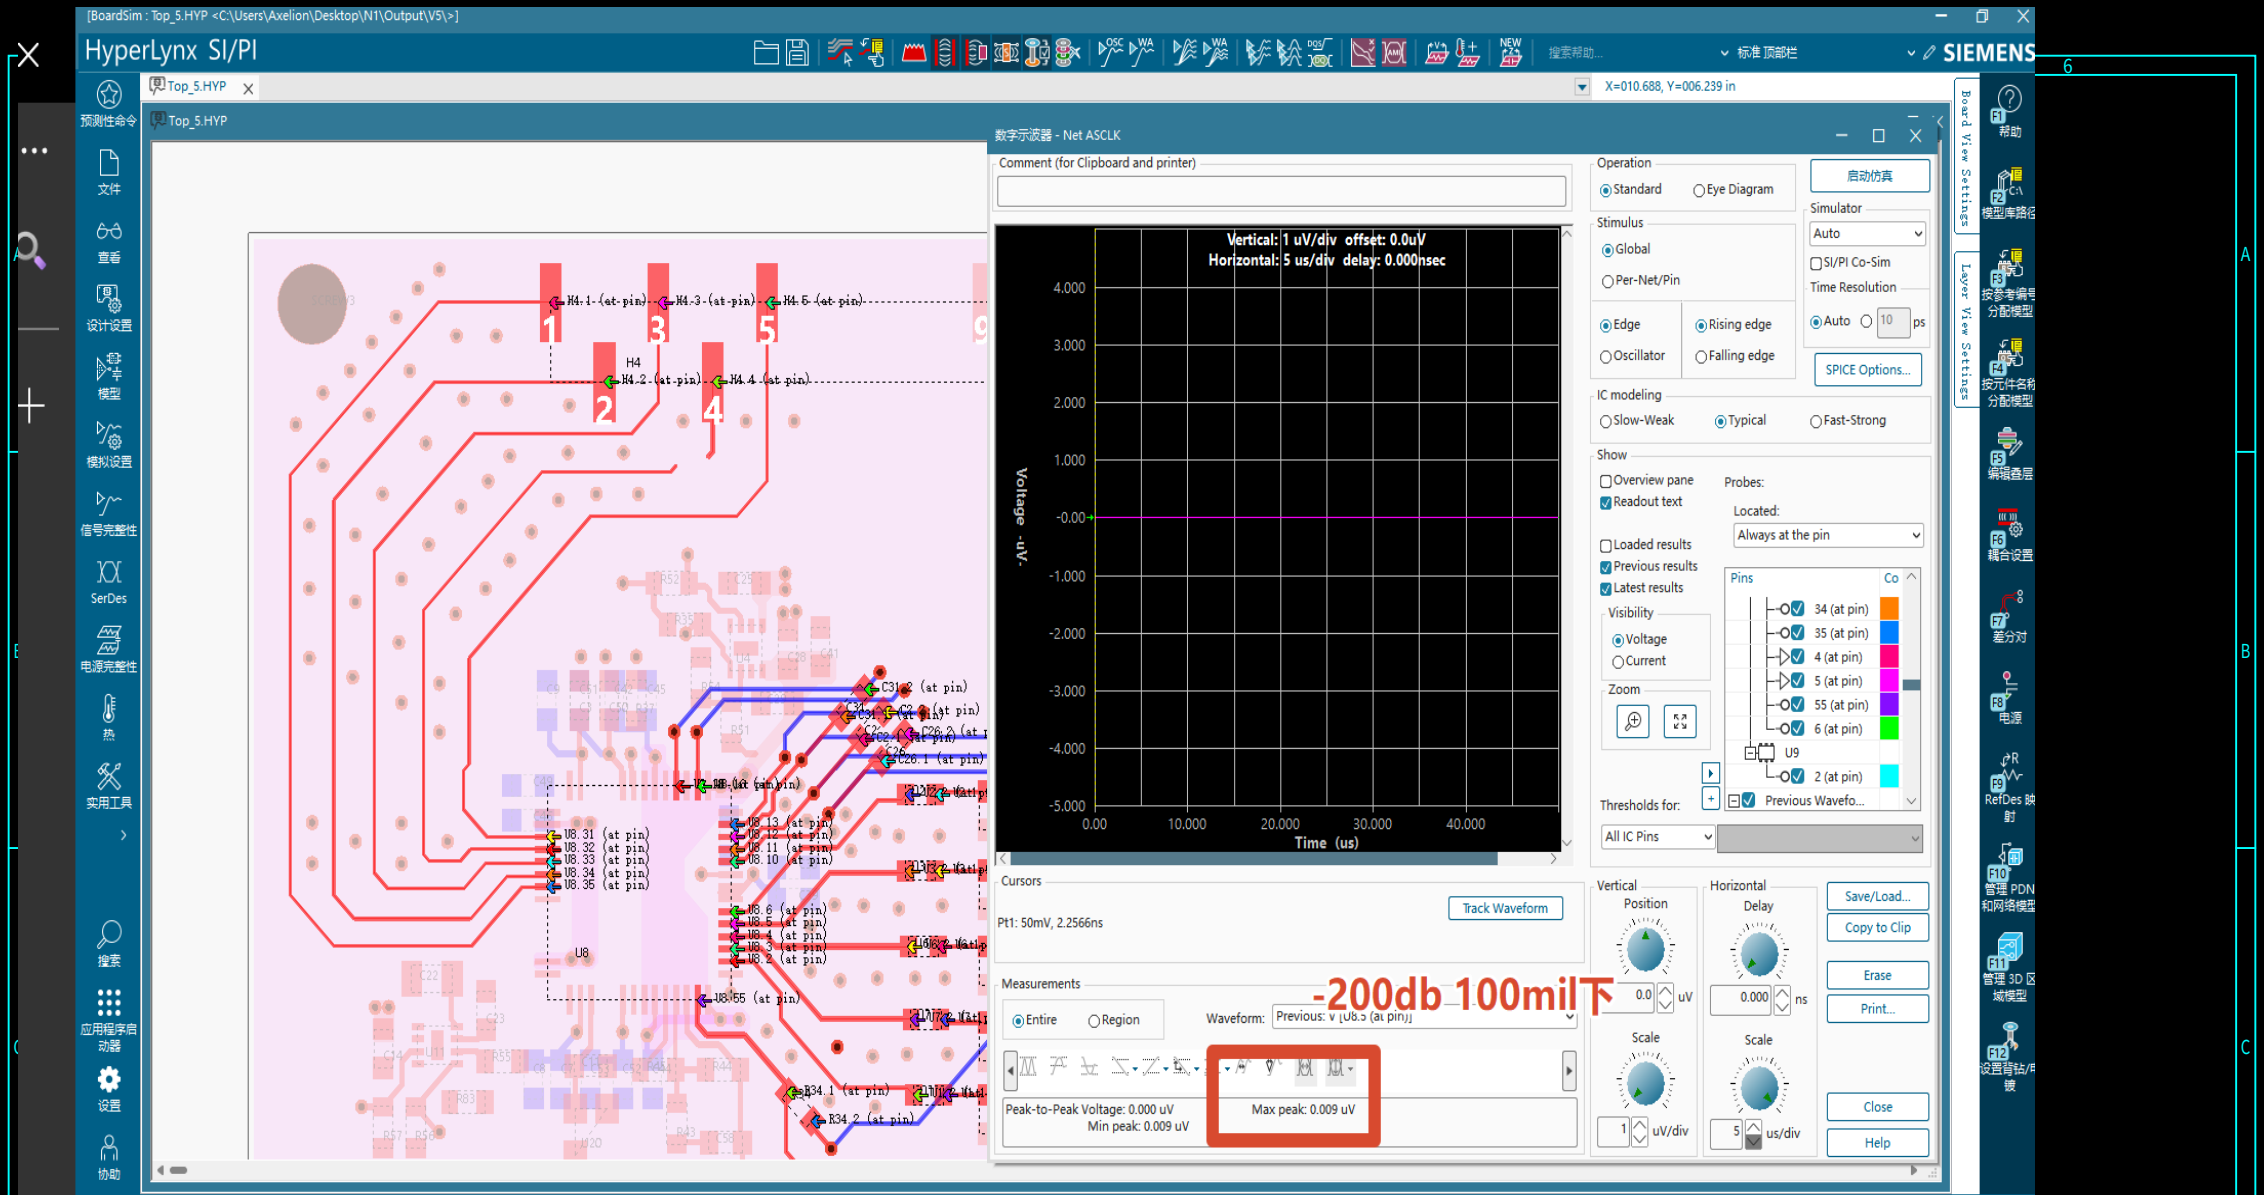

原理图 板子 绘制 审阅	Top_4 顶板_4			创建日期	2026-05-10
				更新日期	2026-06-05
				图页	串扰数据
				mairui N1	
			版本	尺寸	页 5 共 6
嘉立创EDA			V1.0	A4	嘉立创EDA

1	2	3	4	5	6
原理图		Top_4		创建日期	2026-05-19
板子		顶板_4		更新日期	2026-05-19
绘制		mairui N1			
审阅					
		版本	尺寸	页 6 共 6	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	
1	2	3	4	5	6