

GE MAC1200  
33 Años (11.09.1967)


CERVANTES GONZAL, TEODORA 1-871556, LABORATORIO CLINICO DURAN

FC 80LPM

Resultados de medidas:


QRS : 90 ms  
QT/QTcB : 396 / 456 ms  
PQ : 142 ms  
P : 98 ms  
RR/PP : 742 / 750 ms  
P/QRS/T : 16/ 48/ 23 Grados

Medico de tratam. :  
Usuario :

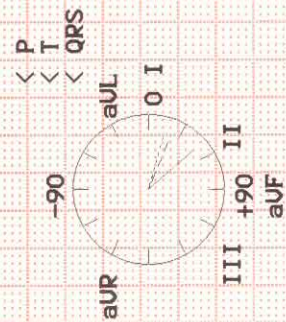

Interpretacion:  
12SL - Interpretacion:  
RITMO SINUSAL NORMAL  
ECG NORMAL

Informe no confirmado.

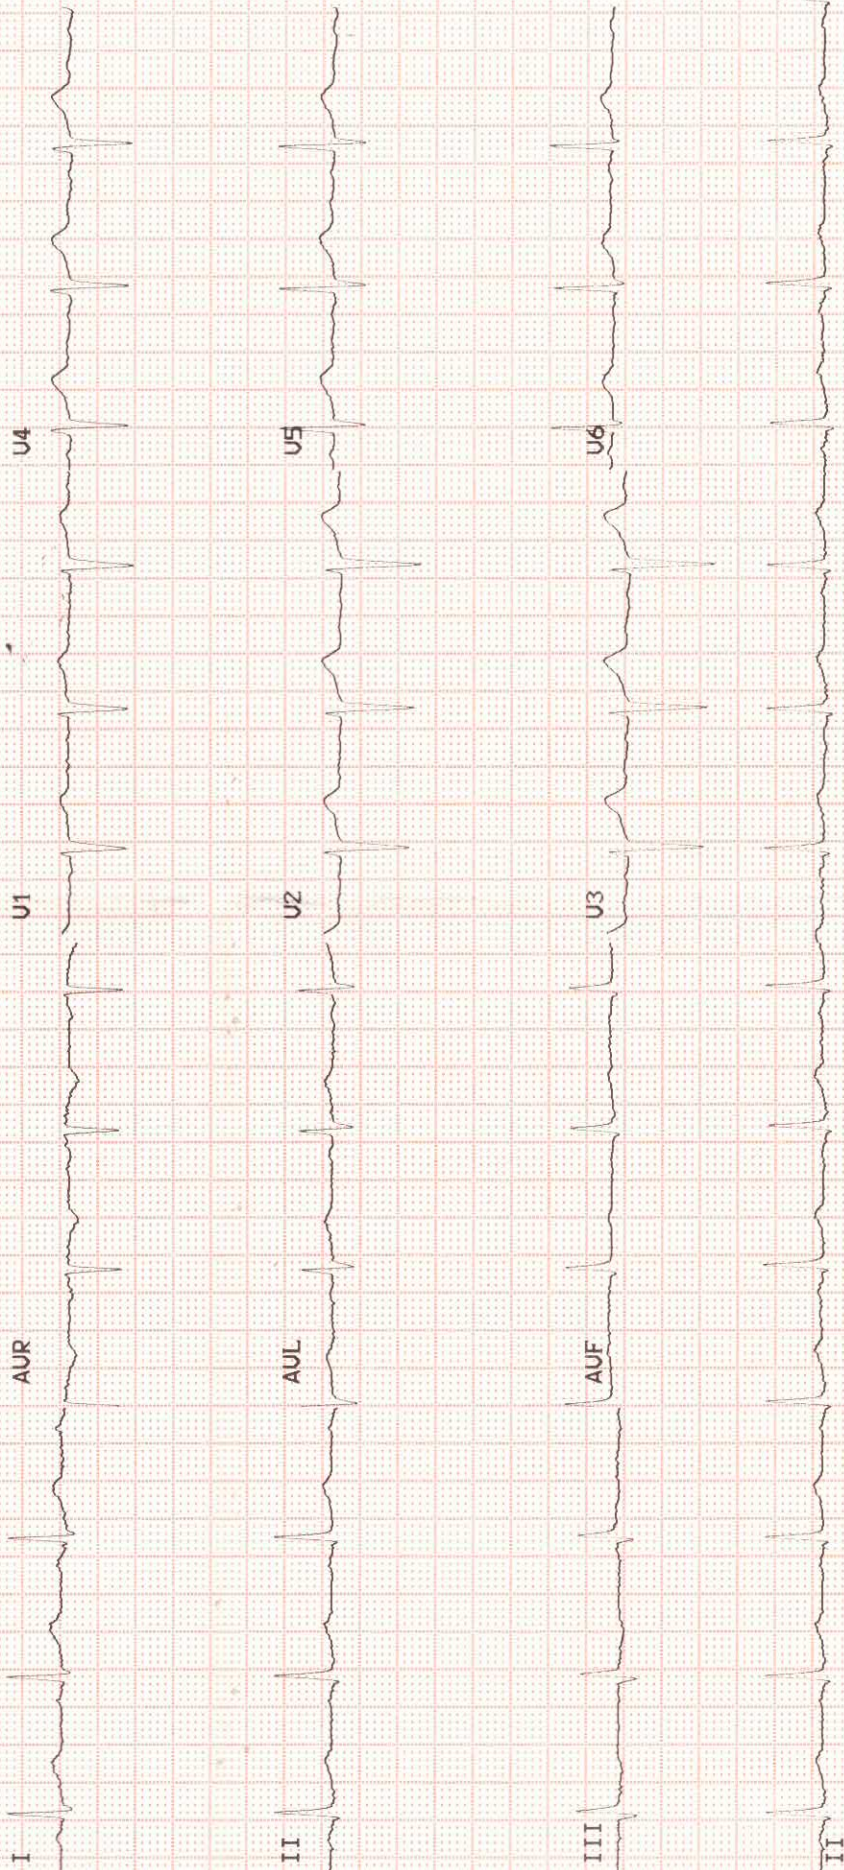

ID carro 1 ID del sitio 1  
04.Ene.2001 02:12:28 PM 25mm/s 10mm/mV SAD 60Hz 0.08 - 40Hz 4x2.5R1 Automatico U6.2 12i (2)

12SL@v231