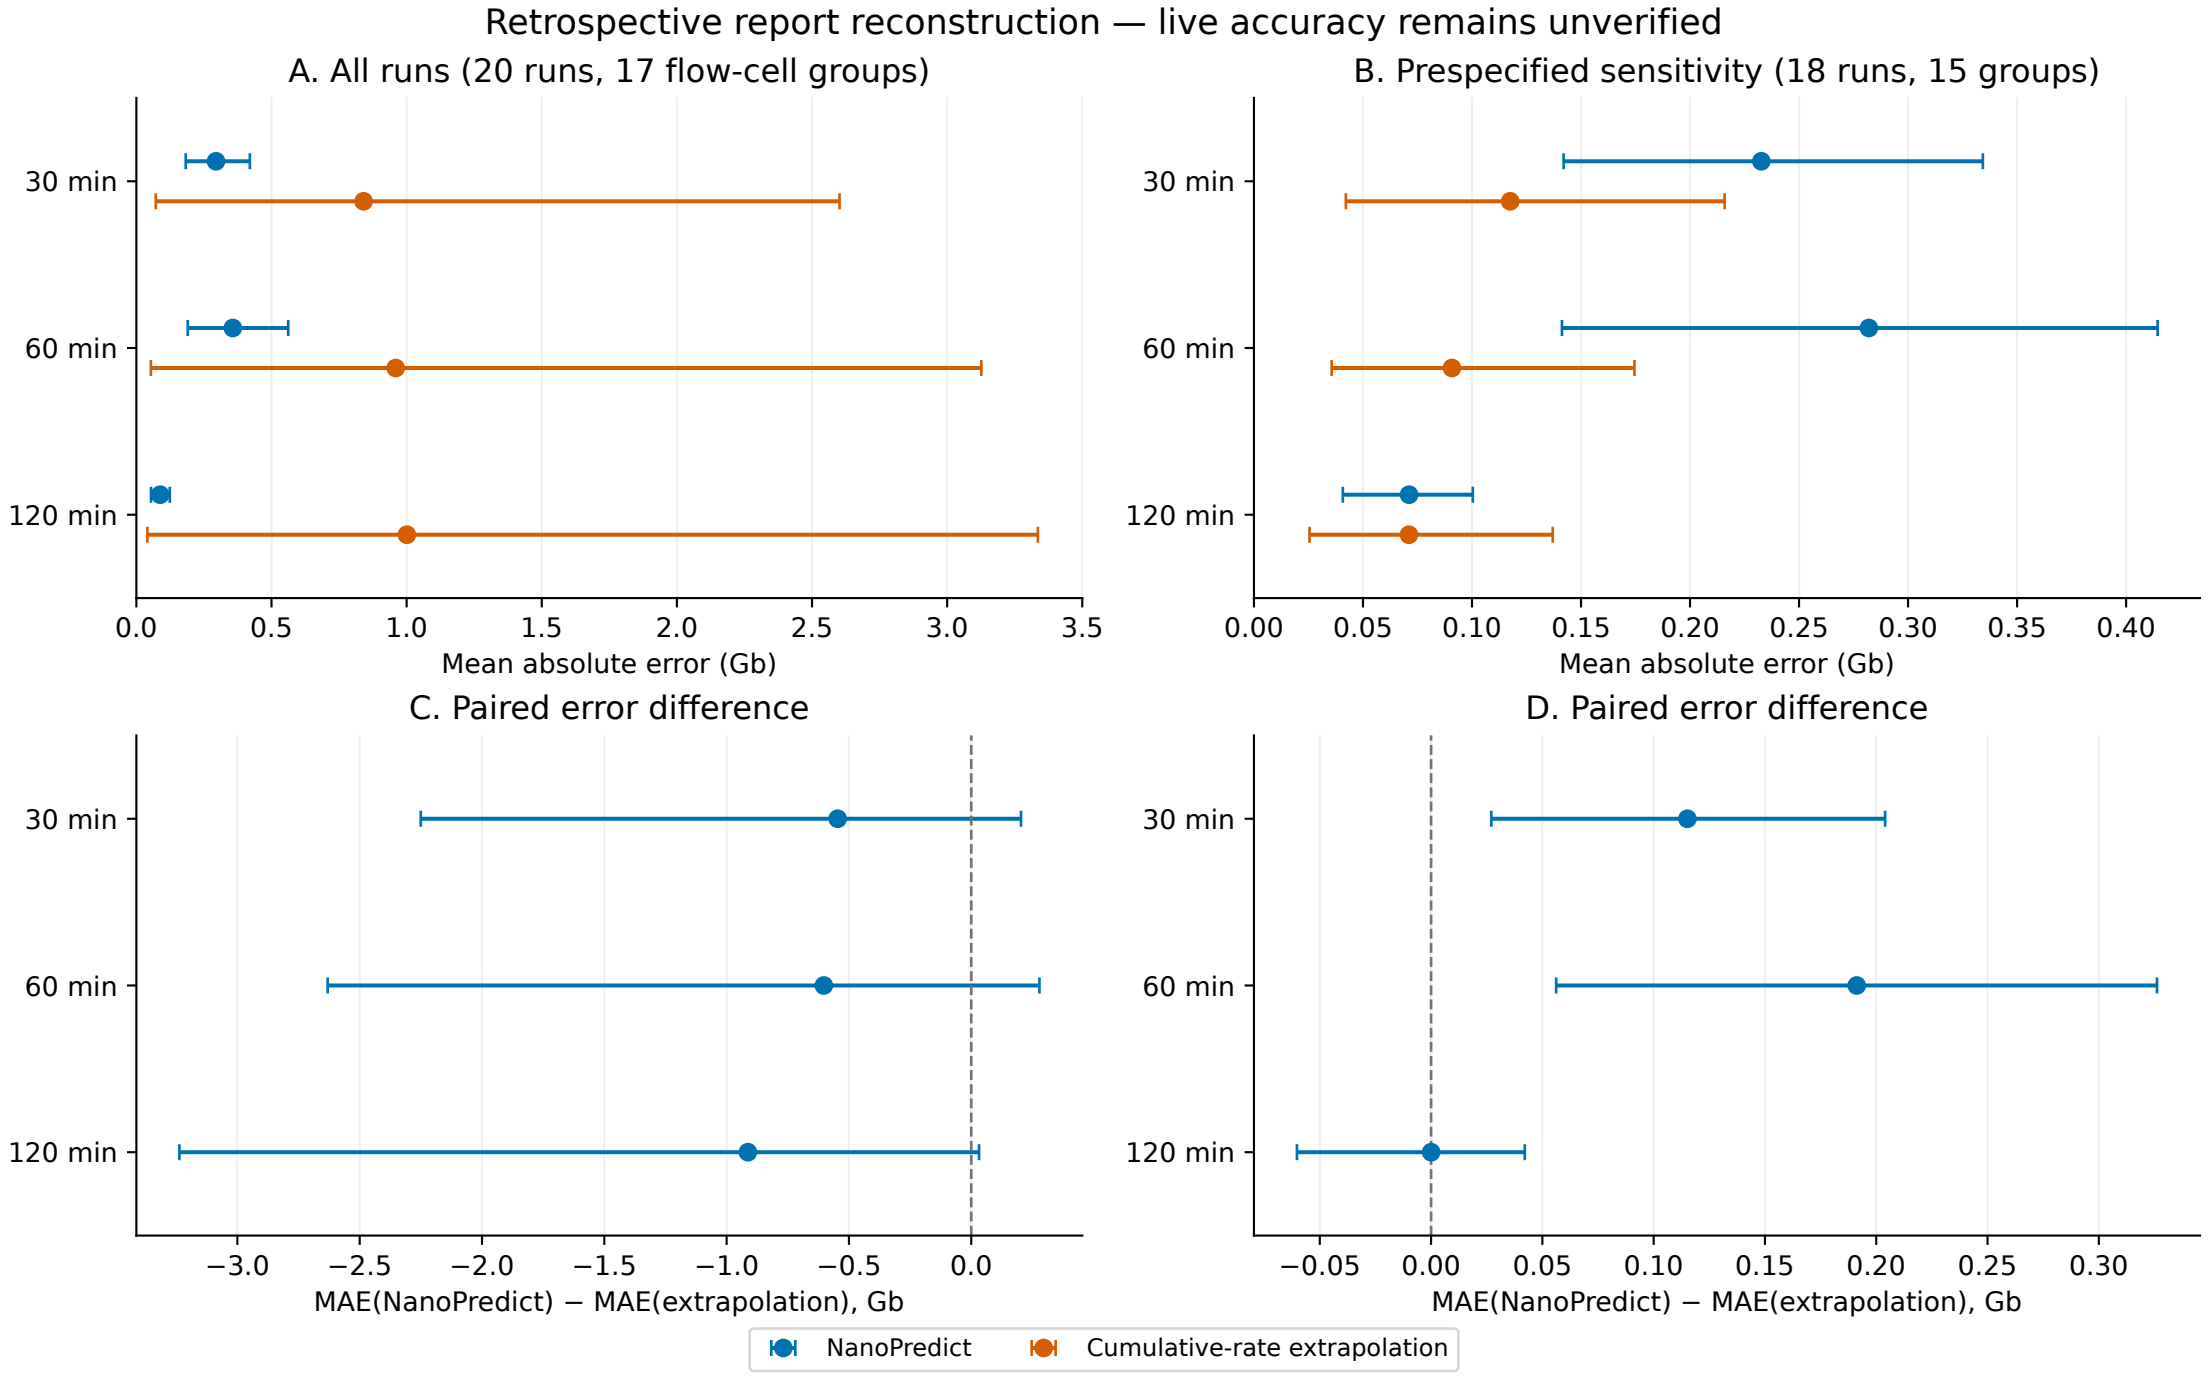
Retrospective report reconstruction — live accuracy remains unverified
A. All runs (20 runs, 17 flow-cell groups)
B. Prespecified sensitivity (18 runs, 15 groups)
30 min
60 min
120 min
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Mean absolute error (Gb)
C. Paired error difference
D. Paired error difference
−3.0
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
−0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
MAE(NanoPredict) − MAE(extrapolation), Gb
NanoPredict
Cumulative-rate extrapolation