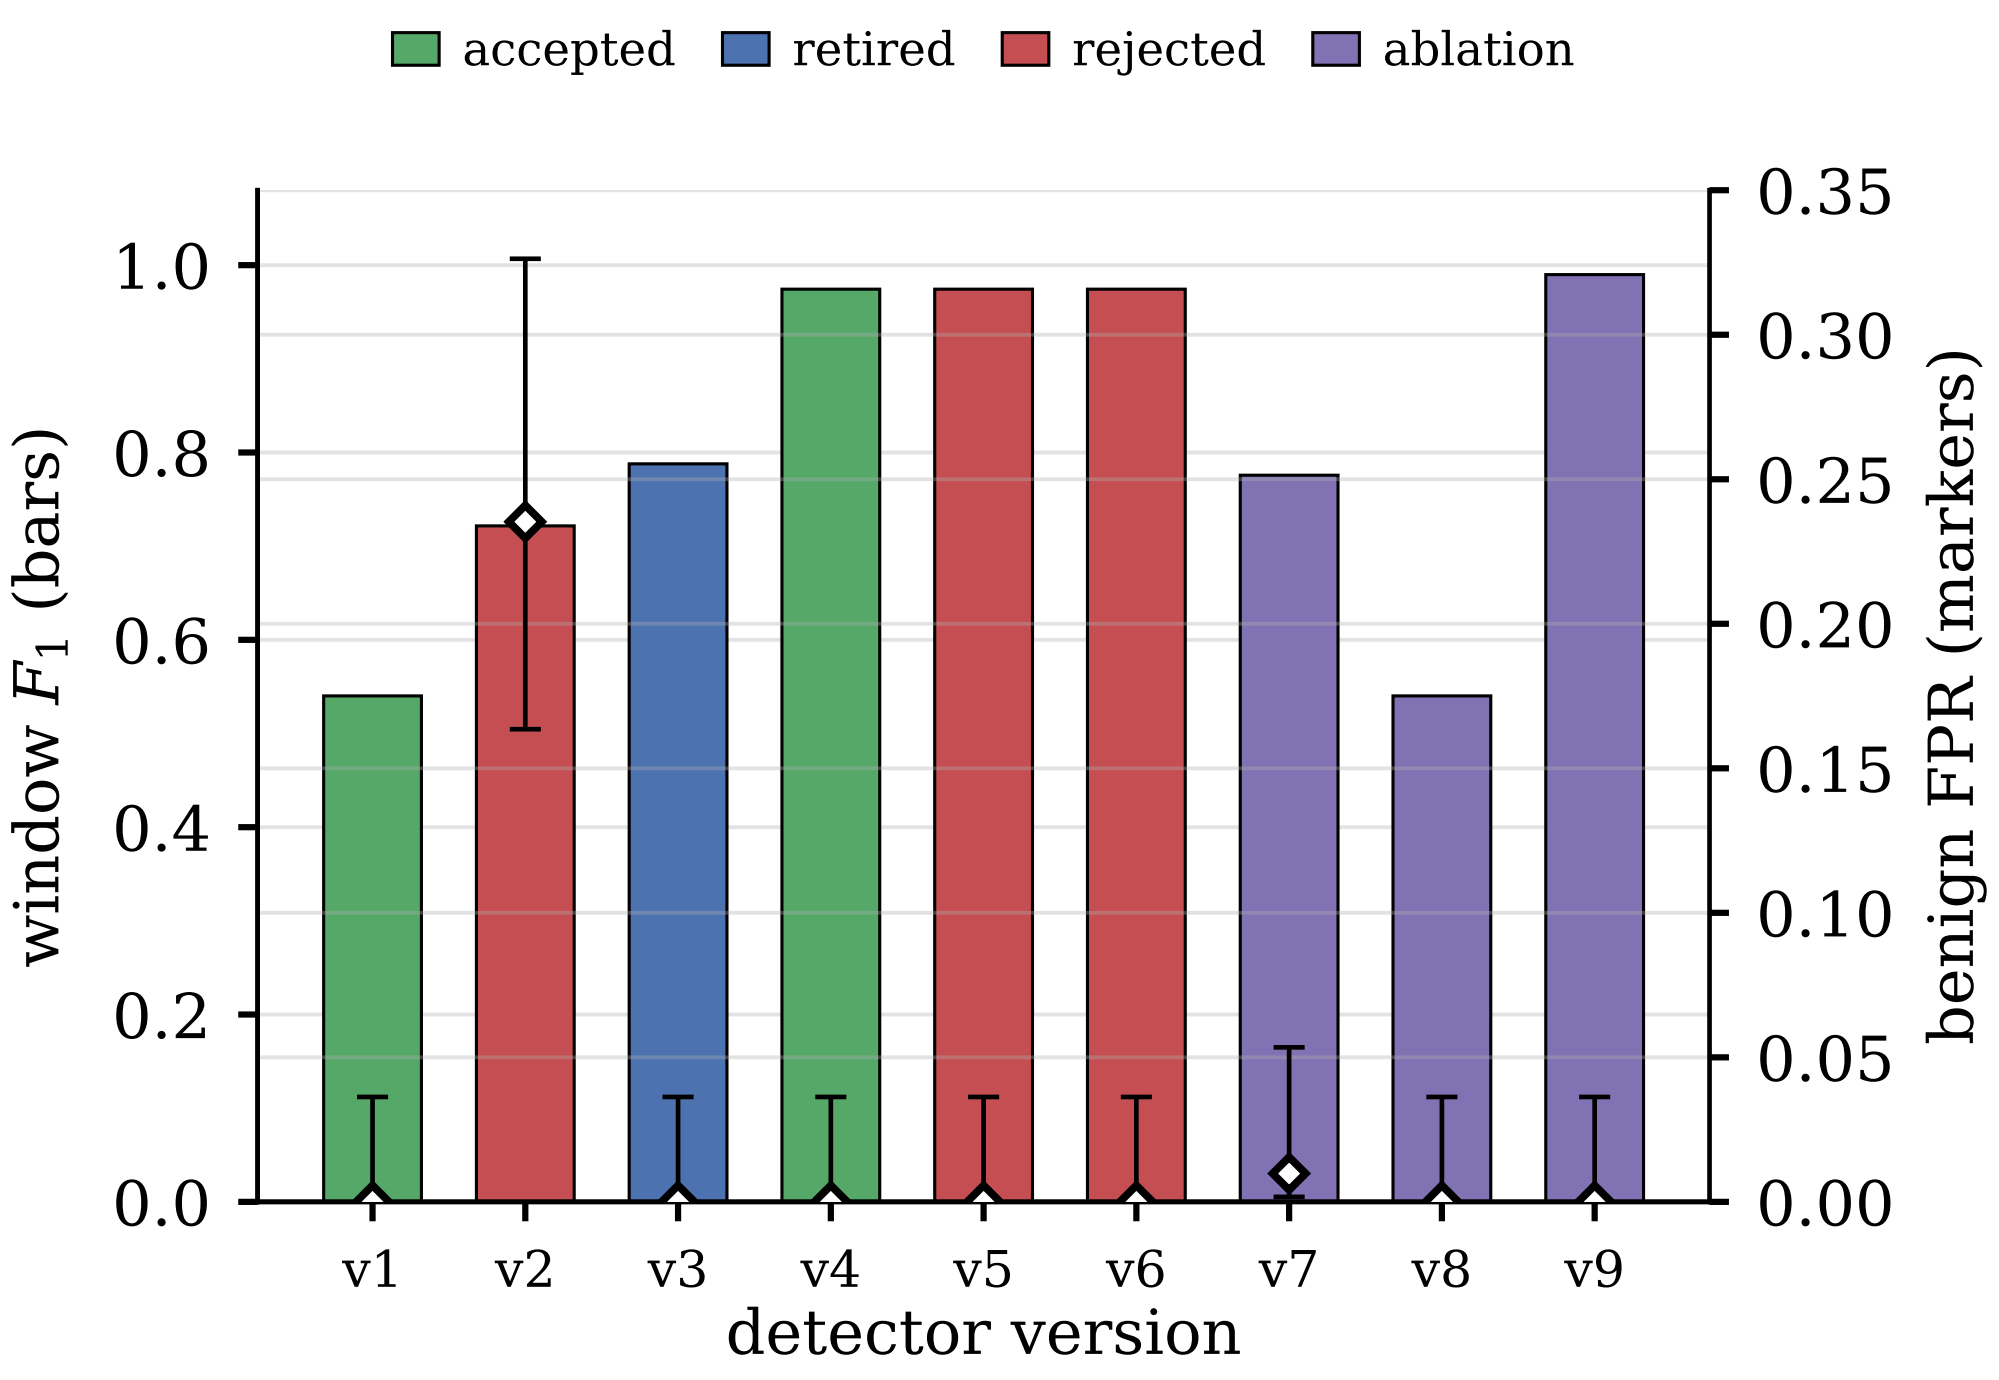
accepted
retired
rejected
ablation
window F_1 (bars)
benign FPR (markers)
detector version
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35