

Índice

1. Introducción	2
1.1. La Bioingeniería	2
1.2. La Ingeniería Biomédica	2
1.2.1. Ingeniería Biomédica en Colombia y el Mundo	3
1.2.2. La Electrocirugía	3
2. Bases Teóricas	3
2.1. Teoría Médica	3
2.1.1. Efectos de la Corriente sobre el Cuerpo Humano	3
2.1.2. El Electrobisturí	3
2.1.3. La Electrocardiografía	3
2.1.4. La Bioimpedanciometría	3
2.1.5. Seguridad Eléctrica en Equipos Médicos	8
2.2. Teoría Técnica	8
3. Diseño y Construcción del Electrobisturí	8
3.1. Generador de Ondas	8
3.2. Bioimpedanciometro	8
3.2.1. Características	8

1. Introducción

La Ingeniería Electrónica es la rama de la Física que mediante el aprovechamiento de fenómenos electromagnéticos y el comportamiento de las cargas eléctricas, se aplican soluciones teóricas y prácticas a una amplia gama de problemáticas. En particular el proyecto aprovecha la capacidad de aplicar tecnologías novedosas en el ámbito de los organismos biológicos, para combinarlas y de este modo obtener un producto que mejore la calidad de vida, humana o de procedencia animal.

1.1. La Bioingeniería

La Bioingeniería es un campo que combina los conocimientos del área ingenieril con la ciencia que se dedica a estudiar los seres vivos, es decir, la biología. Posee un amplio espectro de desarrollo, en donde encontramos diversas especialidades, tales como la ingeniería genética, la biomimética o la biomédica, esta última en concreto, sienta las bases necesarias para la elaboración de la unidad electroquirúrgica enfocada en la reducción del volumen de pérdida de sangre.

1.2. La Ingeniería Biomédica

La especialidad en la cual se desenvuelve el proyecto es denominada ingeniería biomédica, su concepto se basa en el estudio de campos derivados del cuidado de la salud, como lo son la medicina, odontología, veterinaria, la fisiología entre otros, y su finalidad es utilizar soluciones prácticas a dichos campos, por medio de el conocimiento teórico y empírico previamente adquirido. La biomédica ha estado vigente durante algunas décadas, no obstante es un tema relativamente nuevo para el entorno nacional, no solo hablando en términos de venta y distribución de la tecnología existente sino también para la innovación y desarrollo de nuevos dispositivos.

1.2.1. Ingeniería Biomédica en Colombia y el Mundo

1.2.2. La Electrocirugía

2. Bases Teóricas

2.1. Teoría Médica

2.1.1. Efectos de la Corriente sobre el Cuerpo Humano

2.1.1.1. Relación entre estímulo Eléctrico y la producción de un estímulo Neuro-Muscular

2.1.2. El Electrobisturí

2.1.2.1. Fundamentos Electroquirúrgicos

2.1.2.2. Características de la electrocirugía

2.1.2.3. Calculo de los parámetros para la electrocirugía

2.1.3. La Electrocardiografía

2.1.4. La Bioimpedanciometría

El sensado de impedancia dentro de los sistemas circuitales, es de vital importancia para la instrumentación de estos y por ende el correcto funcionamiento dentro del proceso requerido. Para obtener los valores de impedancia reales de un objeto en general se utilizan elementos como los empleados por los multímetros, basados en galvanómetros y resistencias de calibración [1], sin embargo para la obtención del valor de impedancia en un tejido biológico o bioimpedancia, existen elementos en particular que no solo realizan este procedimiento de manera efectiva, sino

que tampoco comprometen el estado del ente involucrado en el proceso de medición.

2.1.4.1. Impedancia Eléctrica de los Tejidos

La impedancia como tal es la oposición de un material al flujo de corriente sobre este. Con la bioimpedancia esta afirmación no es una excepción, pero además se tiene que la condición de dichos tejidos determina directamente su capacidad conductiva y de almacenamiento de electricidad.

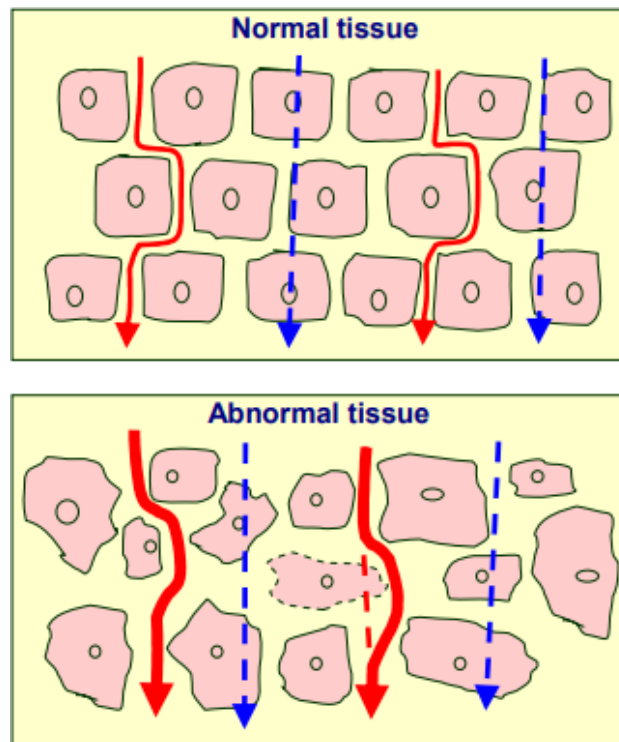


Figura 1: Tipo de Tejido según su Condición

Así mismo la medida de bioimpedancia tiende a variar de acuerdo al tipo de tejido al cual nos estemos refiriendo. Es de tal modo, que por ejemplo la piel en su estructura completa posee un mayor valor de impedancia con respecto al tejido muscular, pero un valor inferior al tejido no magro o también llamado tejido graso.

2.1.4.2. Tipos de Tejido

Para el ámbito en el cual nos encontramos, es decir, bioimpedancia, existen diversas formas de clasificar los tejidos, pero a groso modo, citaremos los analizados en el libro Bioimpedance and Bioelectricity Basics, para tomar valores de referencia con los cuales se podrá completar con ellos la calibración de los dispositivos utilizados en el presente modulo.

- Tejido Muscular o Magro.
- Tejido Nervioso.
- Tejido Adiposo o Graso y Tejido Óseo.
- Sangre.

Tissue	σ (S/m) 1 Hz–10 kHz	σ (S/m) ca 1 MHz	φ_{\max} @<10 MHz	anisotropy
Human skin, dry	10^{-7}	10^{-4}	80°	?
Human skin, wet	10^{-5}	10^{-4}	30°	?
Bone	0.005–0.06		20°	Strong
Fat	0.02–0.05	0.02–0.05	3°	Small
Lung	0.05–0.4	0.1–0.6	15°	Local
Brain (grey matter)	0.03–0.4	0.15	15°	Small
Brain (white matter)	0.03–0.3			Strong
Liver	0.2	0.3	5°	?
Muscle	0.05–0.4	0.6	30°	Strong
Whole blood	0.7	0.7	20°	Flow dependent
Urine	0.5–2.6	0.5–2.6	0°	0
CSF	1.6	1.6	0°	0
Saline, 0.9%, 20°C	1.3	1.3	0°	0
Saline, 0.9%, 37°C	2	2	0°	0
Seawater	5	5	0°	0

Figura 2: Escala de Impedancia de los Tejidos

Aquí observamos claramente que existe una variación no solo con las características antes mencionadas, estado del tejido y tipo de tejido, sino también con la frecuencia a la que se realiza la caracterización del tejido.

Como sabemos la impedancia presente en el tejido vivo corresponde directamente con su capacidad conductiva, en ese sentido, elementos a nivel macroscópico y microscópico son responsables de su comportamiento ante una excitación eléctrica, entre estos elementos se encuentran la extensión del tejido, su nivel de hidratación tanto extra como intracelularmente hablando, temperatura, entre otros. Por ello los valores de impedancia que se obtienen al aplicar sobre estos tejido un flujo de corriente continua es de tipo capacitivo, esto implica, que además de la magnitud del dato arrojado habrá una fase.

Esta es por tanto la base teórica de nuestro sistema, la adquisición de un dato imaginario y uno real, en donde a base de fórmulas aritméticas obtengamos con la mayor certeza posible la magnitud o valor resistivo del elemento o elementos sobre los cuales actuara el electrobisturí.

2.1.4.3. *Precauciones de Sensado*

Como es bien sabido, la aplicación de corriente sobre el cuerpo humano, o cualquier ser vivo, debe conllevar una serie de precauciones necesarias para evitar efectos perjudiciales de salud. Como es citado en empresas especializadas en equipo médico, en este caso TÜV, incluso los niveles de corriente pequeños para las frecuencias de distribución usadas a nivel mundial, es decir, 50 y 60 Hz, pueden repercutir en daños clínicos irreversibles.

EFFECTS OF ELECTRICAL CURRENT IN THE HUMAN BODY	
Current	Reaction
Below 1 Milliampere	Generally not perceptible
1 Milliampere	Faint Tingle
5 Milliampere	Slight shock felt. Not painful but disturbing. Average individual can let go. Strong involuntary reactions can lead to other injuries.
6 to 25 Milliampere (women)	Painful shocks. Loss of muscle control.
9 to 30 Milliampere (men)	The freezing current or “let go” range. If extensor muscles are excited by shock, the person may be thrown away from the power source. Individuals cannot let go. Strong involuntary reactions can lead to other injuries.
50 to 150 Milliampere	Extreme pain, respiratory arrest, severe muscle reactions. Death is possible.
1.0 to 4.3 Amperes	Rhythmic pumping action of the heart ceases. Muscular contraction and nerve damage occur; death is likely.
10 Amperes	Cardiac arrest, severe burns, death is probable.

Figura 3: Escala de Impedancia de los Tejidos

El dispositivo elegido debe por lo tanto, no solo ser de carácter fiable, sino que a su vez procure trabajar con parámetros específicamente diseñados para el tratamiento de “Bioimpedancias”, en nuestro caso fue el circuito integrado AD5933.

La razón de elección es su amplio rango de impedancias medibles (entre 100Ω y $10M\Omega$) y la frecuencia de aplicación de sus señales de excitación (Frecuencia máxima recomendada de hasta $100KHz$). Con la información previa recopilada podemos determinar que según la reglamentación de seguridad para equipos médicos en Colombia podemos acoplar este elemento al sistema final completo [5].

2.1.5. Seguridad Eléctrica en Equipos Médicos

2.1.5.1. *Clasificación de los Equipos Médicos según las Normas de Seguridad ICE*

2.2. Teoría Técnica

3. Diseño y Construcción del Electrobisturí

3.1. Generador de Ondas

3.2. Bioimpedanciometro

3.2.1. Características

En base al circuito integrado elegido, AD5933, se elabora un sistema que asegure una captación de datos de manera continua, con un margen de error mínimo, procurando reducir al máximo la interferencia generada por el ruido proveniente de los circuitos circundantes.

Es prudente aclarar que dentro del dispositivo en uso, está desarrollado un sistema de bloques propio, el cual se procederá a describir, más no a fondo, toda la documentación sin embargo esta disponible en la hoja de datos presente en la página del fabricante.

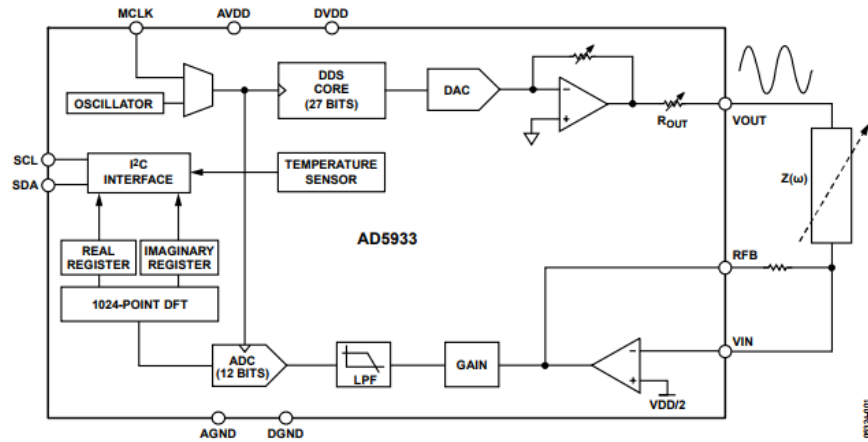


Figura 4: Diagrama de Bloques Interno, Circuito Integrado AD5933

3.2.1.1. Componentes

Además del circuito principal, basados en las recomendaciones del fabricante y para efecto de una implementación que permita trabajar en el rango establecido de impedancias para tejido animal, surge como guía el documento CN-0217, en donde es habilitado la escala entre 100ohms a 1Kohms, que de otra forma el AD5933 no podría procesar individualmente [7].

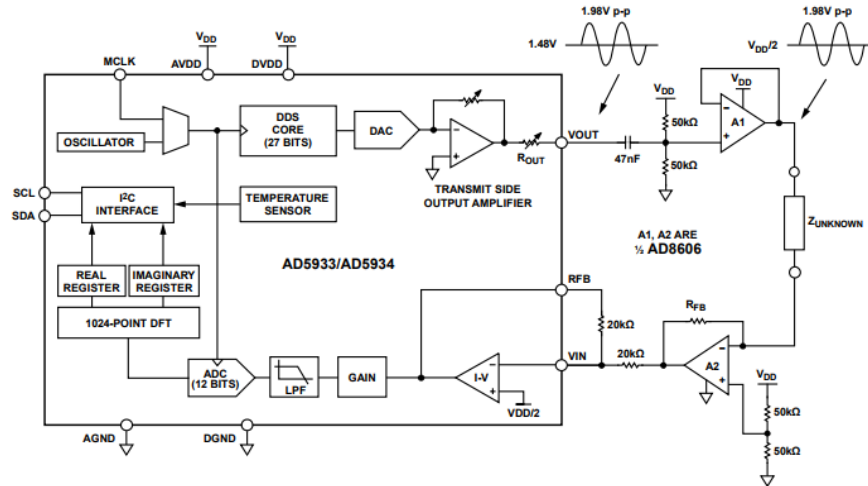


Figura 5: Sistema Circuital Bioimpedanciometro

El sistema circuital diseñado en esta sección busca un filtrado de la señal de DC, es decir, de las tensiones o corrientes de polarización y/o offset del IC, para evitar imprecisiones que incrementen el error entre datos teóricos y datos reales. Posterior a ello se utilizan amplificadores con configuración de buffer, en función de tener la impedancia más baja posible a la salida de dicho sistema. Adicional a ello se utiliza una función de apoyo en donde se capta un primer dato de referencia que le indica al circuito el orden de las impedancias a sensor, disminuyendo en este sentido la posibilidad de grandes fluctuaciones de los datos recopilados. Para tal fin se selecciona una resistencia de calibración que se encuentre en una posición media en la escala de datos obtenibles.

