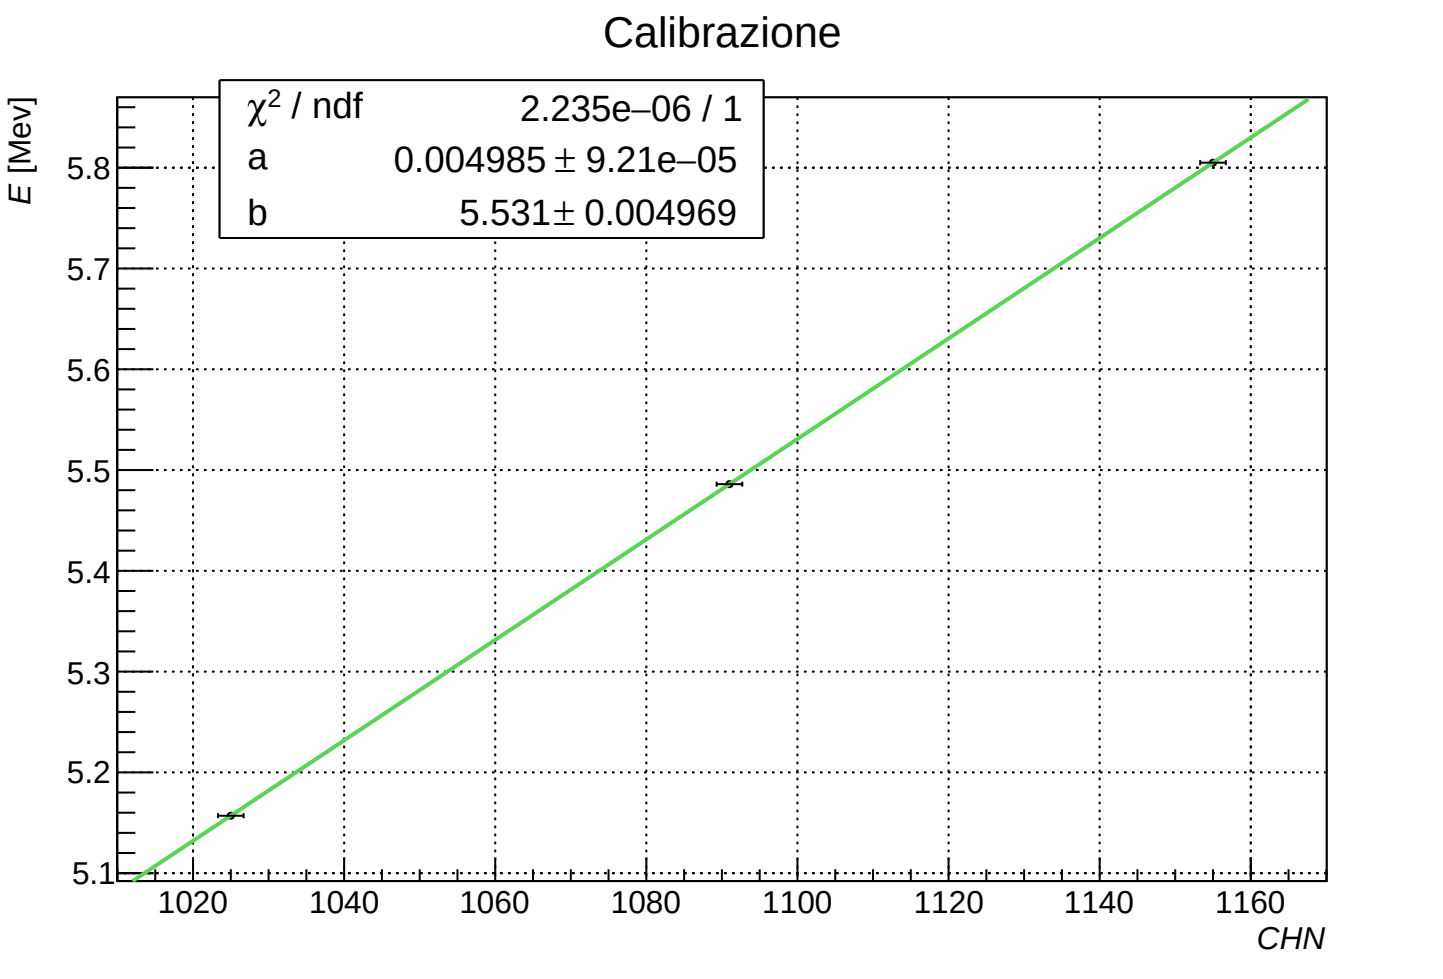
Calibrazione
χ² / ndf 2.235e−06 / 1
a 0.004985 ± 9.21e−05
b 5.531 ± 0.004969
E [Mev]
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
CHN