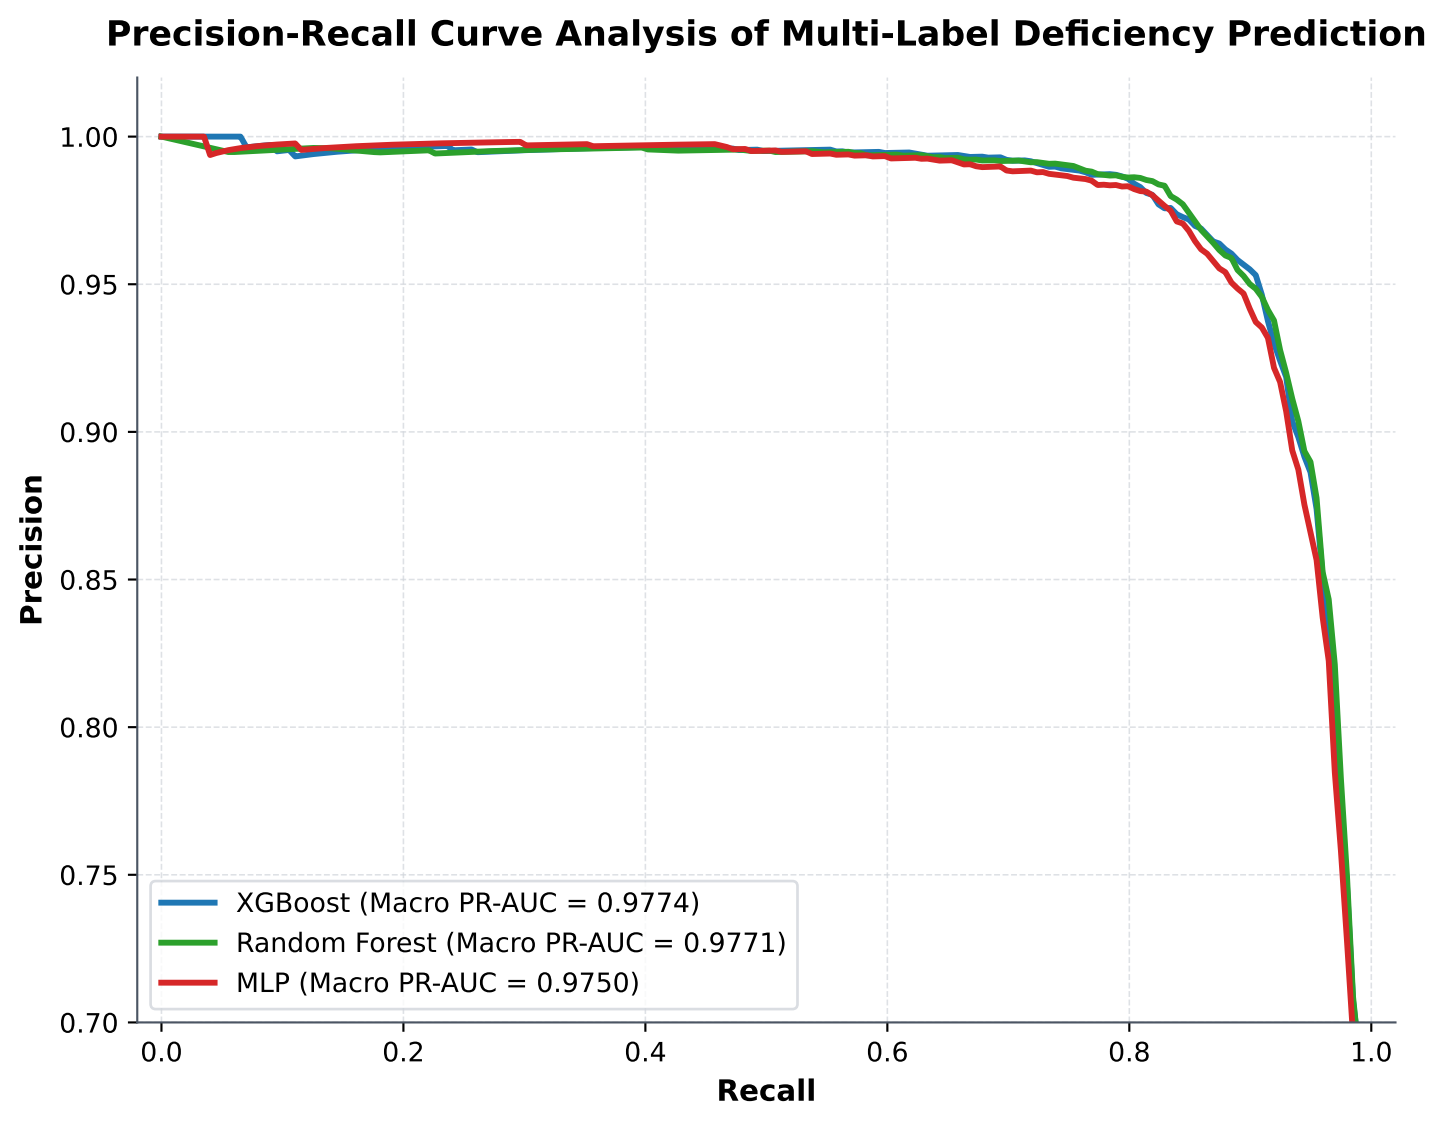
Precision-Recall Curve Analysis of Multi-Label Deficiency Prediction
Precision
Recall
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
XGBoost (Macro PR-AUC = 0.9774)
Random Forest (Macro PR-AUC = 0.9771)
MLP (Macro PR-AUC = 0.9750)