

PRUEBAS SEGURAS

Este instrumento ha sido diseñado y probado de acuerdo con la norma IEC.

Publicación 61010: Requisitos de seguridad para la medición

electrónica Aparato. Este instrucción manual contiene advertencias y seguridad reglas que debe observar el usuario para garantizar un funcionamiento seguro de el instrumento y mantenerlo en condiciones seguras. Por lo tanto, lea atentamente Lea estas instrucciones de funcionamiento antes de empezar a utilizar el instrumento.

IMPORTANTE:

1. Este instrumento solo debe ser utilizado por personal competente y capacitado. persona y operado en estricta conformidad con las instrucciones. KYORITSU no aceptará responsabilidad por ningún daño o lesión causada por mal uso o incumplimiento con el instrucciones o con el seguridad procedimientos.
2. Él es básico a leer y a entender el seguridad normas contenido en las instrucciones o con los procedimientos de seguridad.
- 3.

❖ El símbolo  lo indicado en el instrumento significa que el usuario debe consultar Consulte las secciones correspondientes del manual para el funcionamiento seguro del instrumento. seguro a con cuidado Lea las instrucciones. siguiente cada símbolo  en este manual.




 PELIGRO	Está reservado para situaciones y acciones que puedan causar lesiones graves o mortales.
 ADVERTENCIA	Está reservado para situaciones y acciones que puedan causar lesiones graves o mortales.

Medición categorías (Sobretensión) categorías)

Para garantizar el funcionamiento seguro de los instrumentos de medición, la norma IEC 61010 establece: seguridad estándares para varios eléctrico entornos, categorizado como O a CAT IV, y denominadas categorías de medición. Categorías con números más altos. corresponden a entornos eléctricos con mayor energía momentánea, por lo que a medición instrumento diseñado para GATO III entornos poder perdurar mayor que momentáneo energía *más de uno diseñado para CAT II.*

O	Circuitos de medición sin CATEGORÍA DE MEDICIÓN.
GATO II	Circuitos eléctricos de equipos conectados a una red eléctrica de CA salida por a fuerza cable.
CAT III	Circuitos eléctricos primarios de los equipos conectados directamente al panel de distribución, y alimentadores desde el panel de distribución hasta las tomas de corriente.

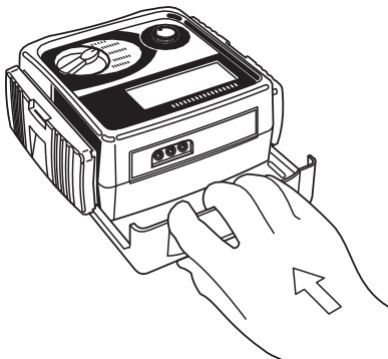

- Interruptor diferencial tipo AC, que garantiza el disparo ante corrientes alternas sinusoidales residuales, ya sean de aplicación repentina o de aumento gradual. Este tipo es el más utilizado en instalaciones eléctricas.