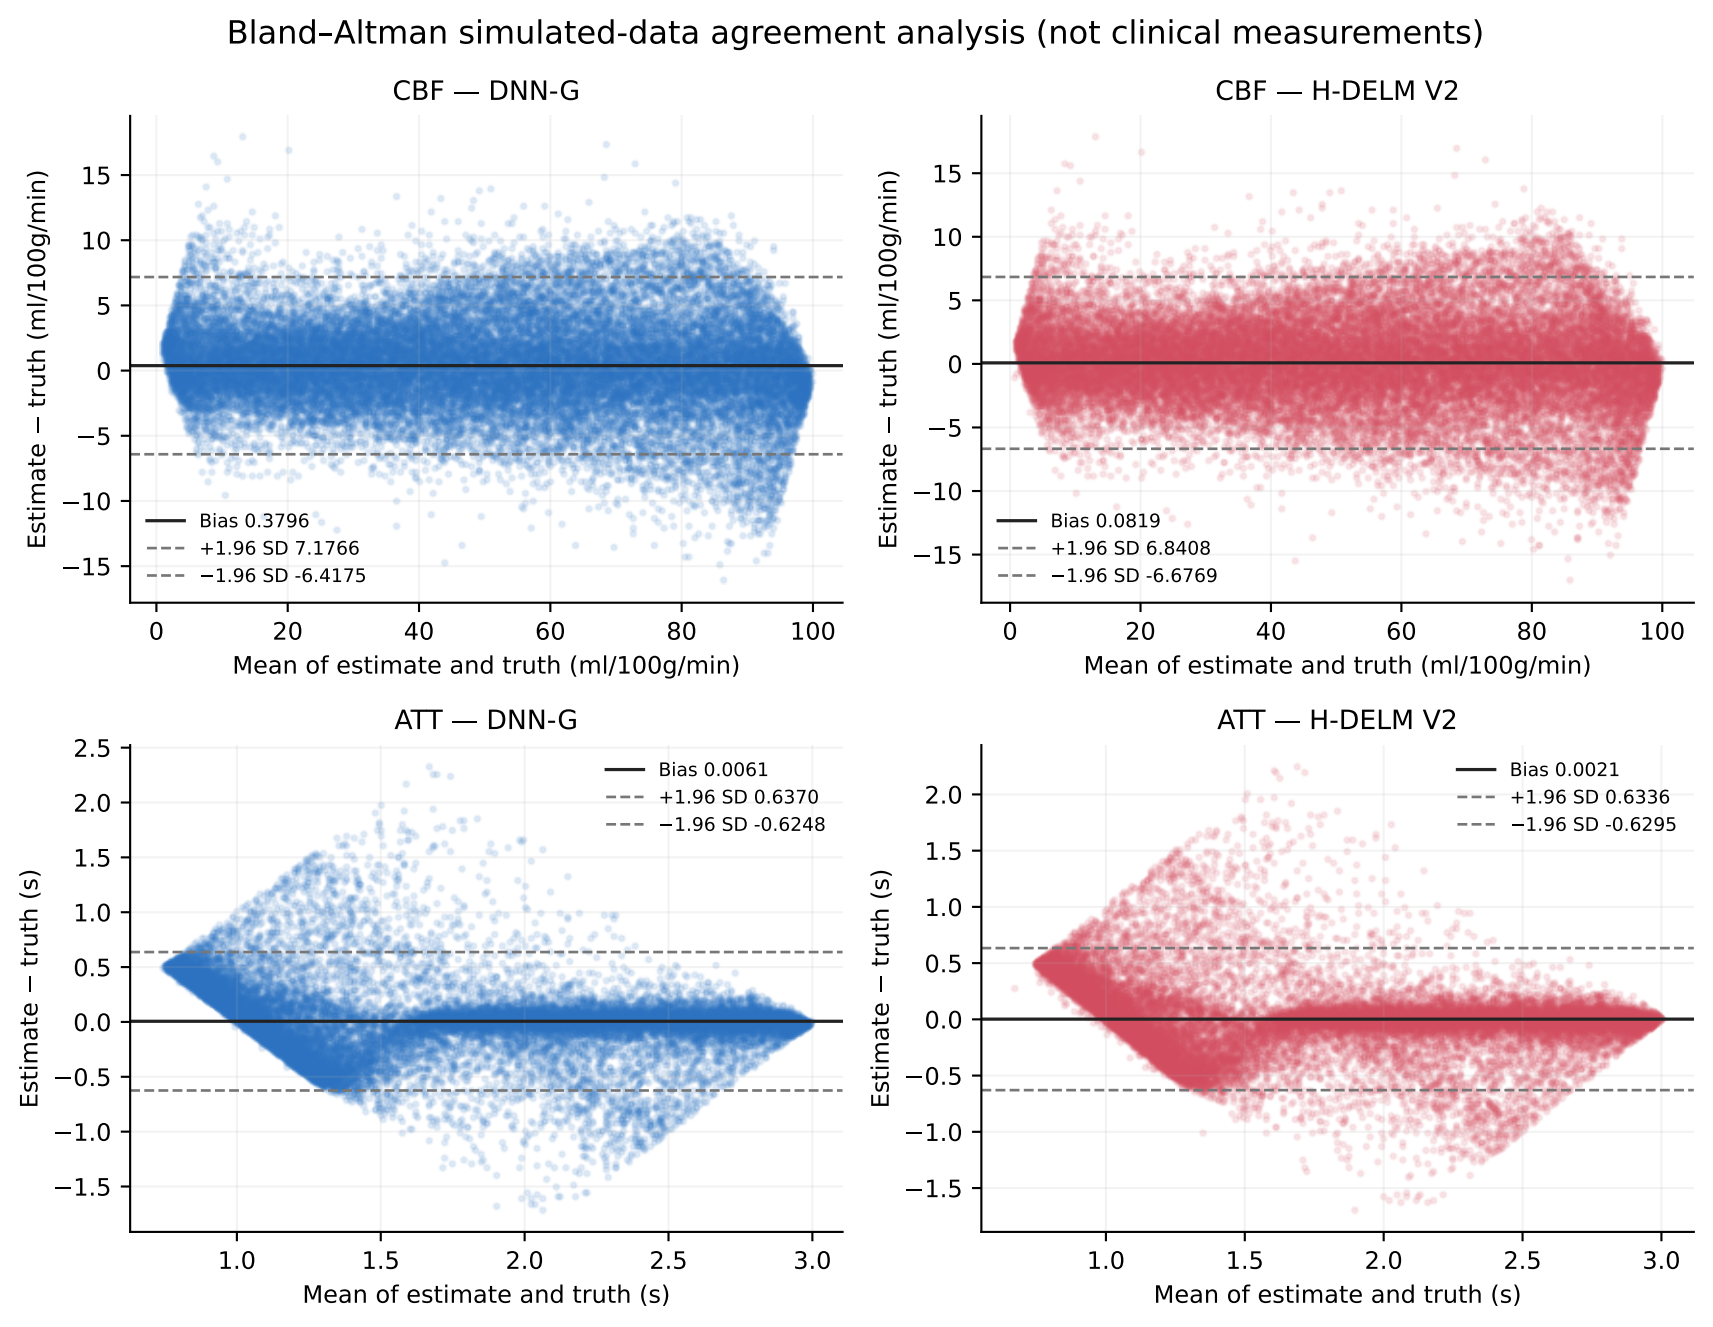

Bland–Altman simulated-data agreement analysis (not clinical measurements)
CBF — DNN-G
Bias 0.3796
+1.96 SD 7.1766
−1.96 SD -6.4175
Estimate − truth (ml/100g/min)
Mean of estimate and truth (ml/100g/min)
CBF — H-DELM V2
Bias 0.0819
+1.96 SD 6.8408
−1.96 SD -6.6769
Estimate − truth (ml/100g/min)
Mean of estimate and truth (ml/100g/min)
ATT — DNN-G
Bias 0.0061
+1.96 SD 0.6370
−1.96 SD -0.6248
Estimate − truth (s)
Mean of estimate and truth (s)
ATT — H-DELM V2
Bias 0.0021
+1.96 SD 0.6336
−1.96 SD -0.6295
Estimate − truth (s)
Mean of estimate and truth (s)