


700-616

心室率	118 bpm
PR 间期	80 ms
QRS 宽度	96 ms
QT/QTc	342/479 ms
P-R-T轴	-48 -4 -81

数据质量较差,可能对解释造成不利影响

未确认

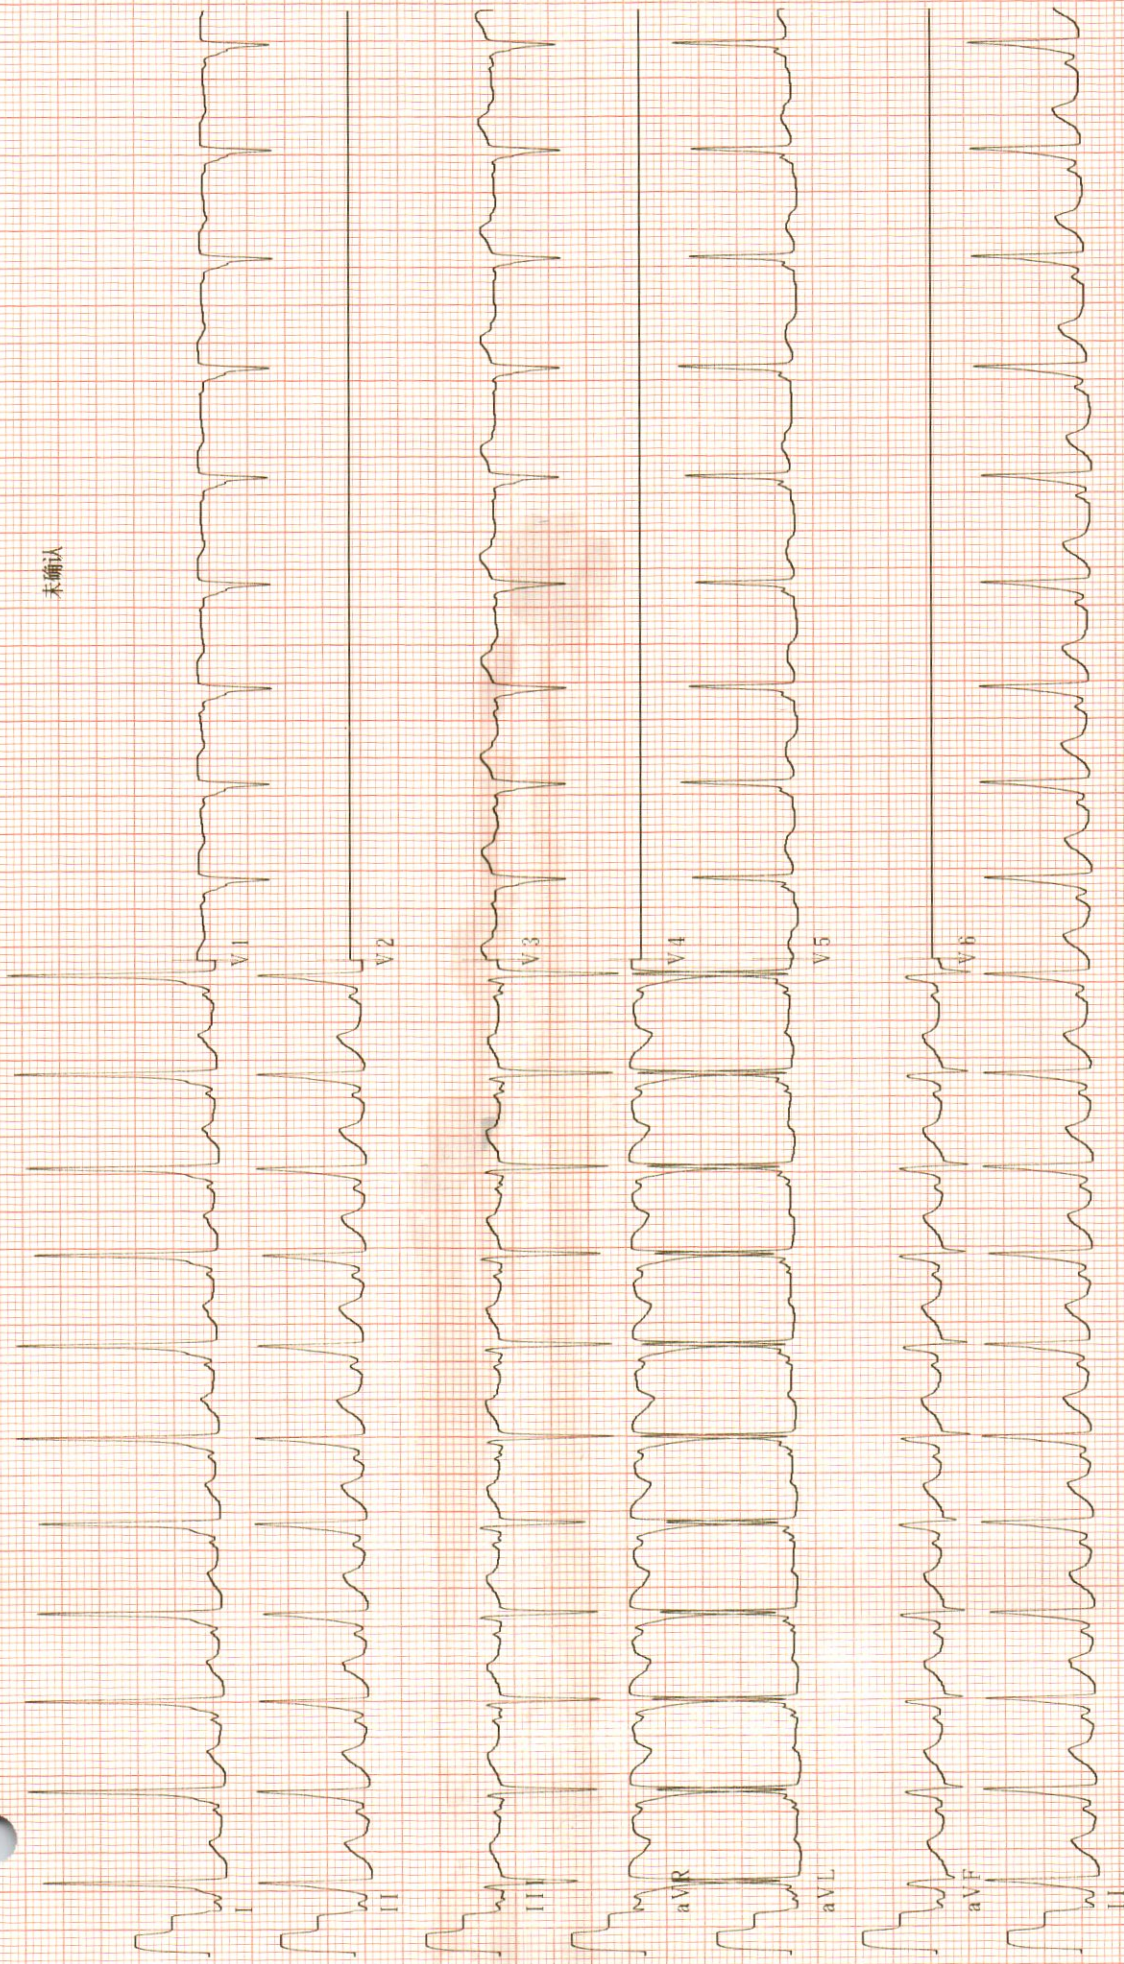

★★ 位于 1/2 增益的胸部导联★★
40 Hz 25.0 mm/s

10.0/5.0 mm/mV
emium

$2 \times 5s + 1$ 节律串联
marquette electronics, inc.

MAC55 009C
Jupiter, Florida U.S.A.

12SL TM v239