

ROHDE & SCHWARZ FPC1000 - Spectrum Analyzer

7/12/2023 23:54

Bandwidth

Spectrum Analyzer - Spectrum

REF: 0 dBm
ATT: 20 dB

RBW: 100 Hz

VBW: 100 Hz
Trigger: Free

SWT: 72 ms

RBW: 100 Hz


RBW: Manual

RBW: Auto

VBW: Manual


VBW: Auto

* 1 AP Cirw

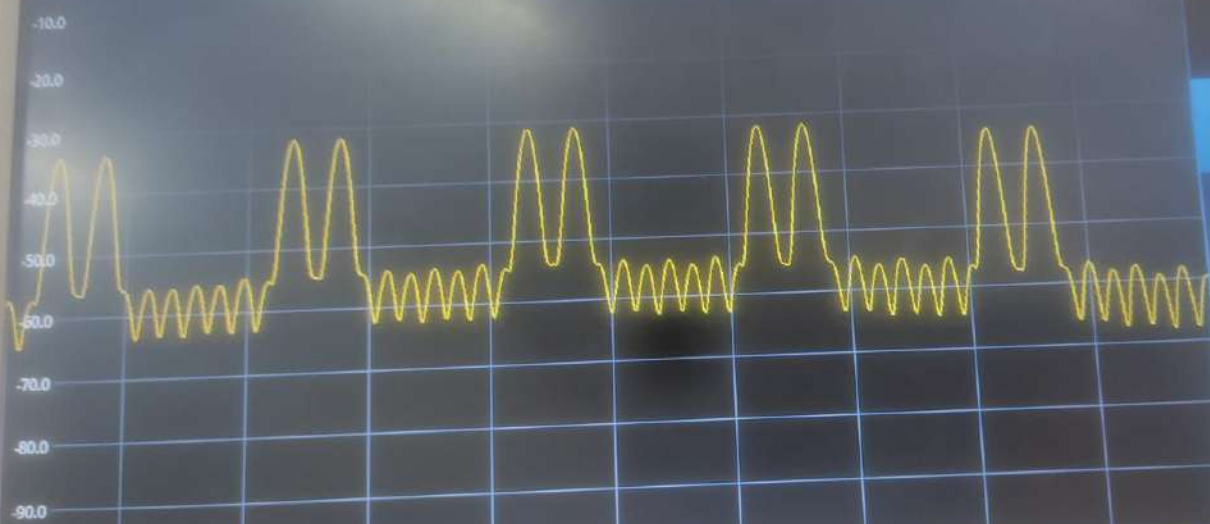

Span 10 kHz

Center 499.999992 MHz

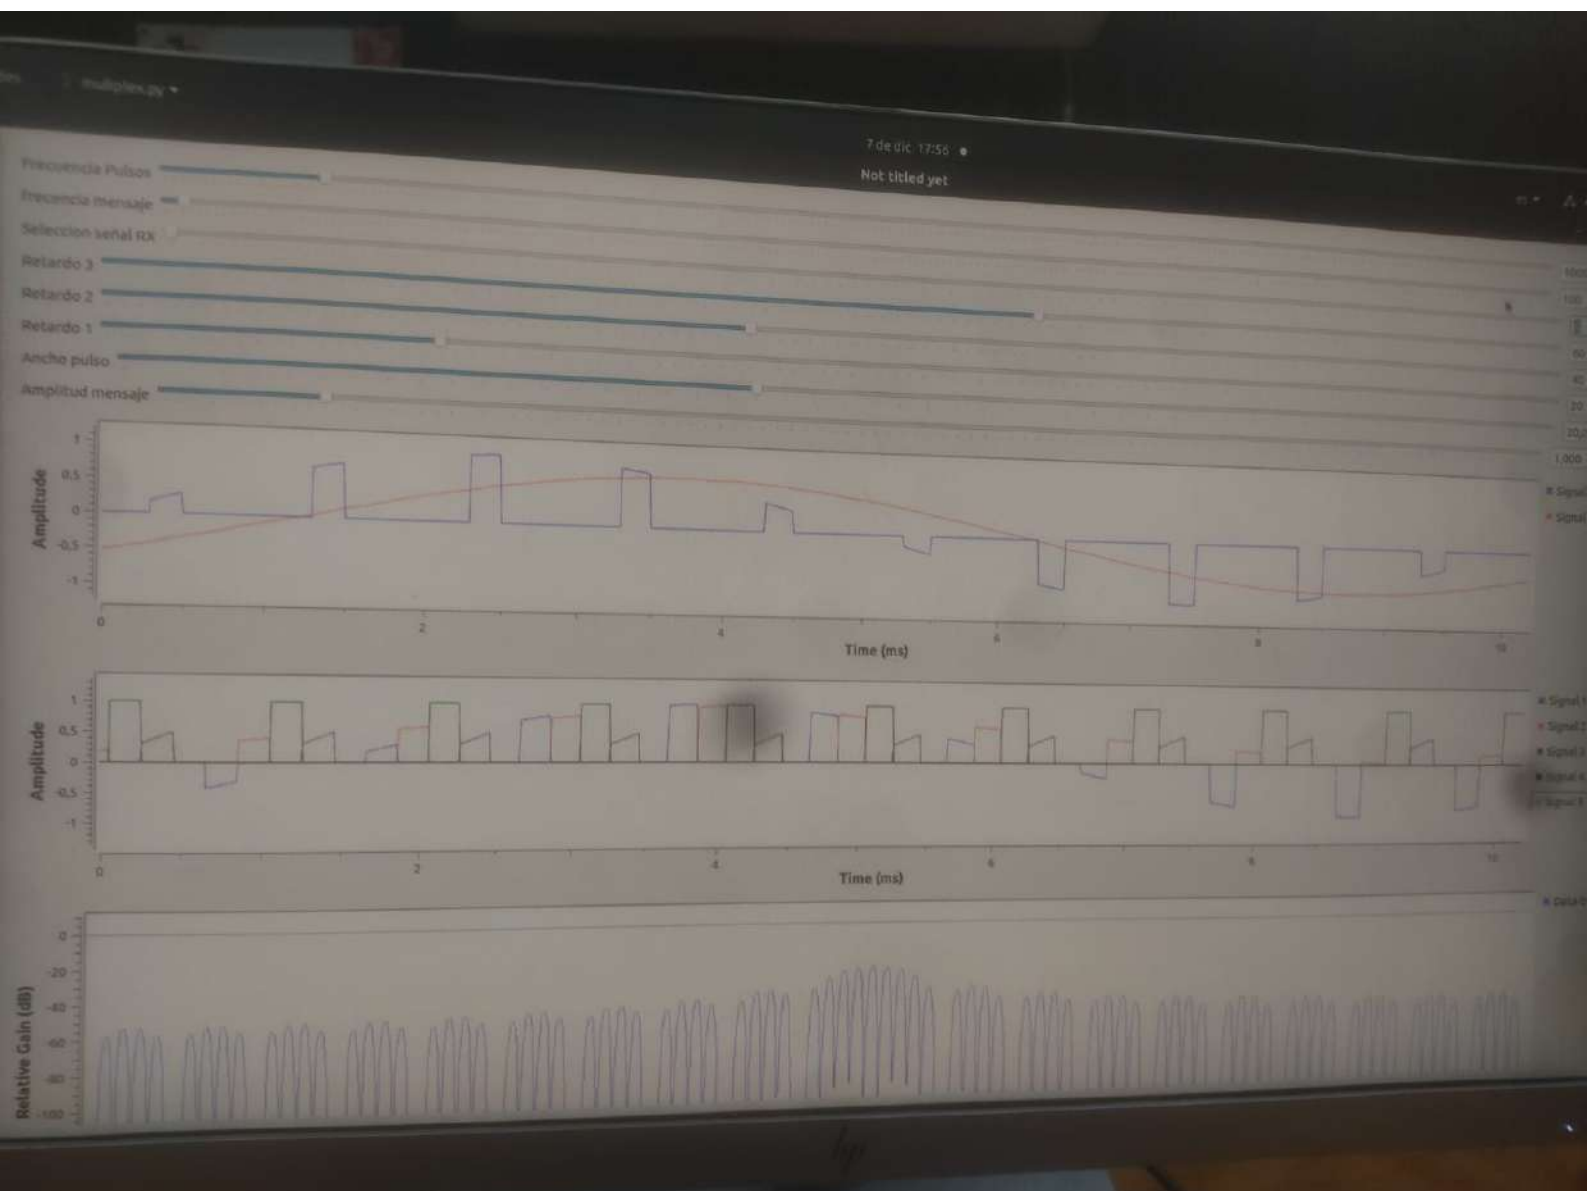

Spectrum Analyzer - Spectrum

7/12/2023 23:54

Bandwidth

REF: 0 dBm

RBW: 100 Hz

VBW: 100 Hz

SWT: 72 ms

RBW 100 Hz

RBW: Manual

ATT: 20 dB

Trigger: Free

RBW: Auto

VBW: Manual


VBW: Auto

• 1 AP Clrw




Center 499.999992 MHz

Span 10 kHz

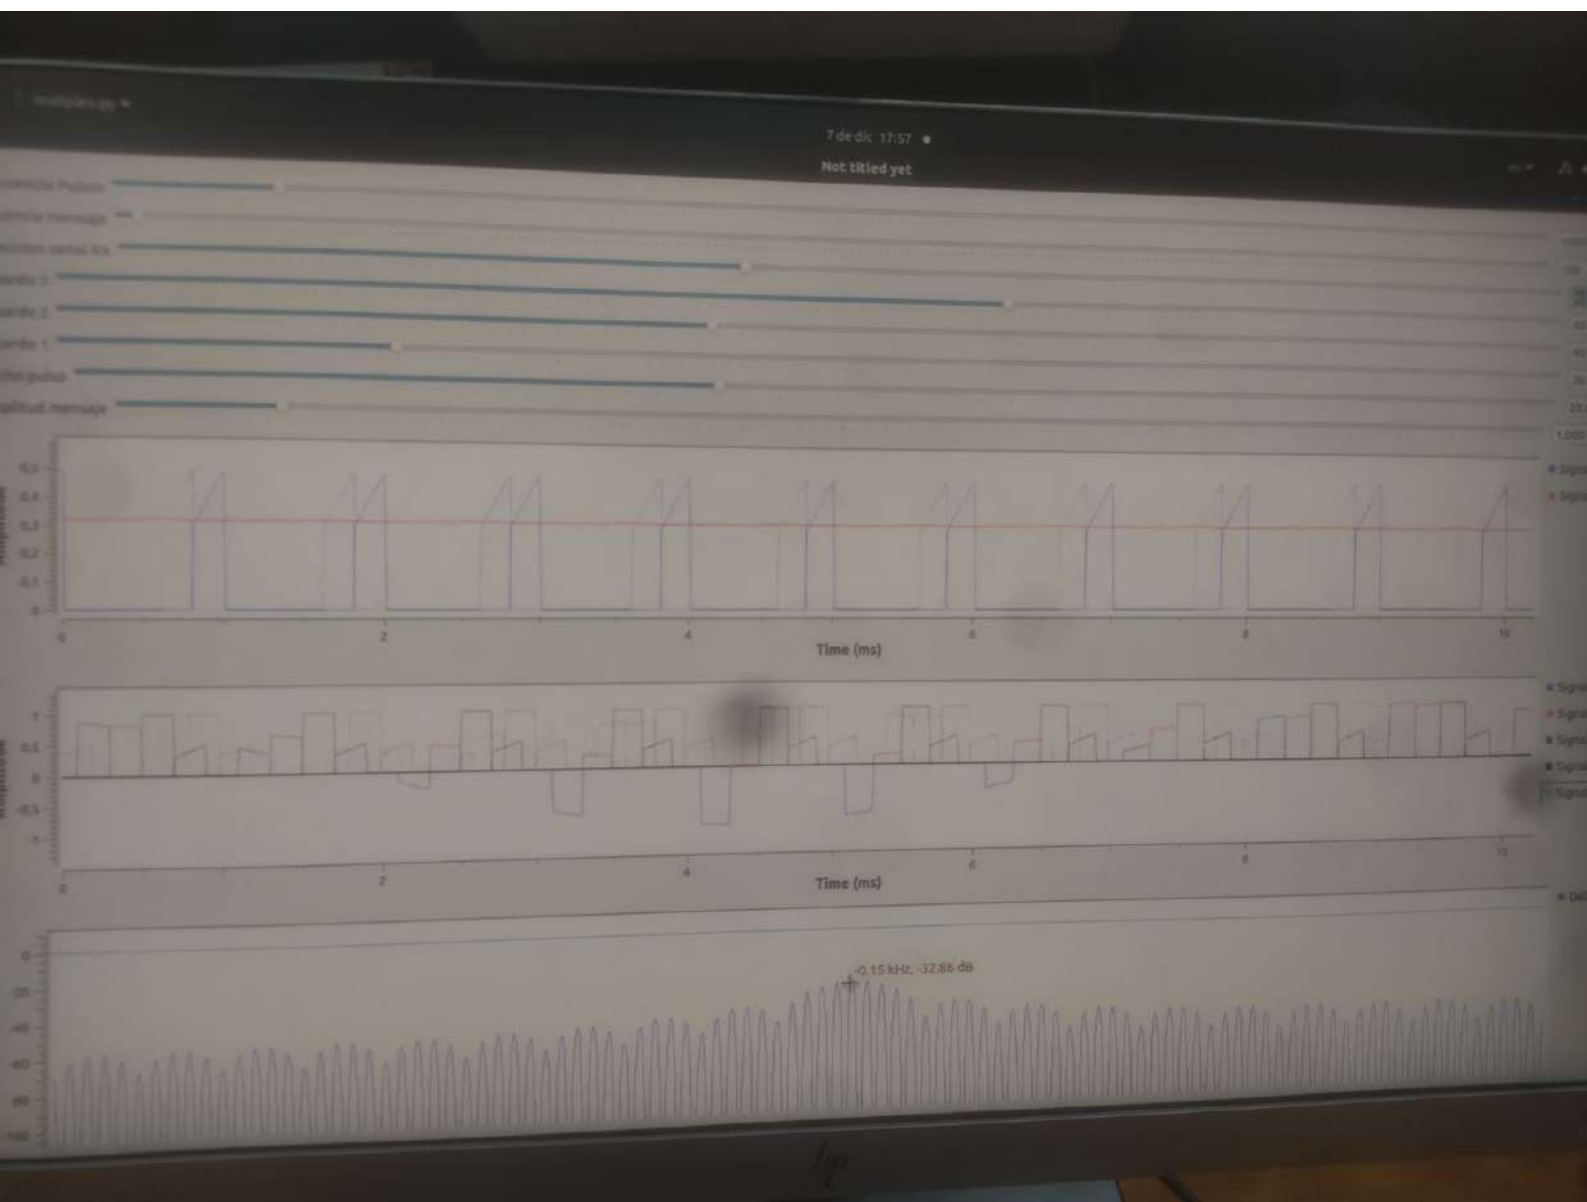

ROHDE & SCHWARZ FPC1000 · Spectrum Analyzer



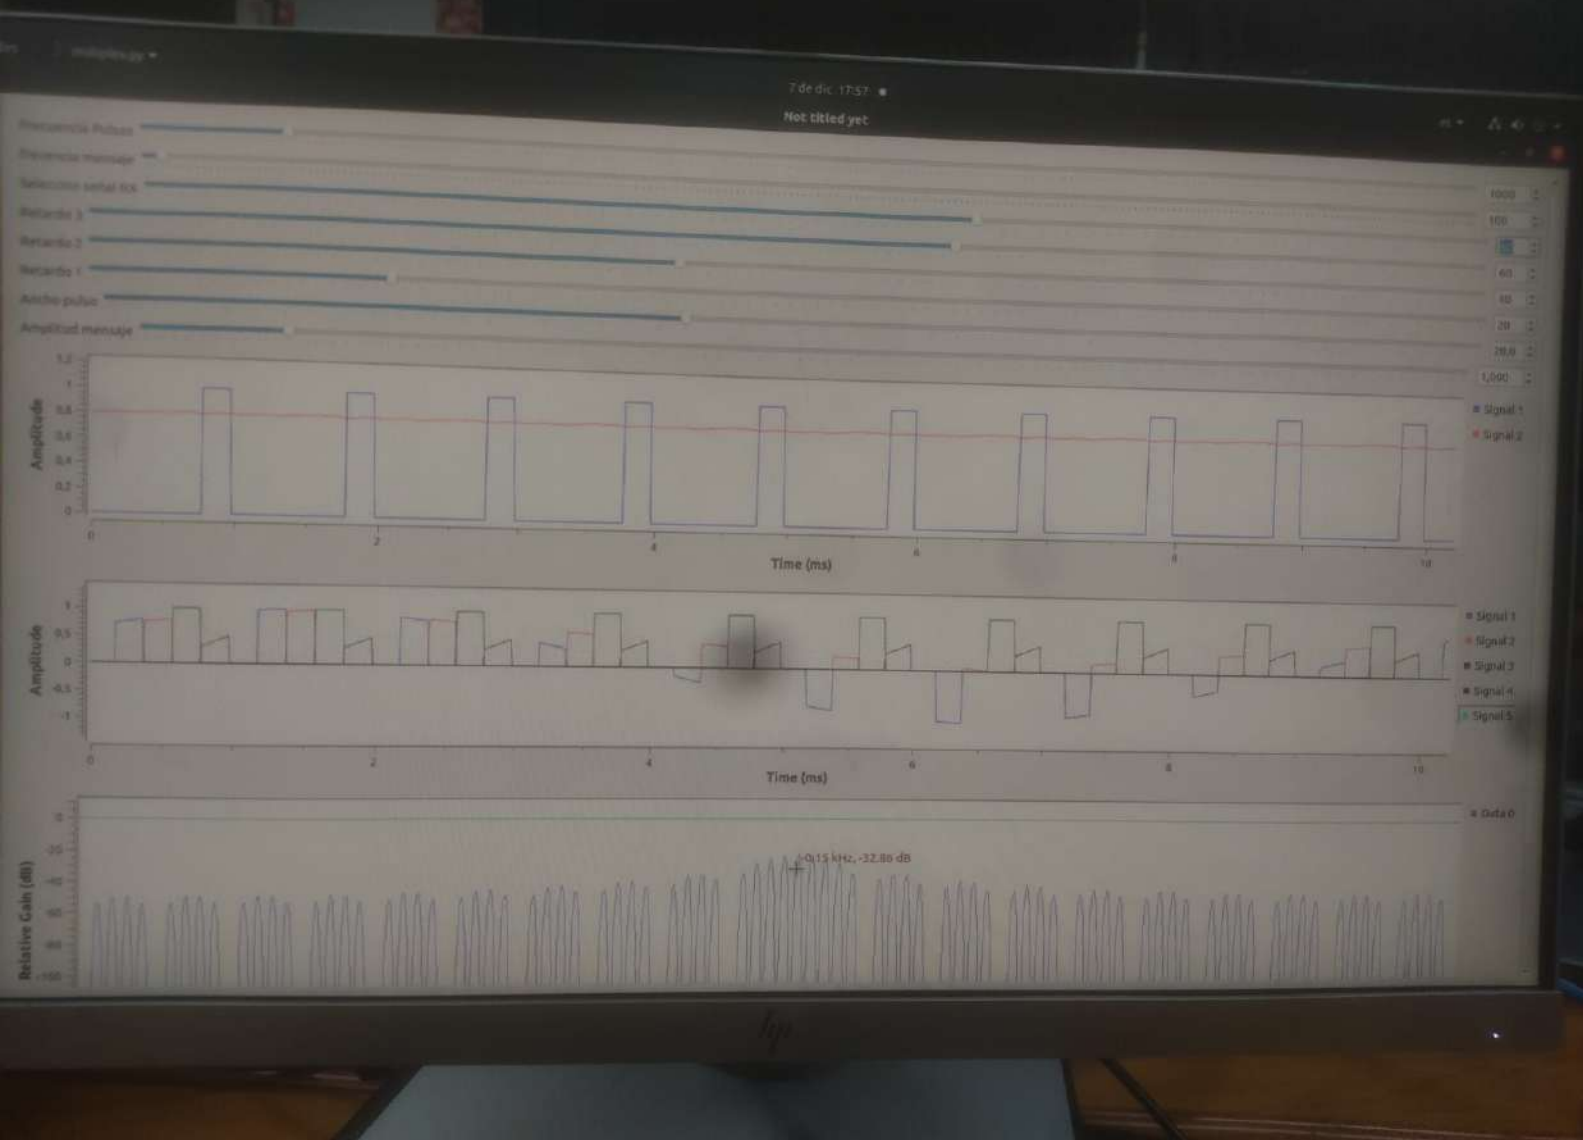

RONDE & SCHWARZ FPC1000 · Spectrum Analyzer

Spectrum Analyzer - Spectrum

7/12/2023 23:55

Bandwidth

REF: 0 dBm
ATT: 20 dB

*RBW: 100 Hz

VBW: 100 Hz
Trigger: Free

SWT: 72 ms

RBW: 100 Hz

RBW:
Manual

* 1 AP: Clw

RBW:
Auto

VBW:
Manual

VBW:
Auto



Center 499.999992 MHz

Span 10 kHz

7 de dic. 17:57
Not titled yet

Frecuencia Pulso
Frecuencia mensaje
Selección señal RX
Retardo 3
Retardo 2
Retardo 1
Ancho pulso
Amplitud mensaje

