


Tek

...

Scan

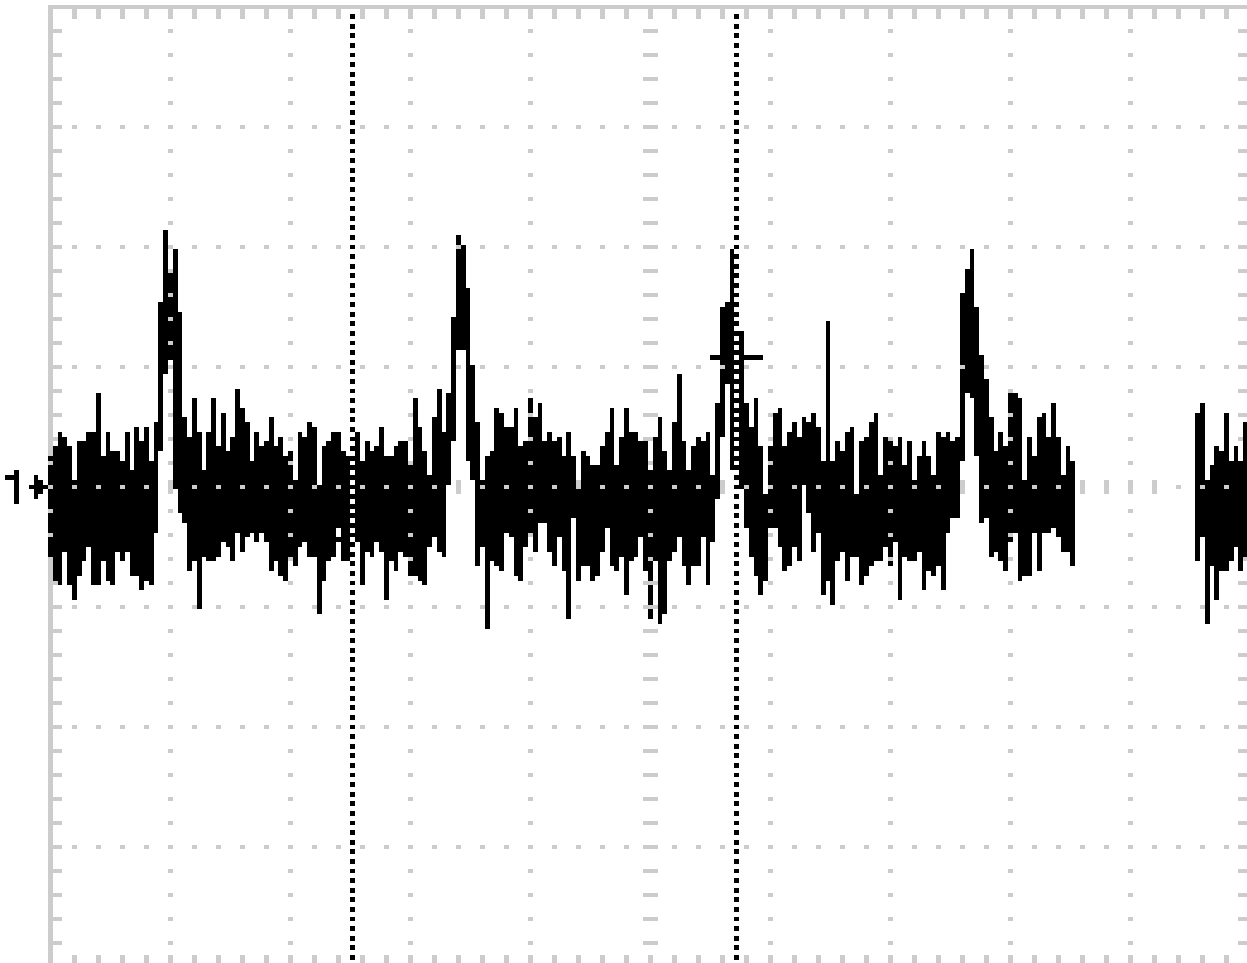

CH1 10.0mV/Bw

M 500ms

CH1 80.0mV

Zum Ändern der Messung Bildschirmtaste drücken

MESSUNG

CH1
Mittelwert
?

CH1
Freq.
?

CH1
Periode
?

CH1
Uss
?

CH1
+Pulsbreite
?