

Tek




● Stop

M Pos: 0.000s

MESSUNG

1+

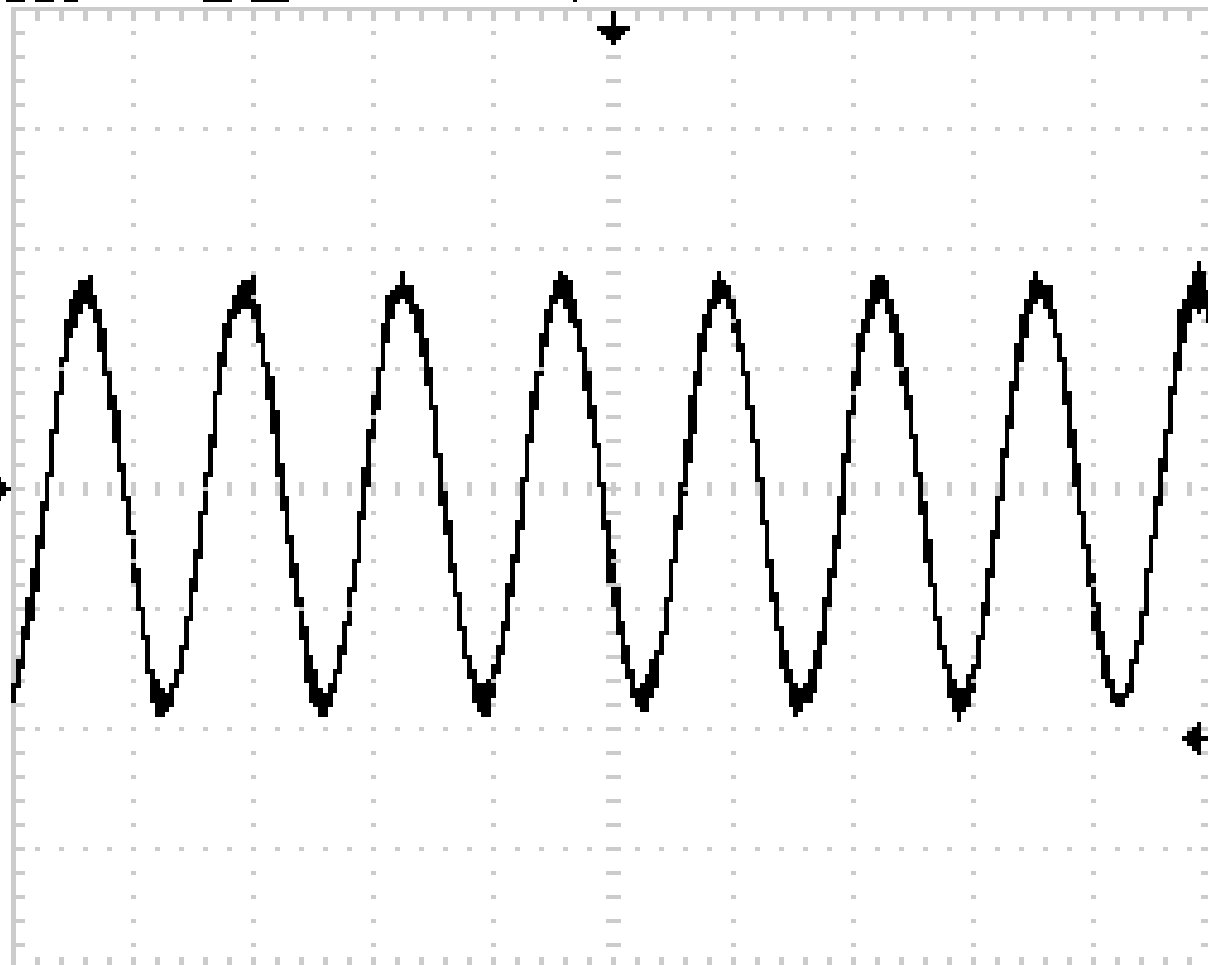

CH1  
Mittelwert  
-123 μV

CH1  
Freq.  
3.021 kHz

CH1  
Periode  
331.0 μs

CH1  
U<sub>ss</sub>  
19.0 mV

CH1  
+Pulsbreite  
163.7 μs

CH1 5.00 mV

M 250 μs

CH1  $\nearrow$  -10.4 mV

Zum Ändern der Messung Bildschirmtaste drücken