


Tek  T Trig'd M Pos: 0.000s

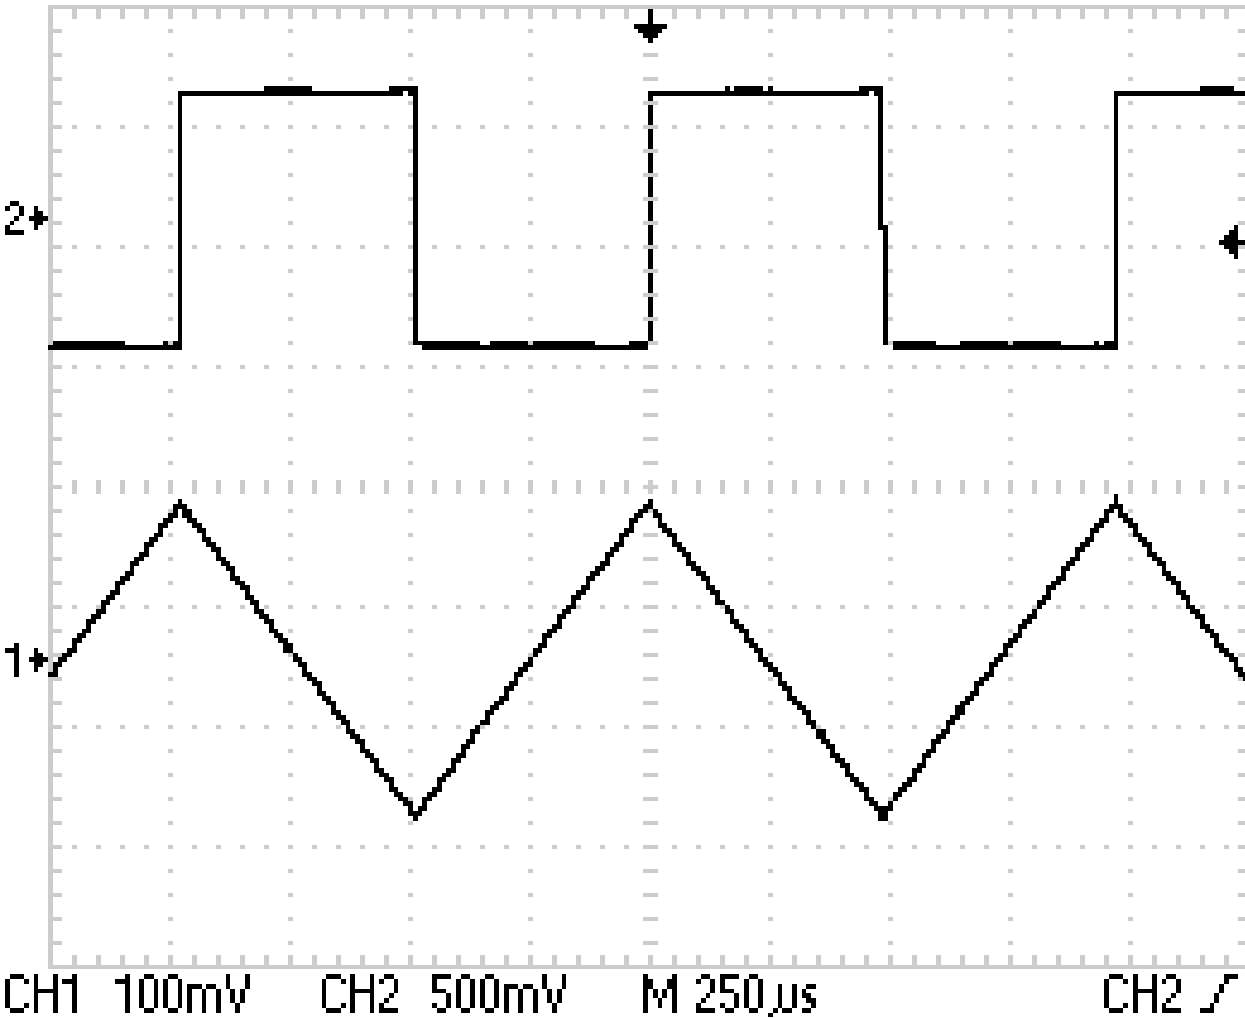

MESSUNG

CH2
Mittelwert
-3.36mV

CH2
Uss
1.08V

CH2
Periode
973.7µs

CH1
Uss
264mV

CH1
Mittelwert
12.5mV

CH1 100mV CH2 500mV M 250µs CH2 \nearrow -95.5mV

Zum Ändern der Messung Bildschirmtaste drücken