Rec : 28.08.2031 15:39 Name : **A** 100Years F Ref.Dr.: Consult Dr.:

00cms 00kg PM : n 0:00:10 00/00 mmHg Indian Drug1: No Medication Drug2: No Medication

ID : 0000603 **Hospital : ABCDEFG1234567890HOSPITAL** Diagnosis : Normal Page 1/3

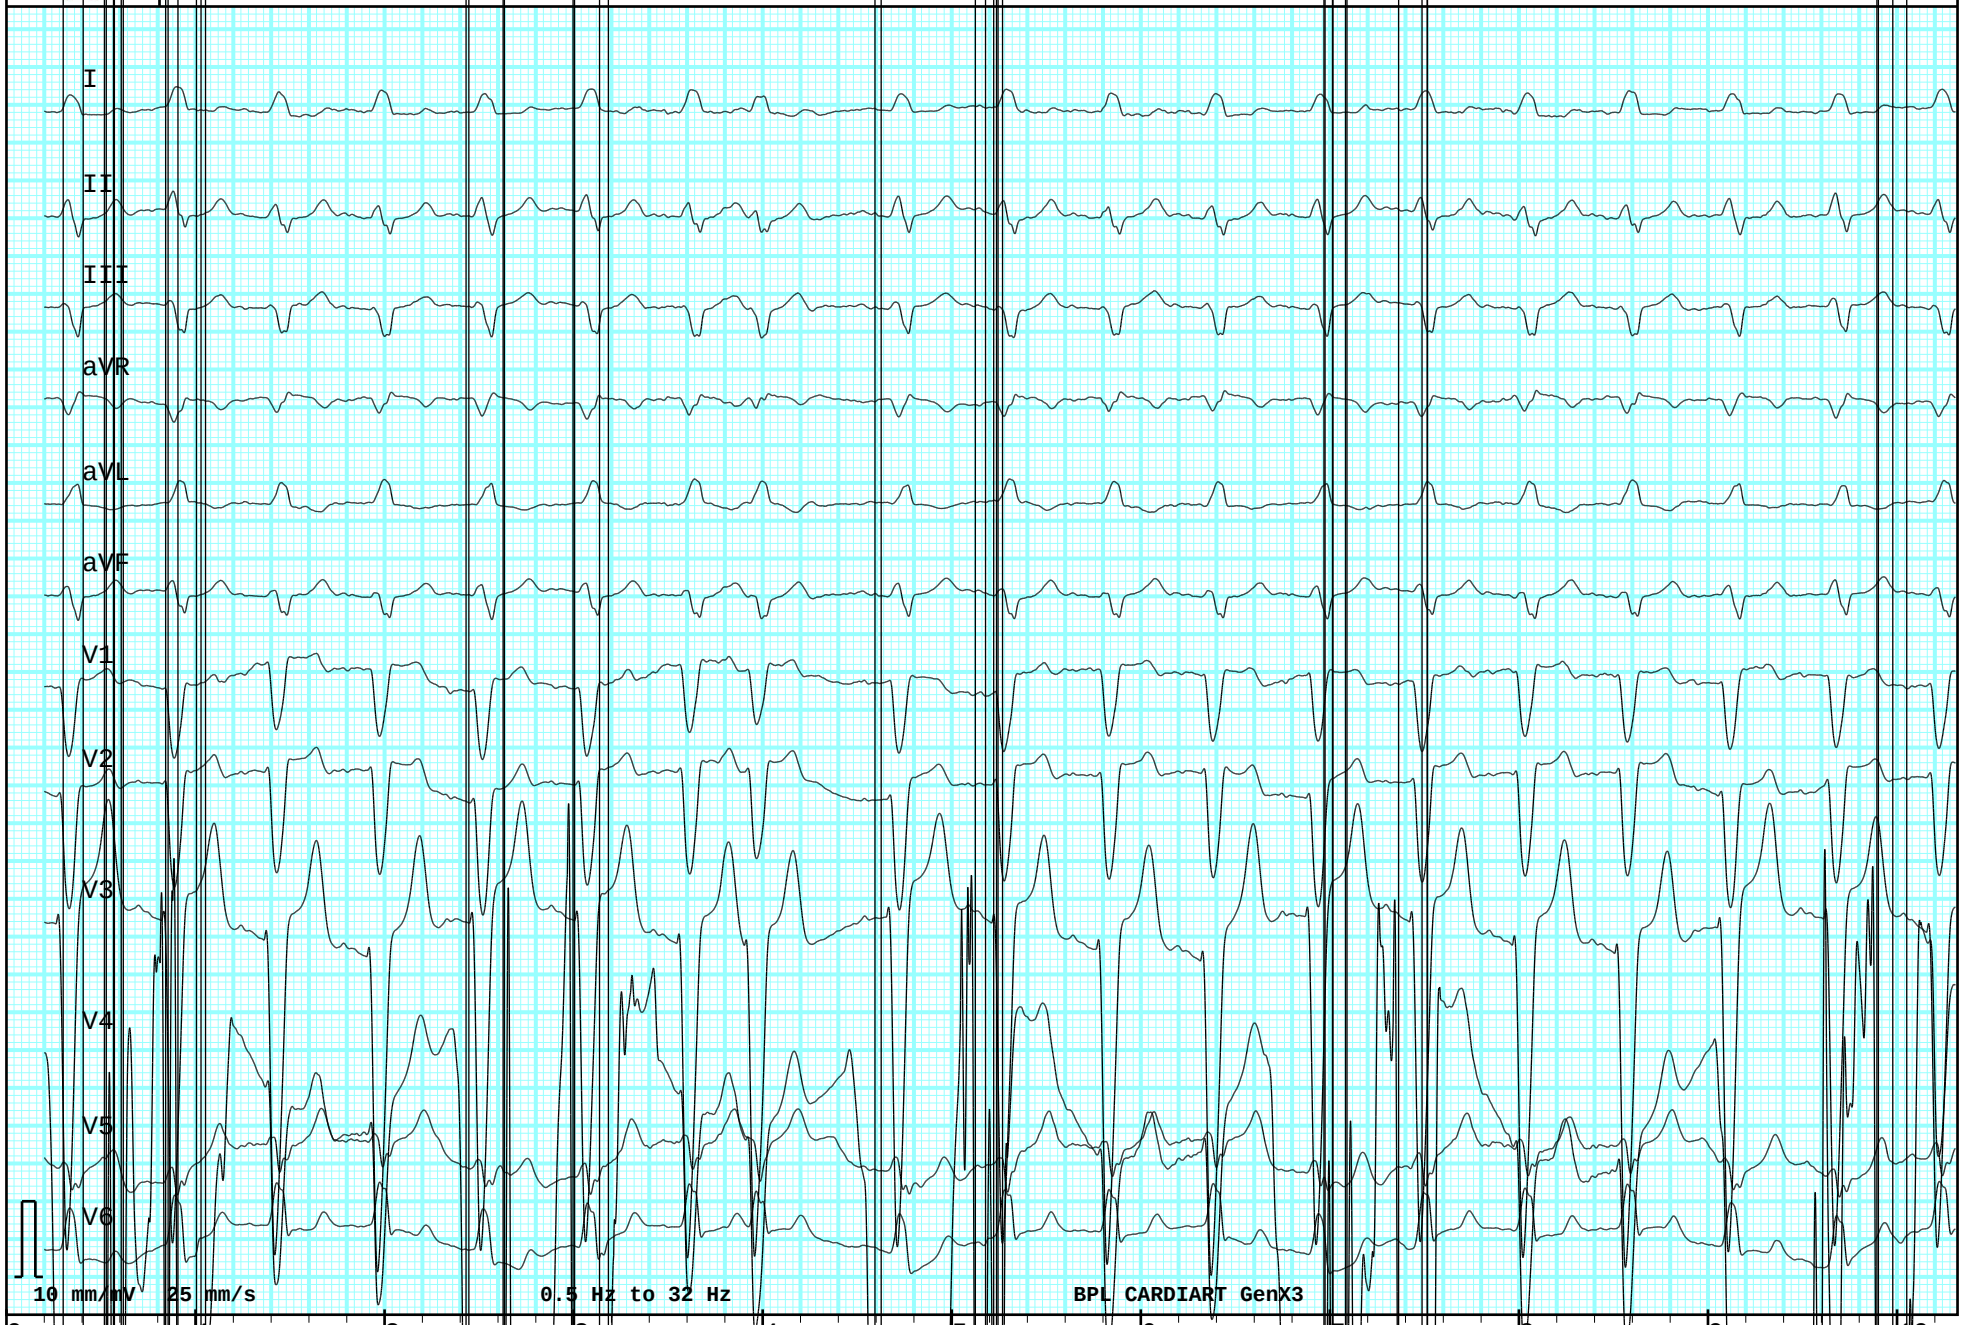

Clinician's Comments :

Rec : 28.08.2031 15:39 Name : **A**
100Years F 00cms 00kg Indian
PM : n 00/00 mmHg **ID : 0000603**

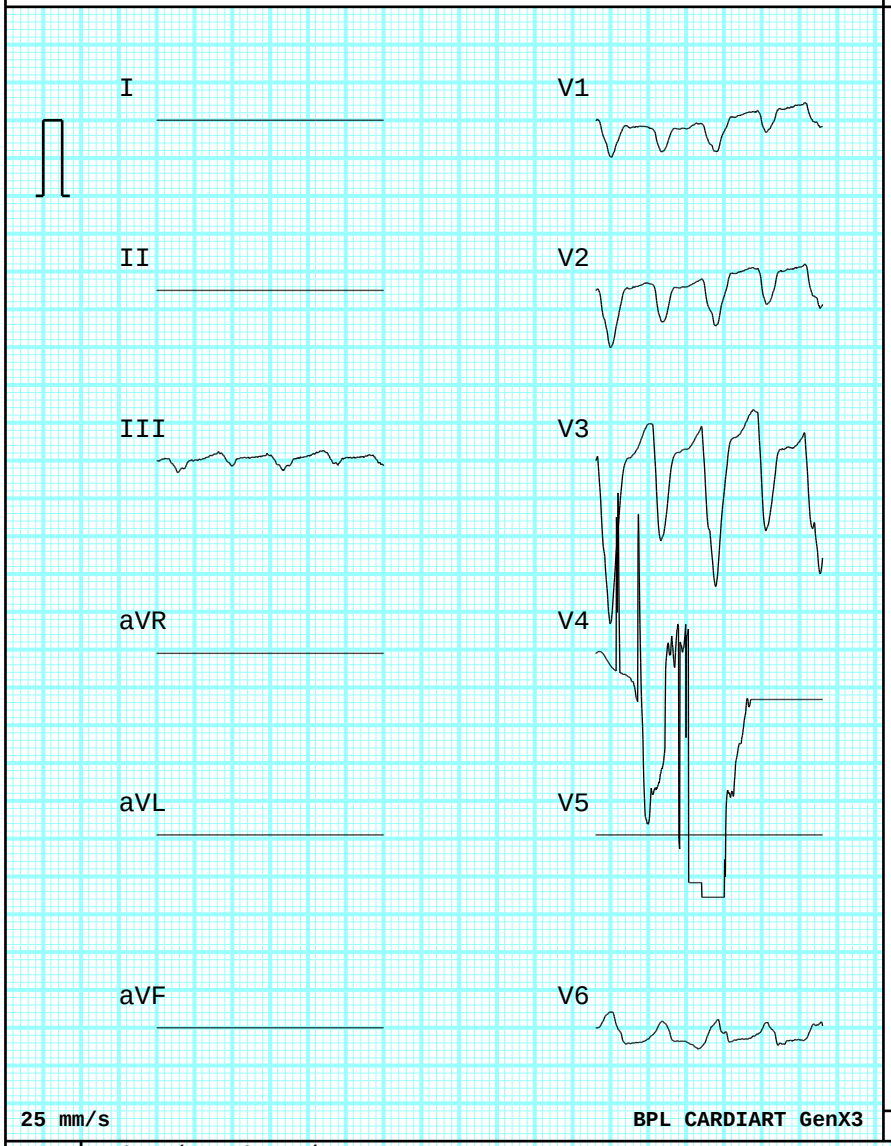

Heart Rate	52 bpm	HRV	0
QrsFrontalAxis	****	PFrontalAxis	****
STFrontalAxis	**** deg.	TFrontalAxis	**** deg.
ST Duration	56 ms	PR Interval	****
Q-T Interval	366 ms	QTc Hodges	352 ms
QT Dispersion	98 ms		
P Terminal Force	****		

Average beat fiducial point sample number

	Onset	Termination	Duration(ms)
P	306	456	150
QRS	478	578	100
T	634	844	210

Atrial fibrillation

Lead(s) unsuitable for analysis:

~ I

~ II

~ aVR

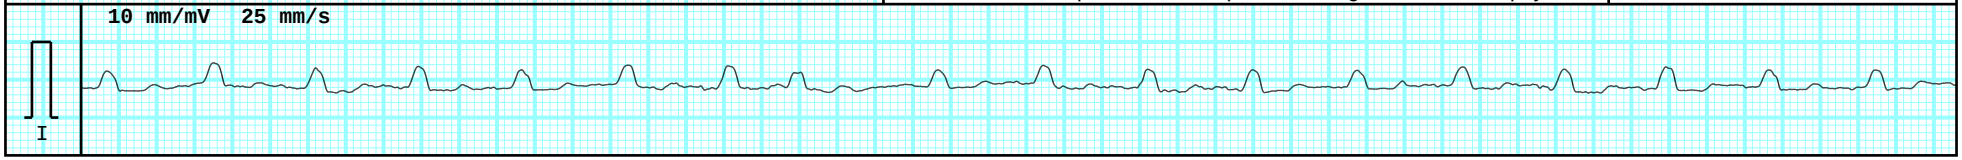

Disclaimer : This report does not replace the diagnosis of trained physician

2.102.841.5

BPL CARDIART GenX3 Measurement Matrix

ID : 0000603 Name : A

Abnormal ECG
of a trained physician

	I	II	III	aVR	aVL	aVF	V1	V2	V3/V4R	V4	V5	V6
P Ons(ms)	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
P Dur(ms)	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
QRS Ons	***	***	478	***	***	***	496	490	486	488	***	478
QRS Dur(ms)	***	***	100	***	***	***	74	88	80	72	***	92
Q Dur(ms)	***	***	39	***	***	***	0	0	0	72	***	92
R Dur(ms)	***	***	60	***	***	***	74	88	80	0	***	0
S Dur(ms)	***	***	0	***	***	***	0	0	0	0	***	0
R’ Dur(ms)	***	***	0	***	***	***	0	0	0	0	***	0
S’ Dur(ms)	***	***	0	***	***	***	0	0	0	0	***	0
R’’ Dur(ms)	***	***	0	***	***	***	0	0	0	0	***	0
S’’ Dur(ms)	***	***	0	***	***	***	0	0	0	0	***	0
ST Dur(ms)	***	***	48	***	***	***	72	60	70	74	***	72
T Ons	***	***	634	***	***	***	642	638	636	634	***	642
T Dur(ms)	***	***	180	***	***	***	202	206	208	116	***	96
P+ Dur(ms)	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
T+ Dur(ms)	***	***	0	***	***	***	158	150	142	0	***	96
QRS IntD	***	***	113	***	***	***	34	64	68	0	***	0
P+ Amp(mV)	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
P- Amp(mV)	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
P2P Amp(mV)	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Q Amp(mV)	***	***	-22	***	***	***	0	0	0	-7097	***	-130
R Amp(mV)	***	***	68	***	***	***	91	116	342	0	***	0
S Amp(mV)	***	***	0	***	***	***	0	0	0	0	***	0
R’ Amp(mV)	***	***	0	***	***	***	0	0	0	0	***	0
S’ Amp(mV)	***	***	0	***	***	***	0	0	0	0	***	0
R’’ Amp(mV)	***	***	0	***	***	***	0	0	0	0	***	0
S’’ Amp(mV)	***	***	0	***	***	***	0	0	0	0	***	0
ST Amp(mV)	***	***	26	***	***	***	-226	-340	-1307	-7770	***	140
ST80 Amp(mV)	***	***	-176	***	***	***	-239	-430	-1481	-4797	***	235
STT28 Amp(mV)	***	***	-143	***	***	***	-240	-431	-1482	-7852	***	307
STT38 Amp(mV)	***	***	-183	***	***	***	12	-53	-394	-4794	***	352
T+ Amp(mV)	***	***	0	***	***	***	281	318	657	0	***	360
T- Amp(mV)	***	***	-212	***	***	***	-378	-636	-2252	-8007	***	0
QRS Area	***	***	74	***	***	***	86	66	-499	-27545	***	-282
P Area	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
T Area	***	***	-665	***	***	***	538	-69	-4621	30131	***	1149
P Morph	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
T Morph	***	***	-1	***	***	***	-2	-2	-2	-1	***	1
R Notch	***	***	0	***	***	***	0	0	0	0	***	0