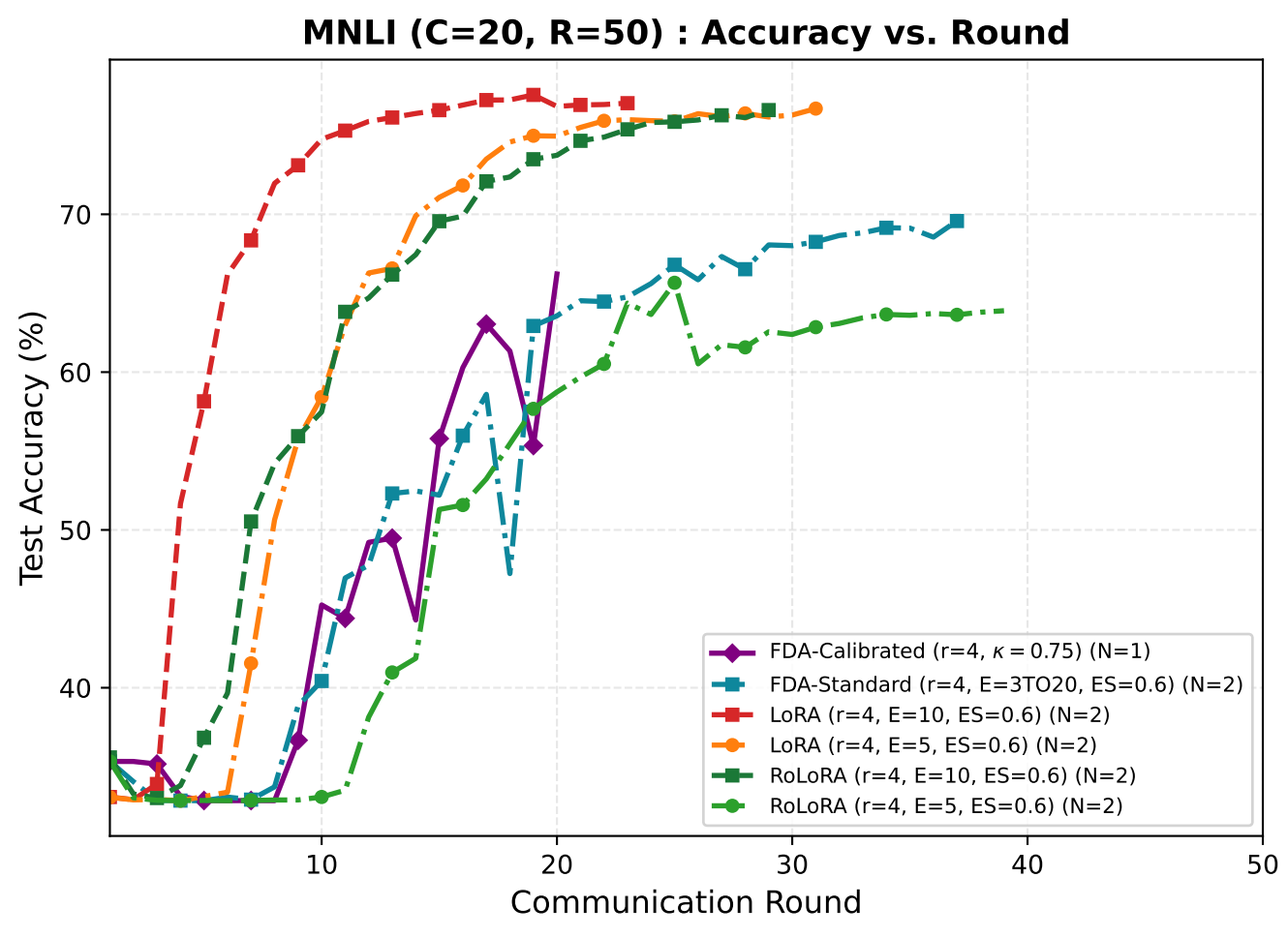
MNLI (C=20, R=50) : Accuracy vs. Round
Test Accuracy (%)
Communication Round
40
50
60
70
10
20
30
40
50
FDA-Calibrated (r=4, κ = 0.75) (N=1)
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.6) (N=2)
LoRA (r=4, E=10, ES=0.6) (N=2)
LoRA (r=4, E=5, ES=0.6) (N=2)
RoLoRA (r=4, E=10, ES=0.6) (N=2)
RoLoRA (r=4, E=5, ES=0.6) (N=2)

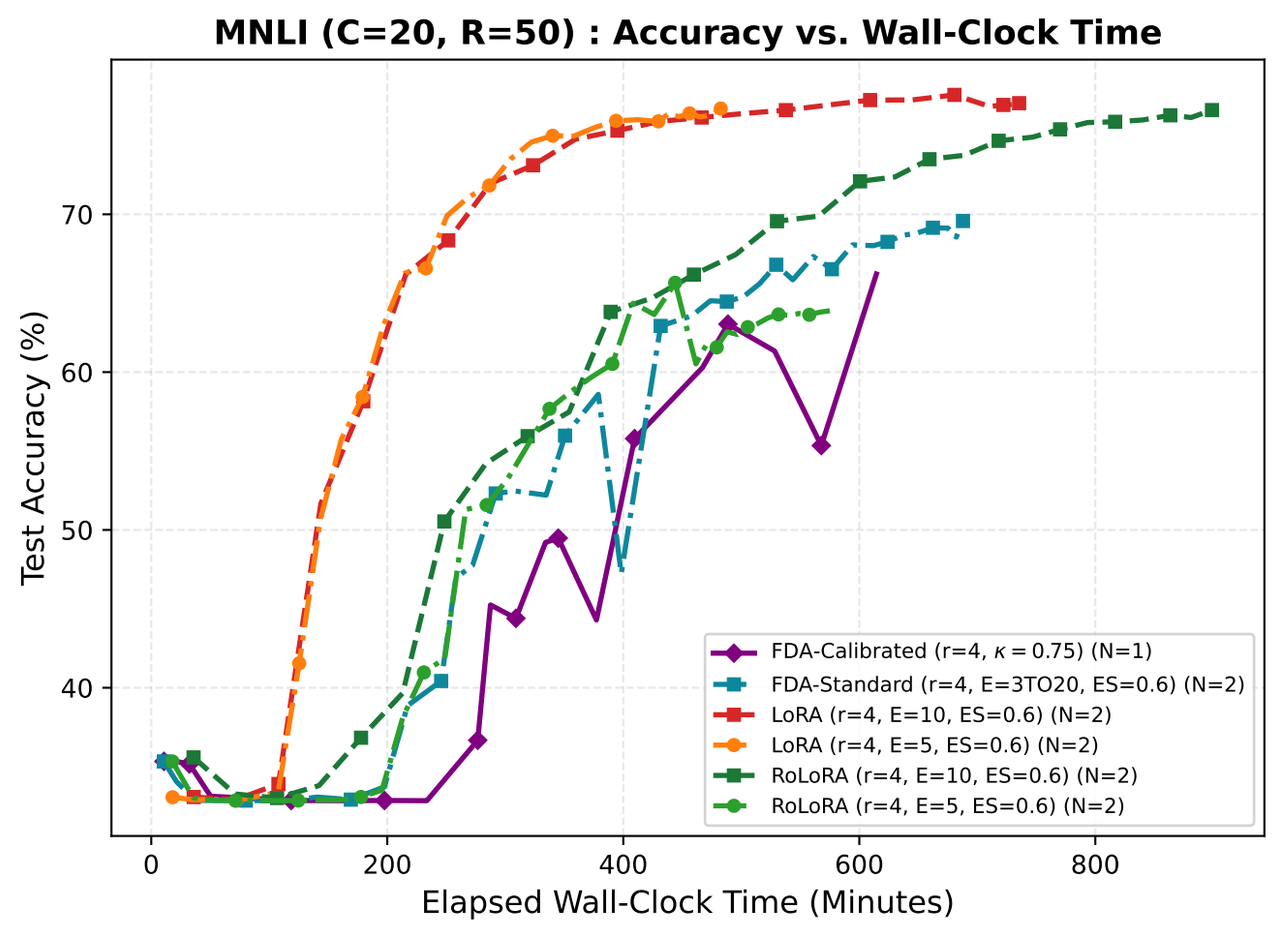
MNLI (C=20, R=50) : Accuracy vs. Wall-Clock Time
Test Accuracy (%)
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
40
50
60
70
0
200
400
600
800
FDA-Calibrated (r=4, κ = 0.75) (N=1)
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.6) (N=2)
LoRA (r=4, E=10, ES=0.6) (N=2)
LoRA (r=4, E=5, ES=0.6) (N=2)
RoLoRA (r=4, E=10, ES=0.6) (N=2)
RoLoRA (r=4, E=5, ES=0.6) (N=2)