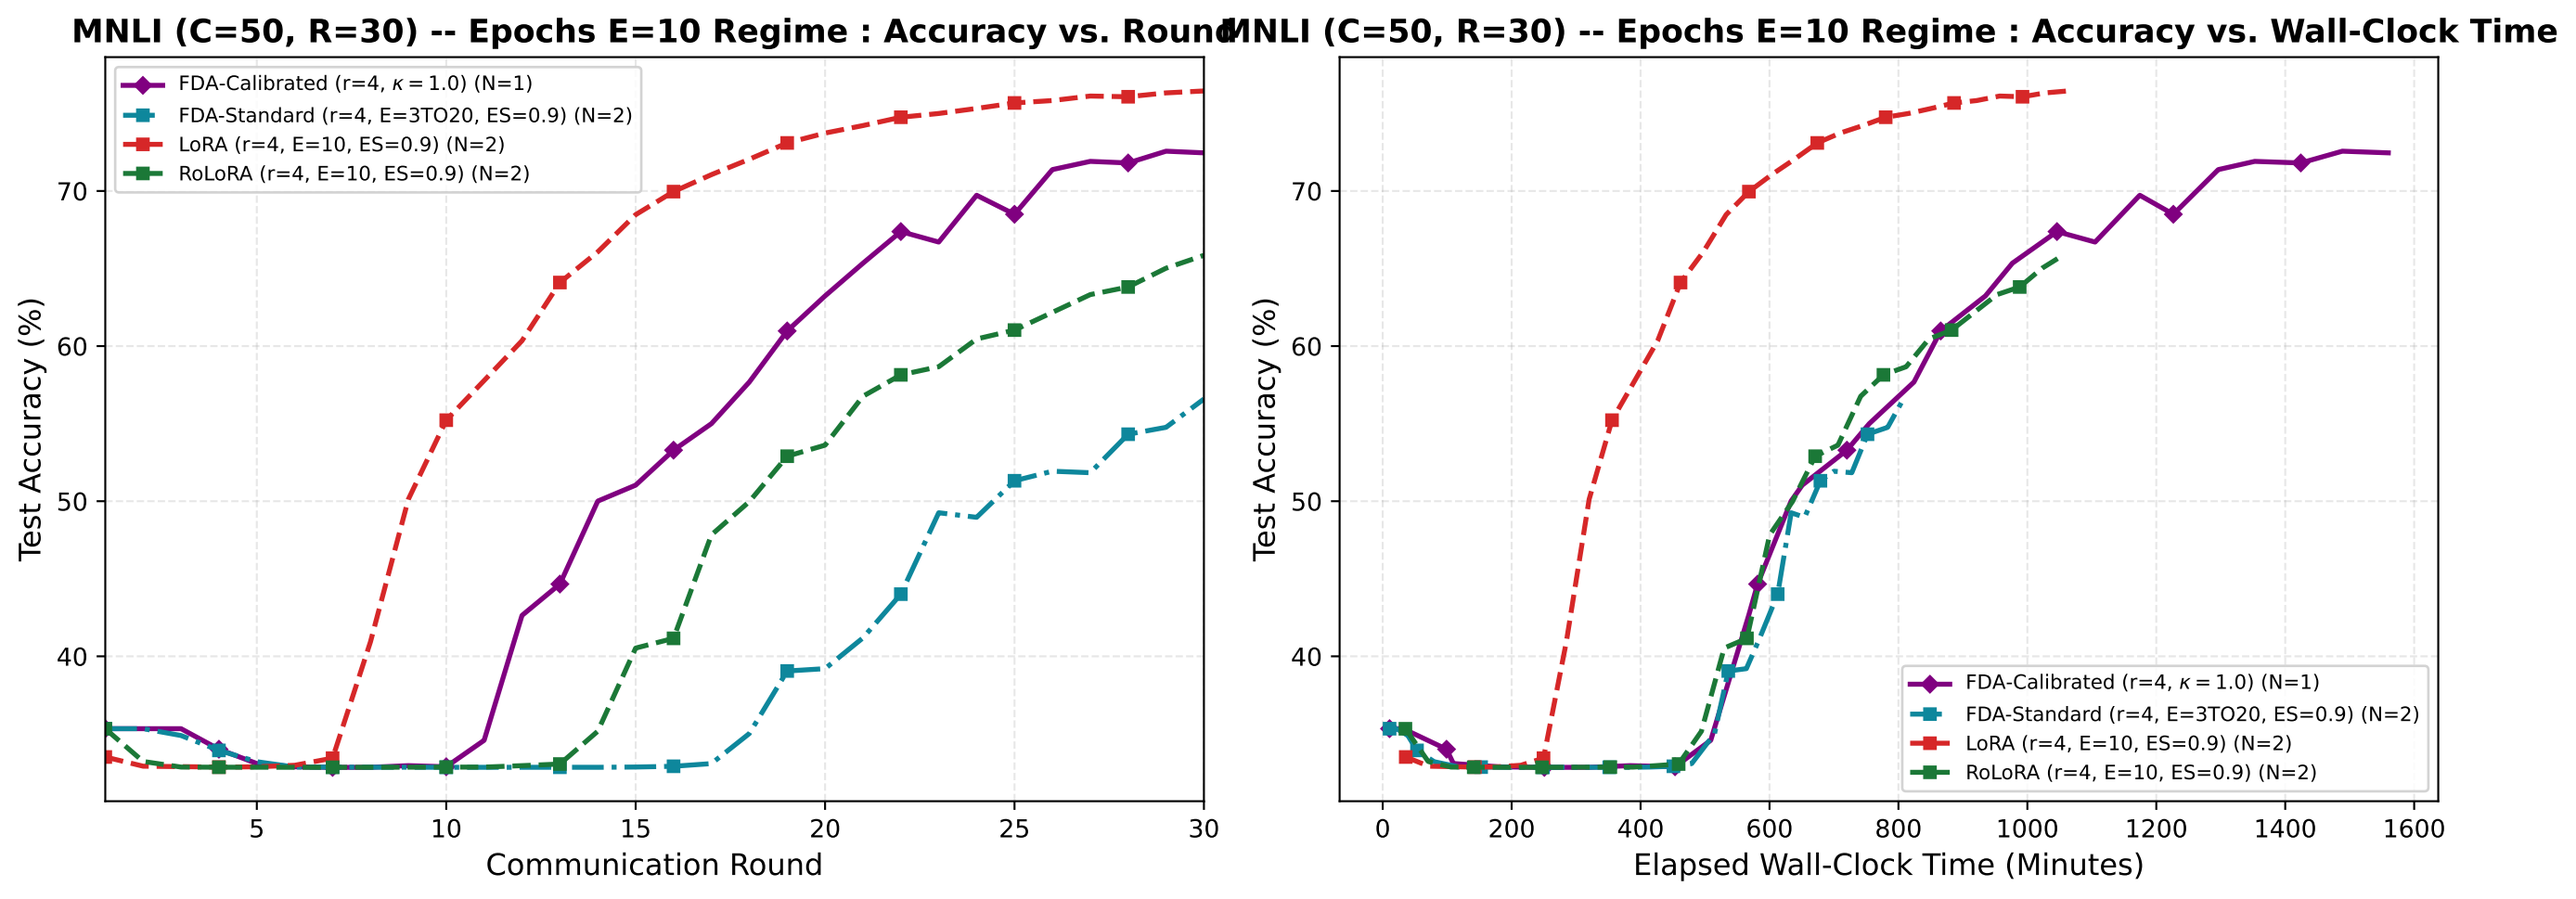
MNLI (C=50, R=30) -- Epochs E=10 Regime : Accuracy vs. Round
MNLI (C=50, R=30) -- Epochs E=10 Regime : Accuracy vs. Wall-Clock Time
FDA-Calibrated (r=4, κ = 1.0) (N=1)
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.9) (N=2)
LoRA (r=4, E=10, ES=0.9) (N=2)
RoLoRA (r=4, E=10, ES=0.9) (N=2)
Test Accuracy (%)
Communication Round
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
40
50
60
70
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600