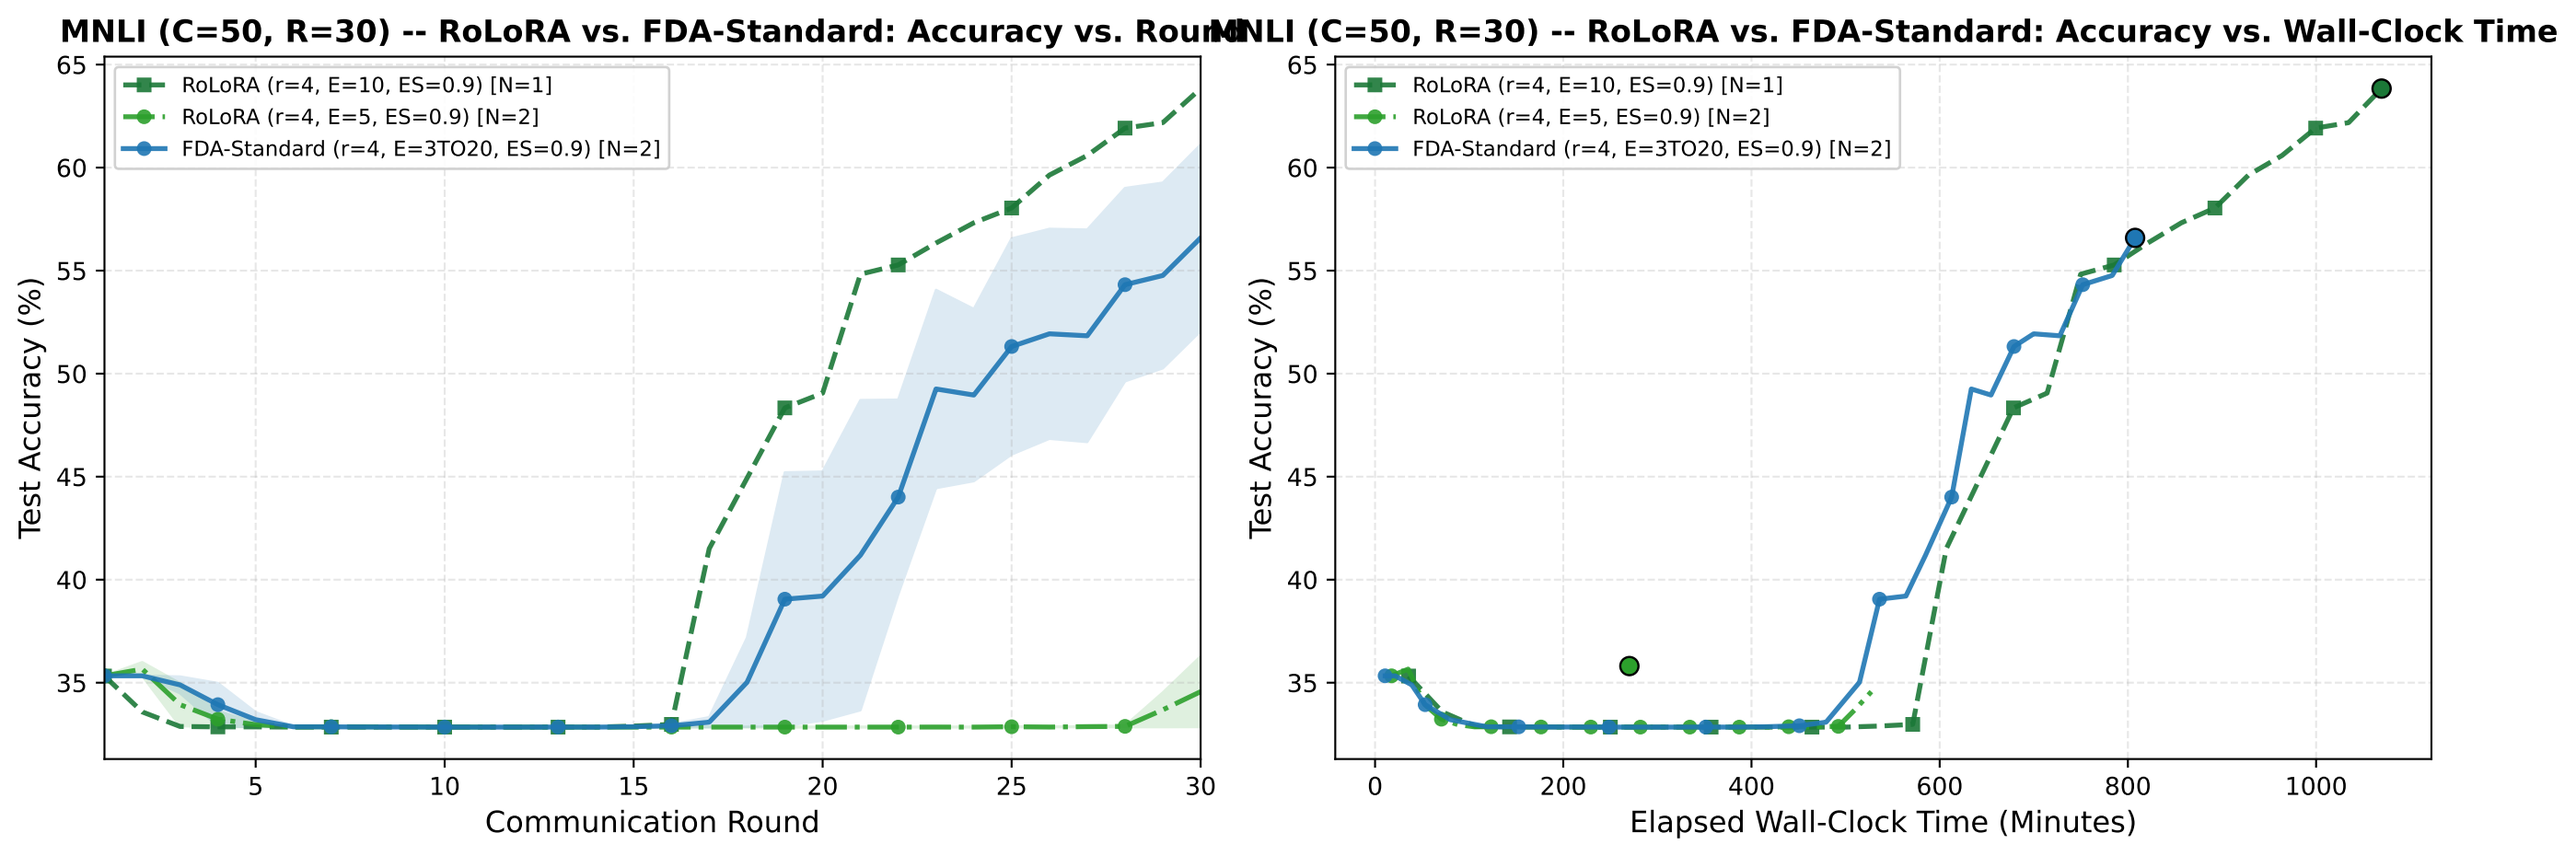
MNLI (C=50, R=30) -- RoLoRA vs. FDA-Standard: Accuracy vs. Round
MNLI (C=50, R=30) -- RoLoRA vs. FDA-Standard: Accuracy vs. Wall-Clock Time
RoLoRA (r=4, E=10, ES=0.9) [N=1]
RoLoRA (r=4, E=5, ES=0.9) [N=2]
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.9) [N=2]
Test Accuracy (%)
Communication Round
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
35
40
45
50
55
60
65
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000