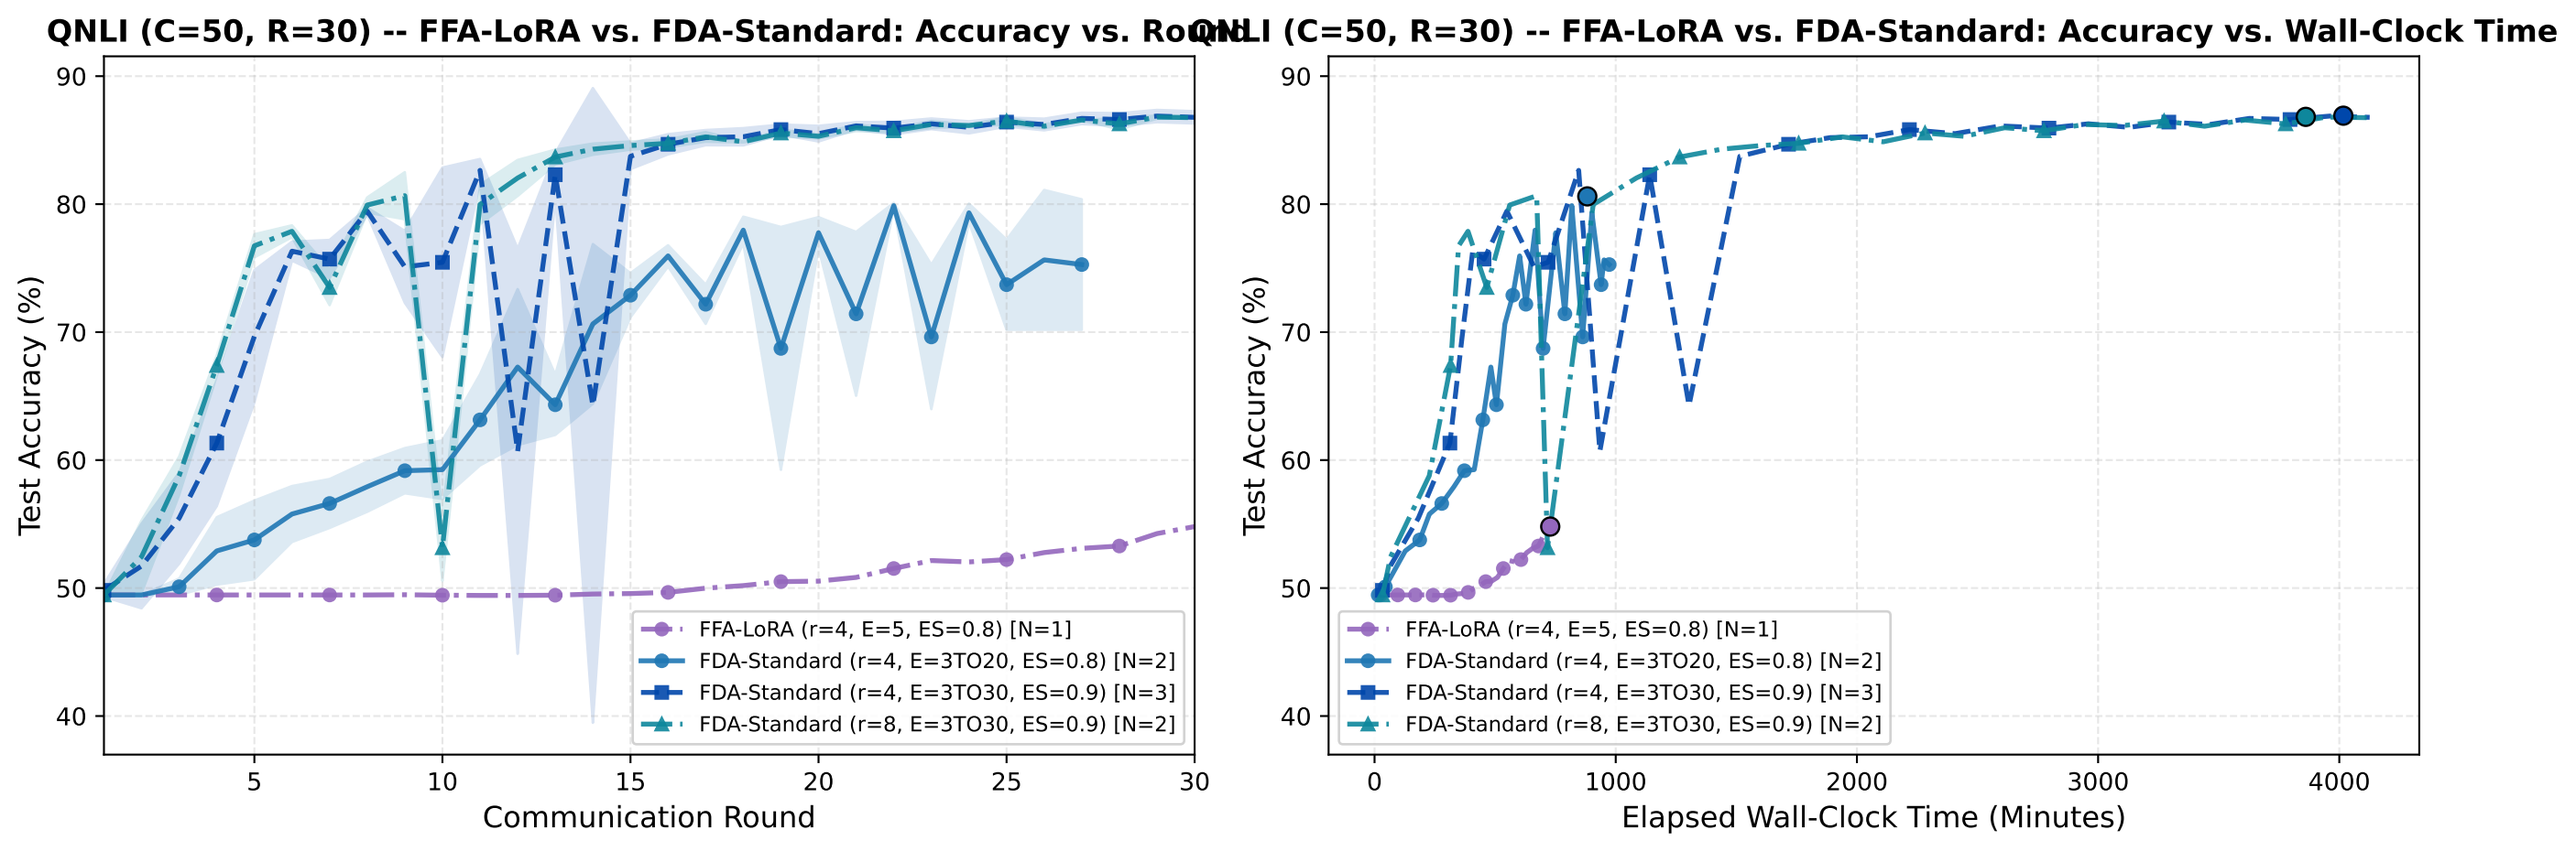
QNLI (C=50, R=30) -- FFA-LoRA vs. FDA-Standard: Accuracy vs. Round
Test Accuracy (%)
Communication Round
FFA-LoRA (r=4, E=5, ES=0.8) [N=1]
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.8) [N=2]
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) [N=3]
FDA-Standard (r=8, E=3TO30, ES=0.9) [N=2]
QNLI (C=50, R=30) -- FFA-LoRA vs. FDA-Standard: Accuracy vs. Wall-Clock Time
Test Accuracy (%)
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
FFA-LoRA (r=4, E=5, ES=0.8) [N=1]
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.8) [N=2]
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) [N=3]
FDA-Standard (r=8, E=3TO30, ES=0.9) [N=2]