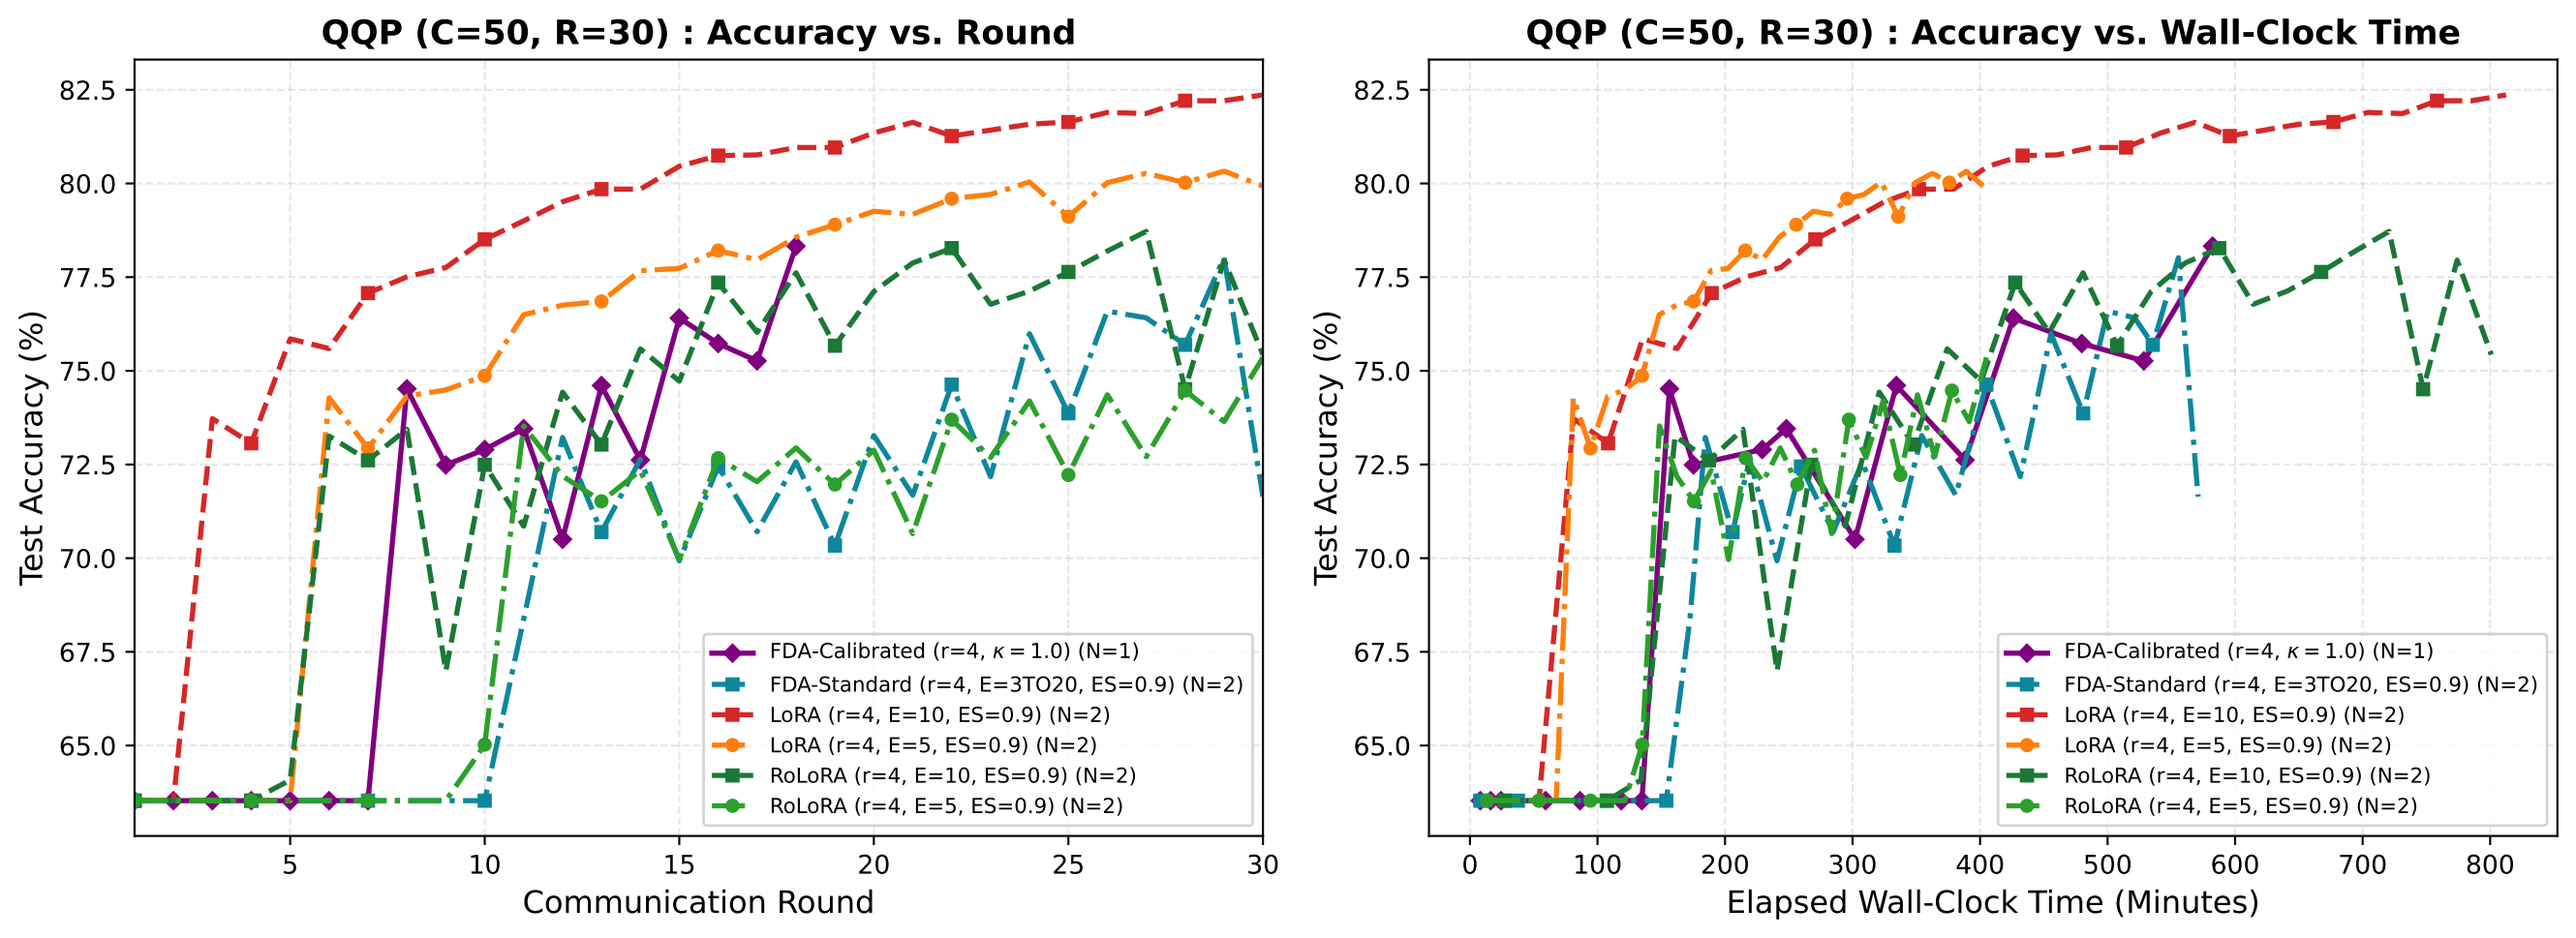
QQP (C=50, R=30) : Accuracy vs. Round
Test Accuracy (%)
Communication Round
82.5
80.0
77.5
75.0
72.5
70.0
67.5
65.0
5
10
15
20
25
30
FDA-Calibrated (r=4, κ = 1.0) (N=1)
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.9) (N=2)
LoRA (r=4, E=10, ES=0.9) (N=2)
LoRA (r=4, E=5, ES=0.9) (N=2)
RoLoRA (r=4, E=10, ES=0.9) (N=2)
RoLoRA (r=4, E=5, ES=0.9) (N=2)
QQP (C=50, R=30) : Accuracy vs. Wall-Clock Time
Test Accuracy (%)
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
FDA-Calibrated (r=4, κ = 1.0) (N=1)
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.9) (N=2)
LoRA (r=4, E=10, ES=0.9) (N=2)
LoRA (r=4, E=5, ES=0.9) (N=2)
RoLoRA (r=4, E=10, ES=0.9) (N=2)
RoLoRA (r=4, E=5, ES=0.9) (N=2)