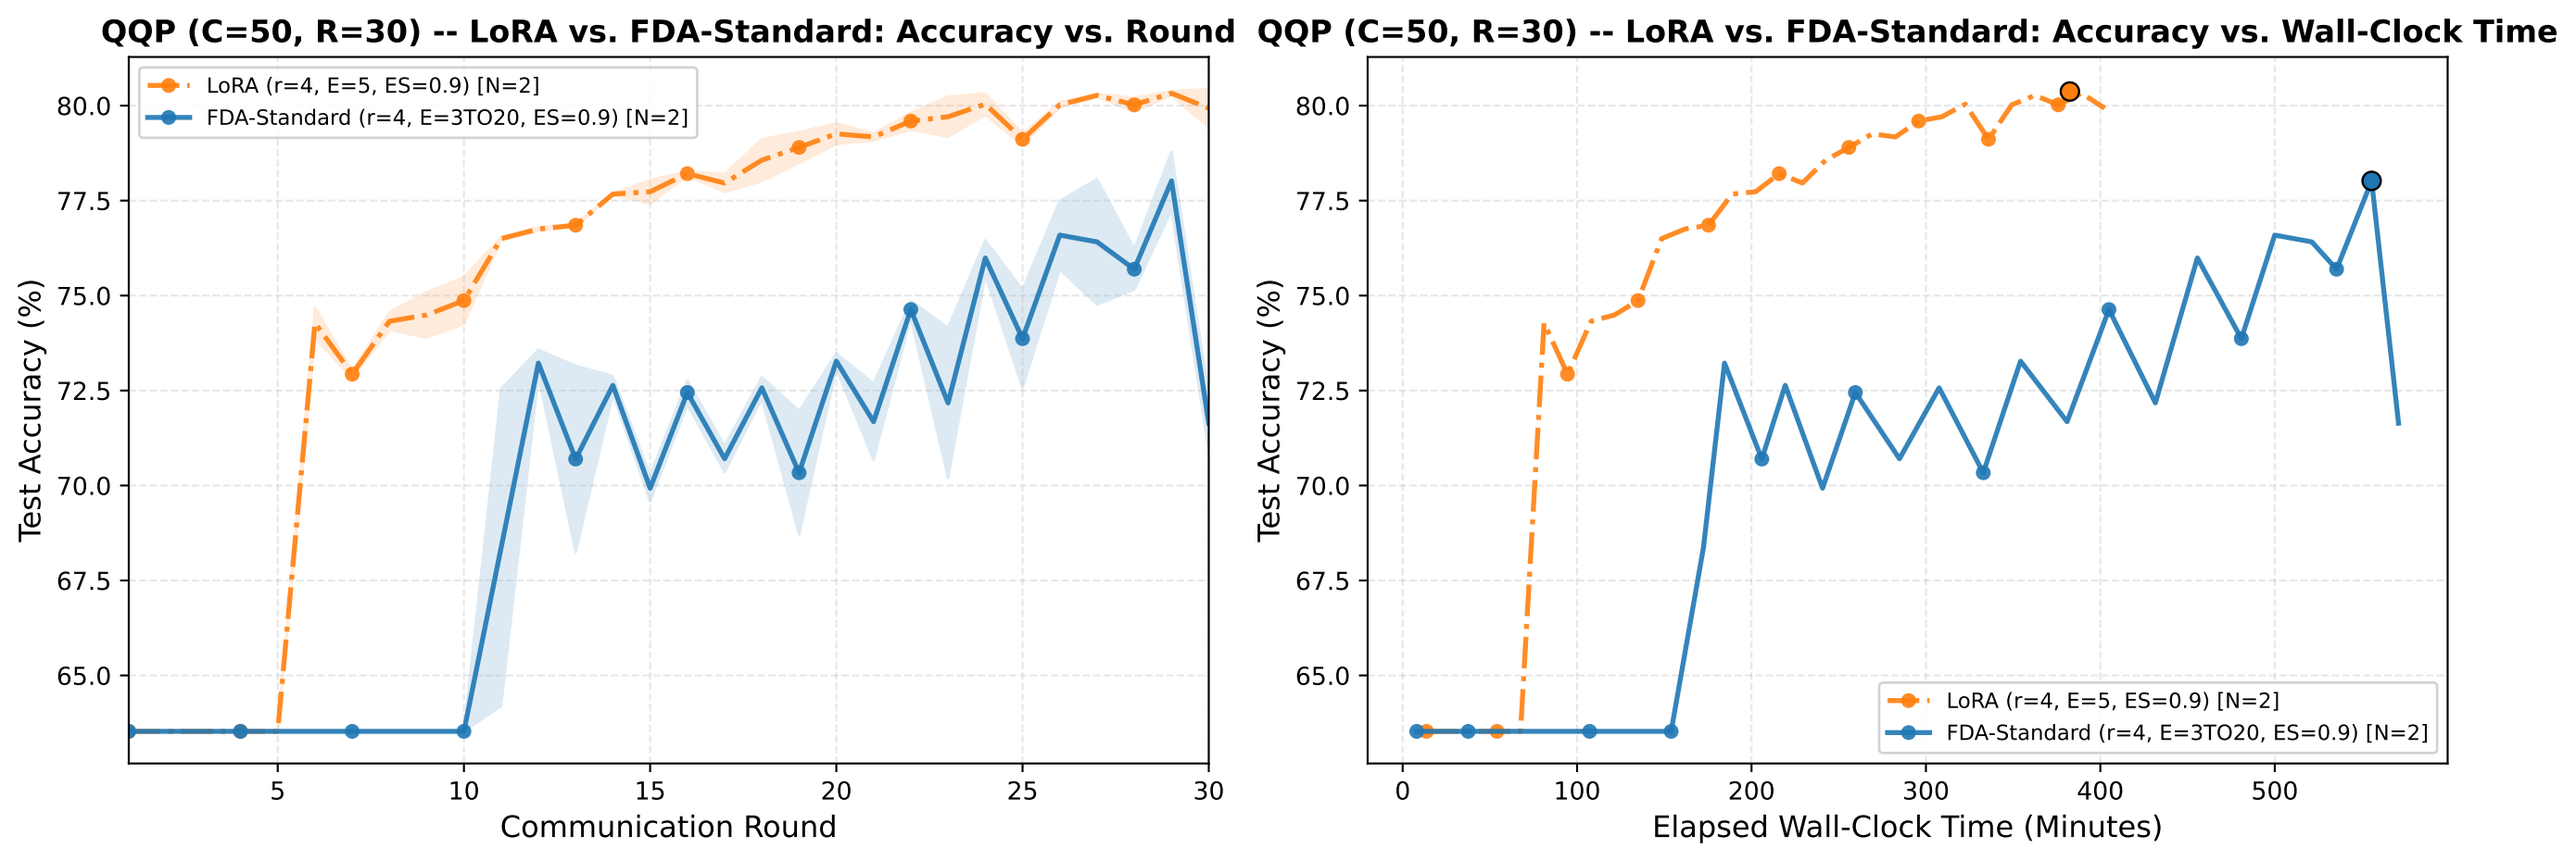
QQP (C=50, R=30) -- LoRA vs. FDA-Standard: Accuracy vs. Round
QQP (C=50, R=30) -- LoRA vs. FDA-Standard: Accuracy vs. Wall-Clock Time
LoRA (r=4, E=5, ES=0.9) [N=2]
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.9) [N=2]
Test Accuracy (%)
Communication Round
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
80.0
77.5
75.0
72.5
70.0
67.5
65.0
5
10
15
20
25
30
0
100
200
300
400
500