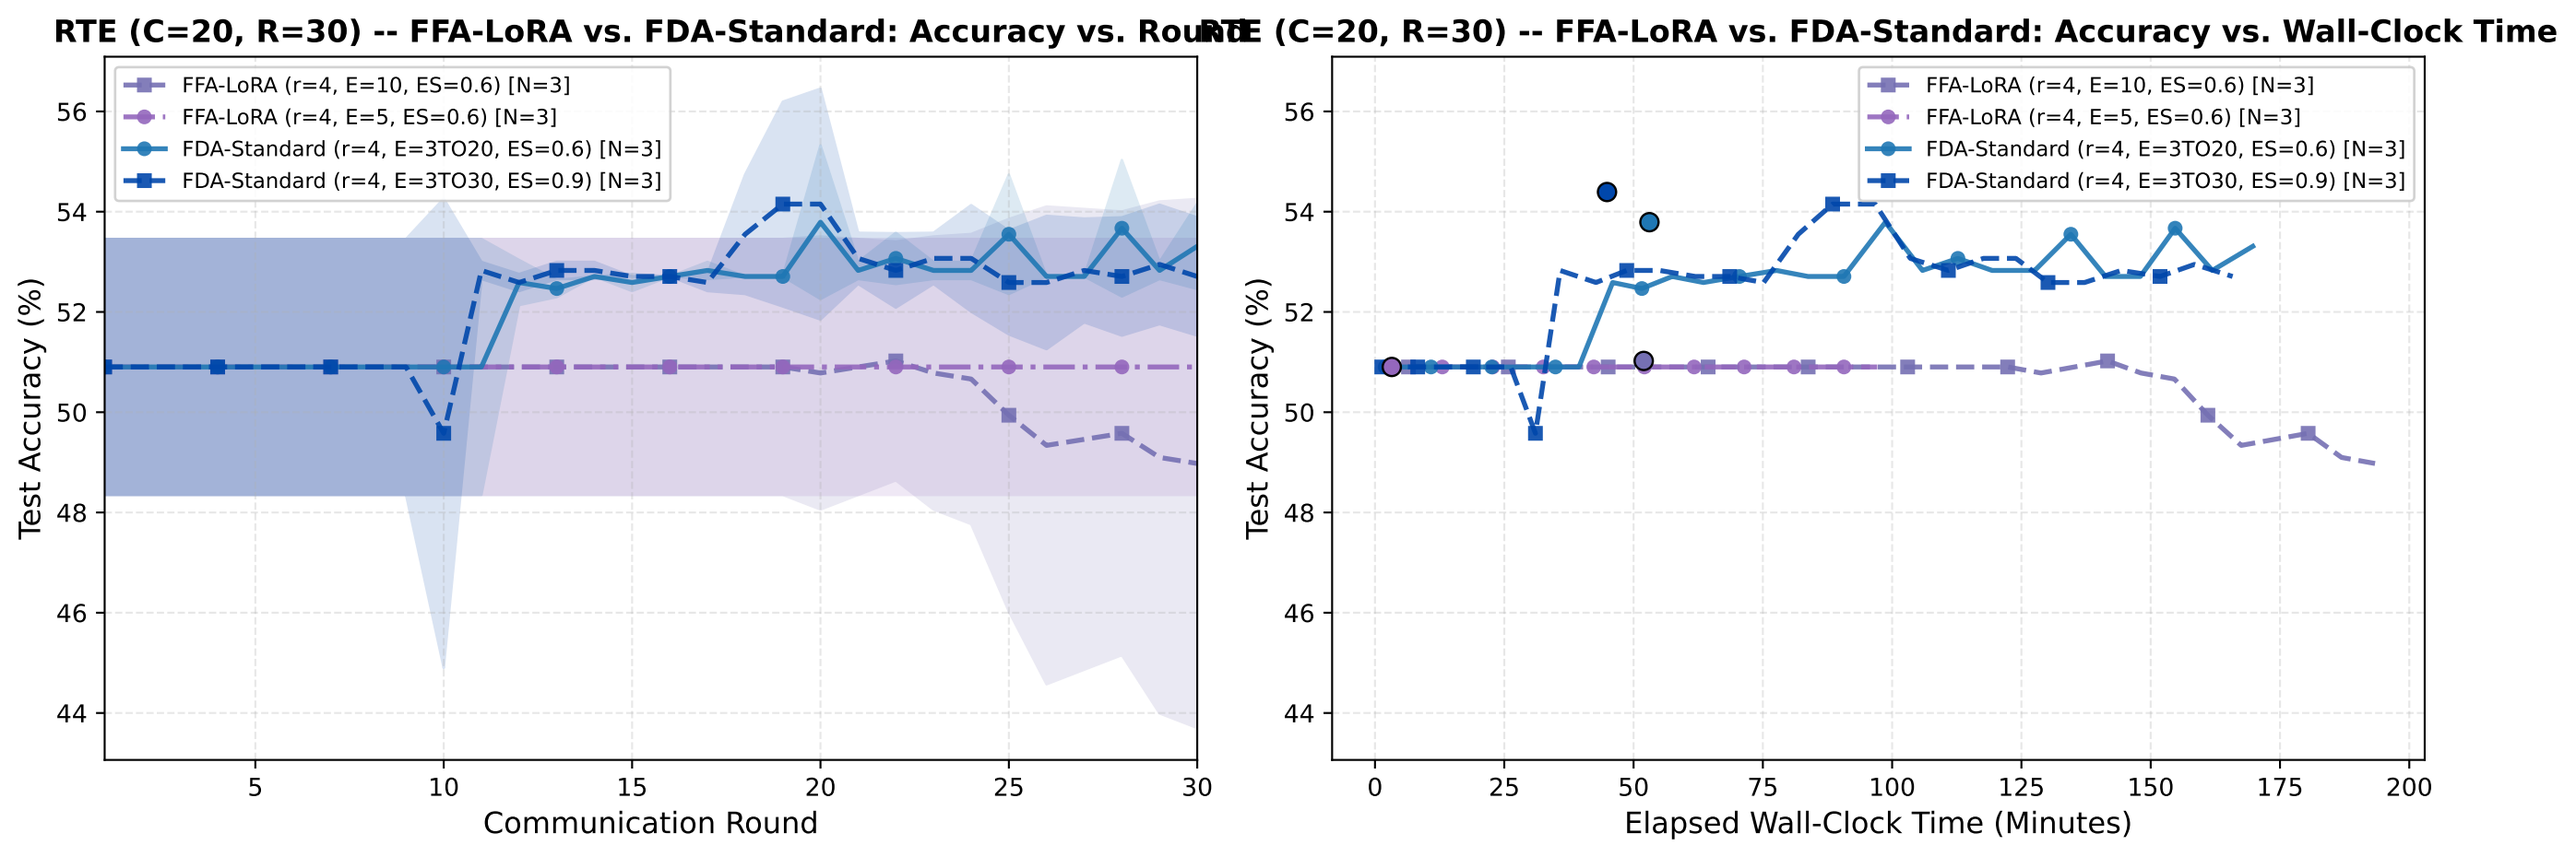
RTE (C=20, R=30) -- FFA-LoRA vs. FDA-Standard: Accuracy vs. Round
RTE (C=20, R=30) -- FFA-LoRA vs. FDA-Standard: Accuracy vs. Wall-Clock Time
FFA-LoRA (r=4, E=10, ES=0.6) [N=3]
FFA-LoRA (r=4, E=5, ES=0.6) [N=3]
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.6) [N=3]
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) [N=3]
Test Accuracy (%)
Communication Round
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
44
46
48
50
52
54
56
5
10
15
20
25
30
0
25
50
75
100
125
150
175
200