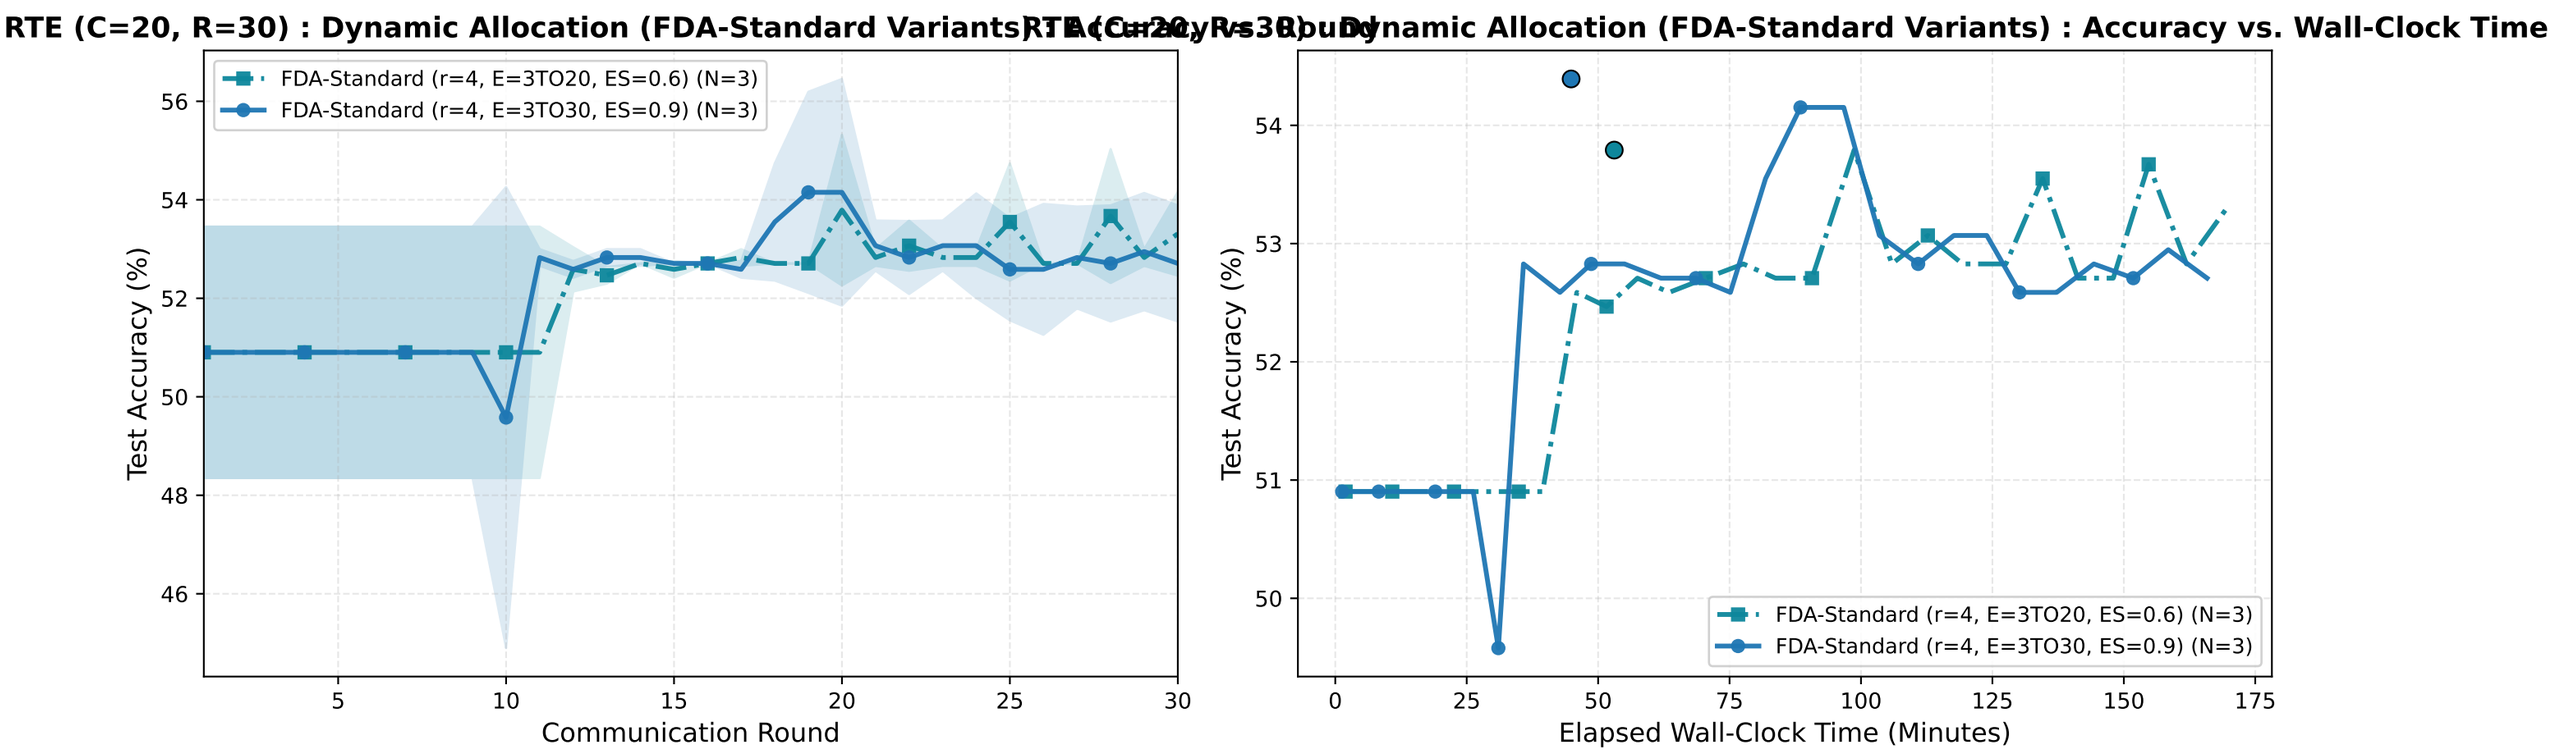
RTE (C=20, R=30) : Dynamic Allocation (FDA-Standard Variants)
RTE (C=20, R=30) : Dynamic Allocation (FDA-Standard Variants) : Accuracy vs. Wall-Clock Time
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.6) (N=3)
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) (N=3)
Test Accuracy (%)
Communication Round
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)