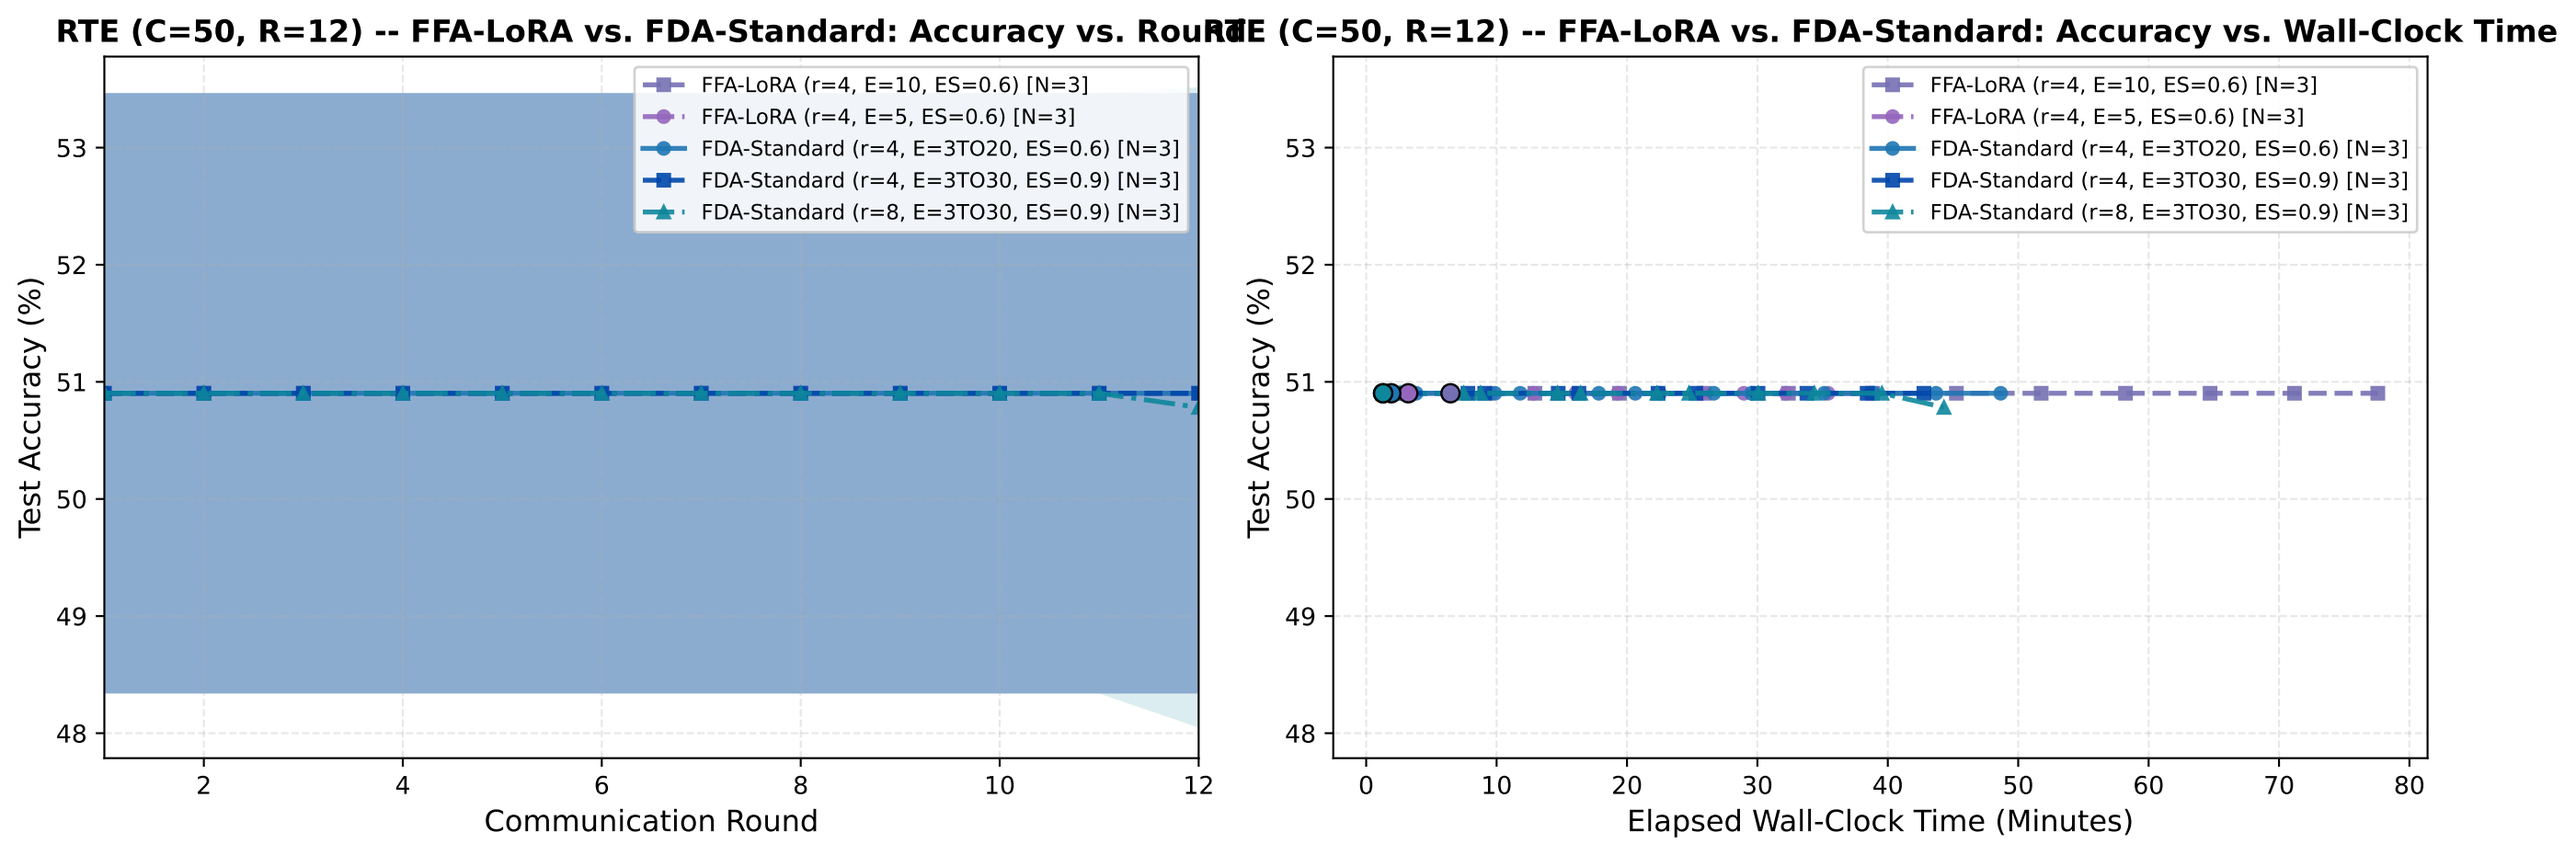
RTE (C=50, R=12) -- FFA-LoRA vs. FDA-Standard: Accuracy vs. Round
RTE (C=50, R=12) -- FFA-LoRA vs. FDA-Standard: Accuracy vs. Wall-Clock Time
FFA-LoRA (r=4, E=10, ES=0.6) [N=3]
FFA-LoRA (r=4, E=5, ES=0.6) [N=3]
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.6) [N=3]
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) [N=3]
FDA-Standard (r=8, E=3TO30, ES=0.9) [N=3]
Test Accuracy (%)
Communication Round
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
48
49
50
51
52
53
2
4
6
8
10
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80