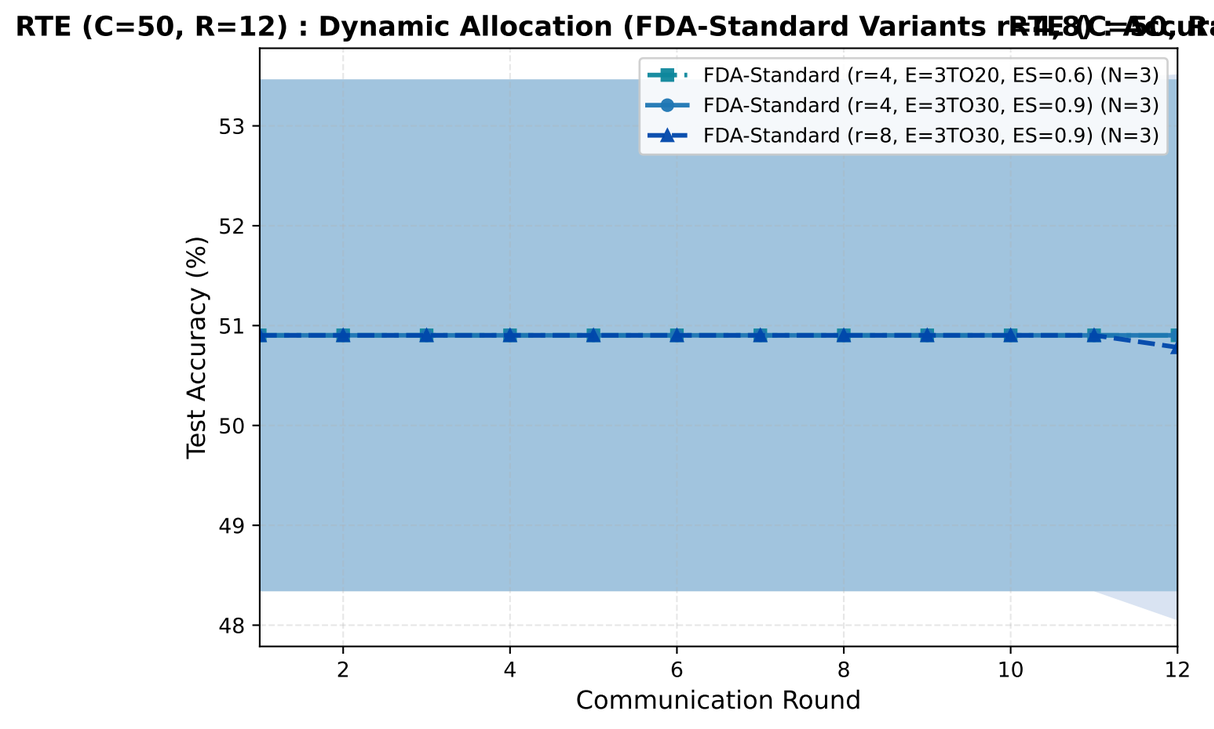
RTE (C=50, R=12) : Dynamic Allocation (FDA-Standard Variants r=4,8) : Accuracy vs. Communication Round
Test Accuracy (%)
Communication Round
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.6) (N=3)
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) (N=3)
FDA-Standard (r=8, E=3TO30, ES=0.9) (N=3)

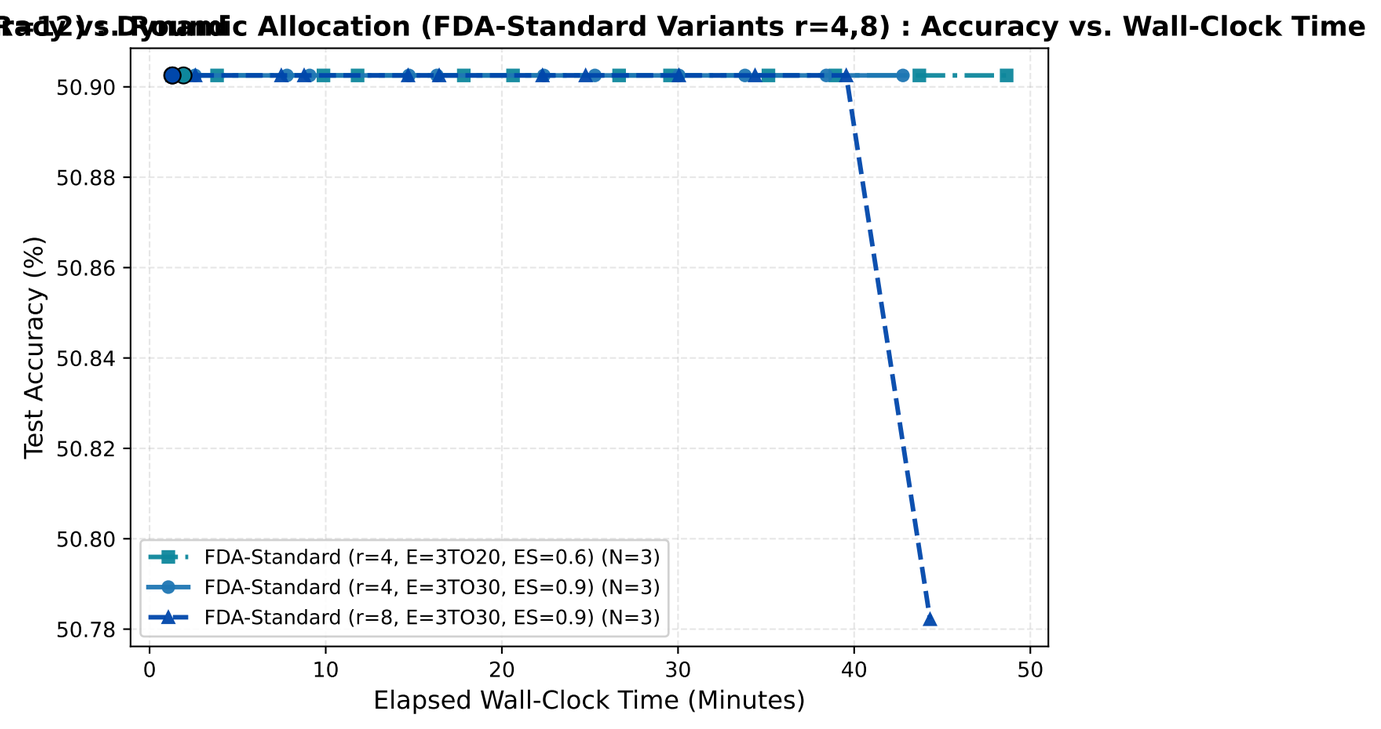
RTE (C=50, R=12) : Dynamic Allocation (FDA-Standard Variants r=4,8) : Accuracy vs. Wall-Clock Time
Test Accuracy (%)
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.6) (N=3)
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) (N=3)
FDA-Standard (r=8, E=3TO30, ES=0.9) (N=3)