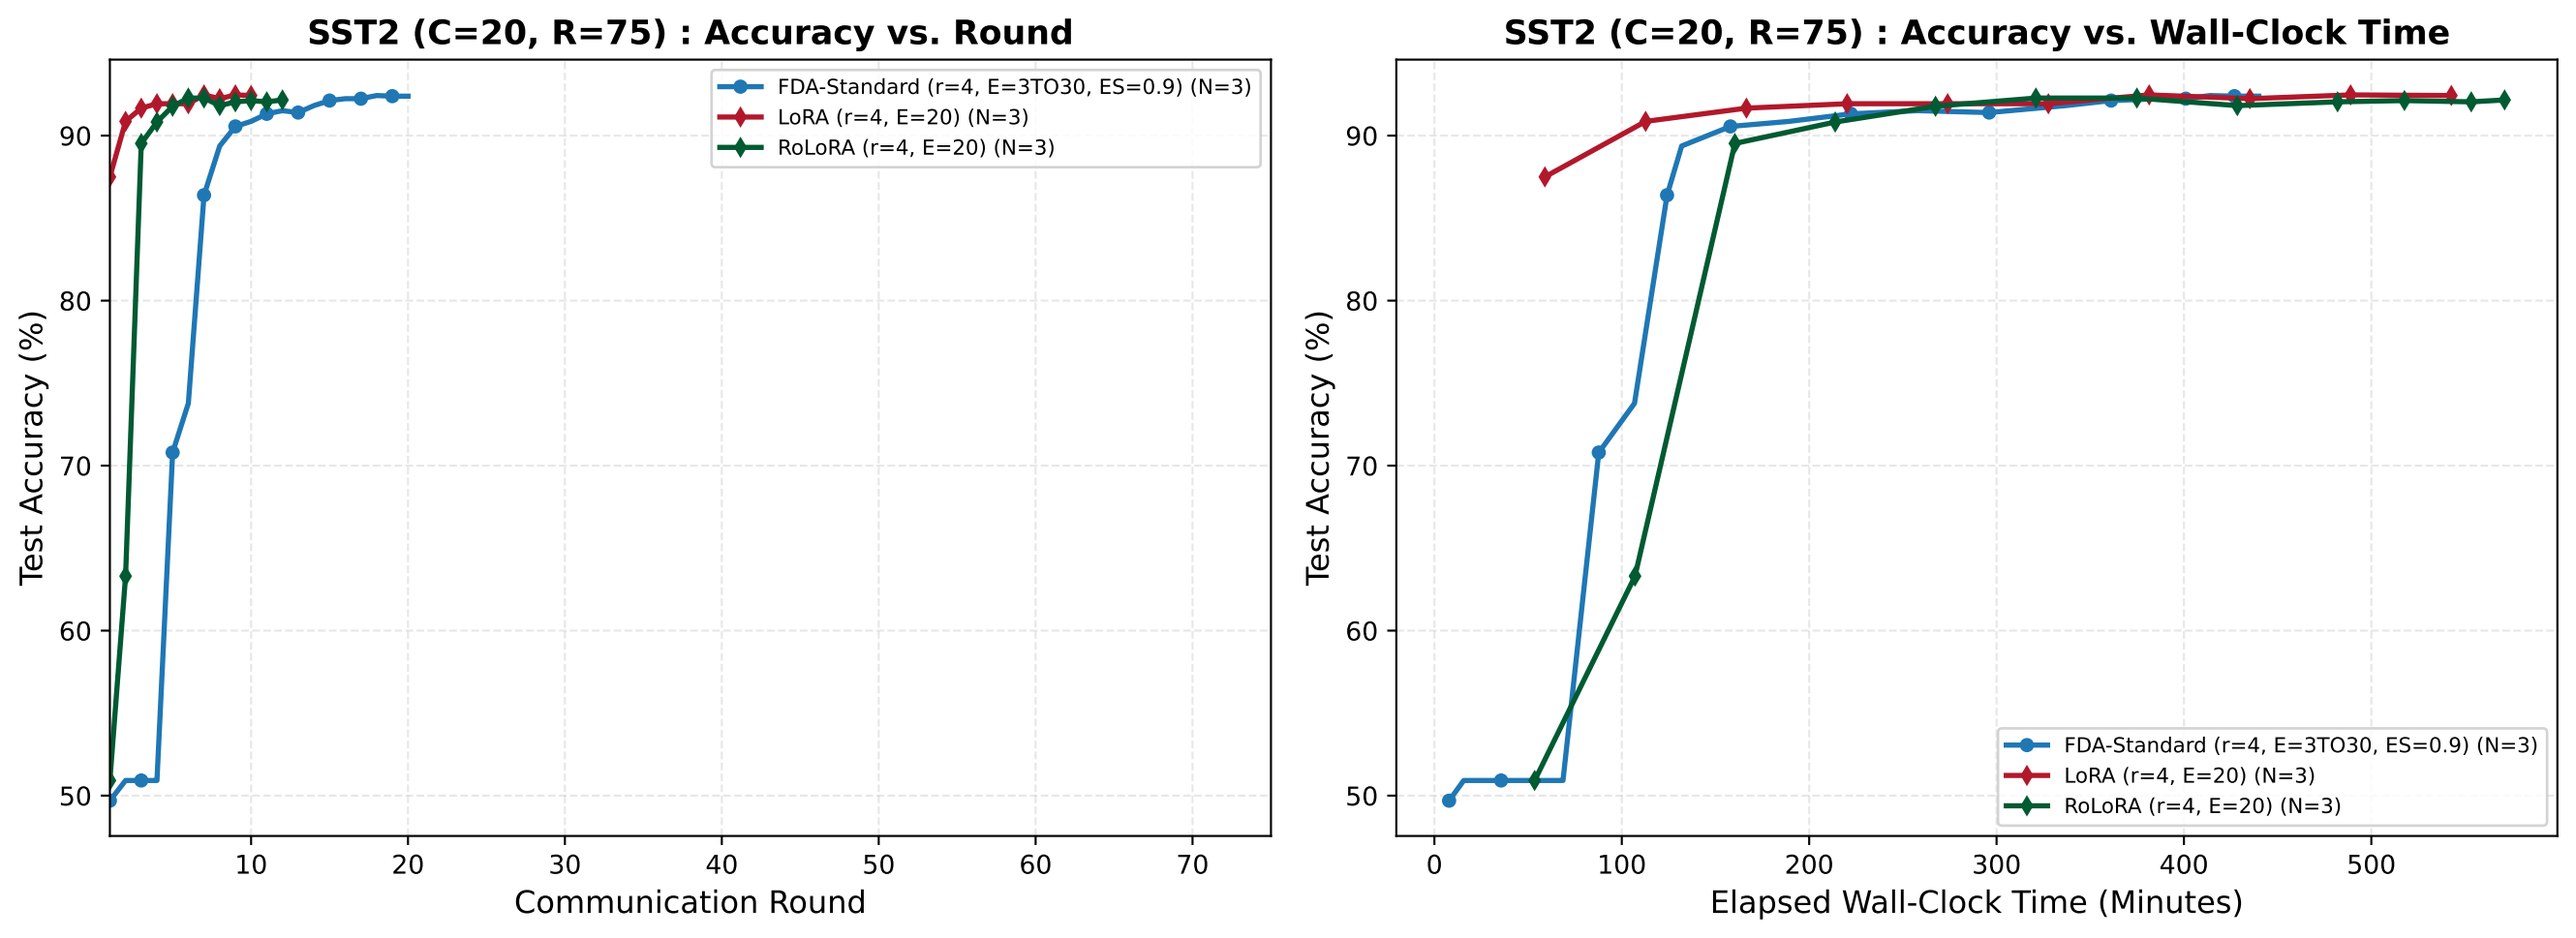
SST2 (C=20, R=75) : Accuracy vs. Round
Test Accuracy (%)
Communication Round
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) (N=3)
LoRA (r=4, E=20) (N=3)
RoLoRA (r=4, E=20) (N=3)
SST2 (C=20, R=75) : Accuracy vs. Wall-Clock Time
Test Accuracy (%)
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) (N=3)
LoRA (r=4, E=20) (N=3)
RoLoRA (r=4, E=20) (N=3)