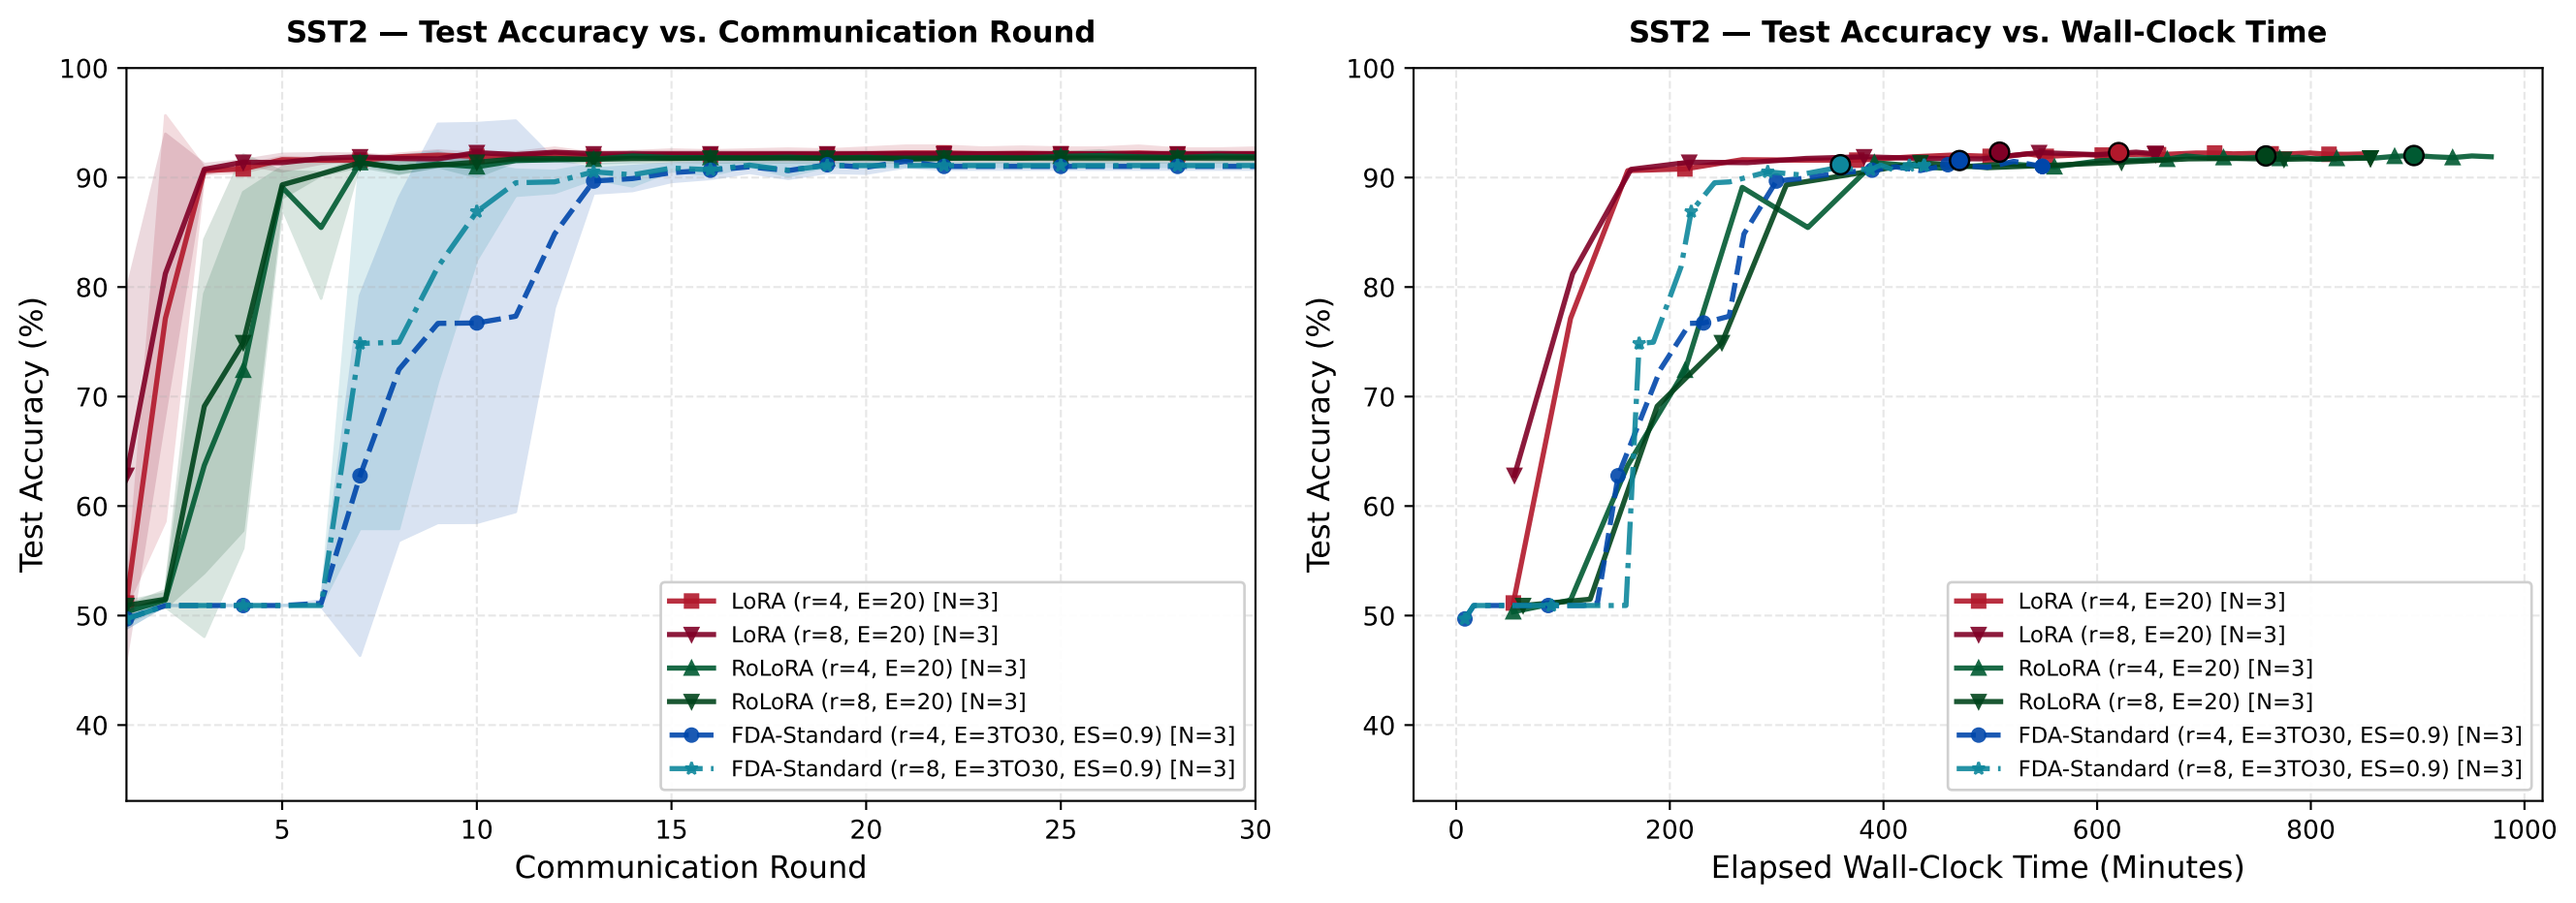
SST2 — Test Accuracy vs. Communication Round
Test Accuracy (%)
Communication Round
SST2 — Test Accuracy vs. Wall-Clock Time
Test Accuracy (%)
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
LoRA (r=4, E=20) [N=3]
LoRA (r=8, E=20) [N=3]
RoLoRA (r=4, E=20) [N=3]
RoLoRA (r=8, E=20) [N=3]
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) [N=3]
FDA-Standard (r=8, E=3TO30, ES=0.9) [N=3]