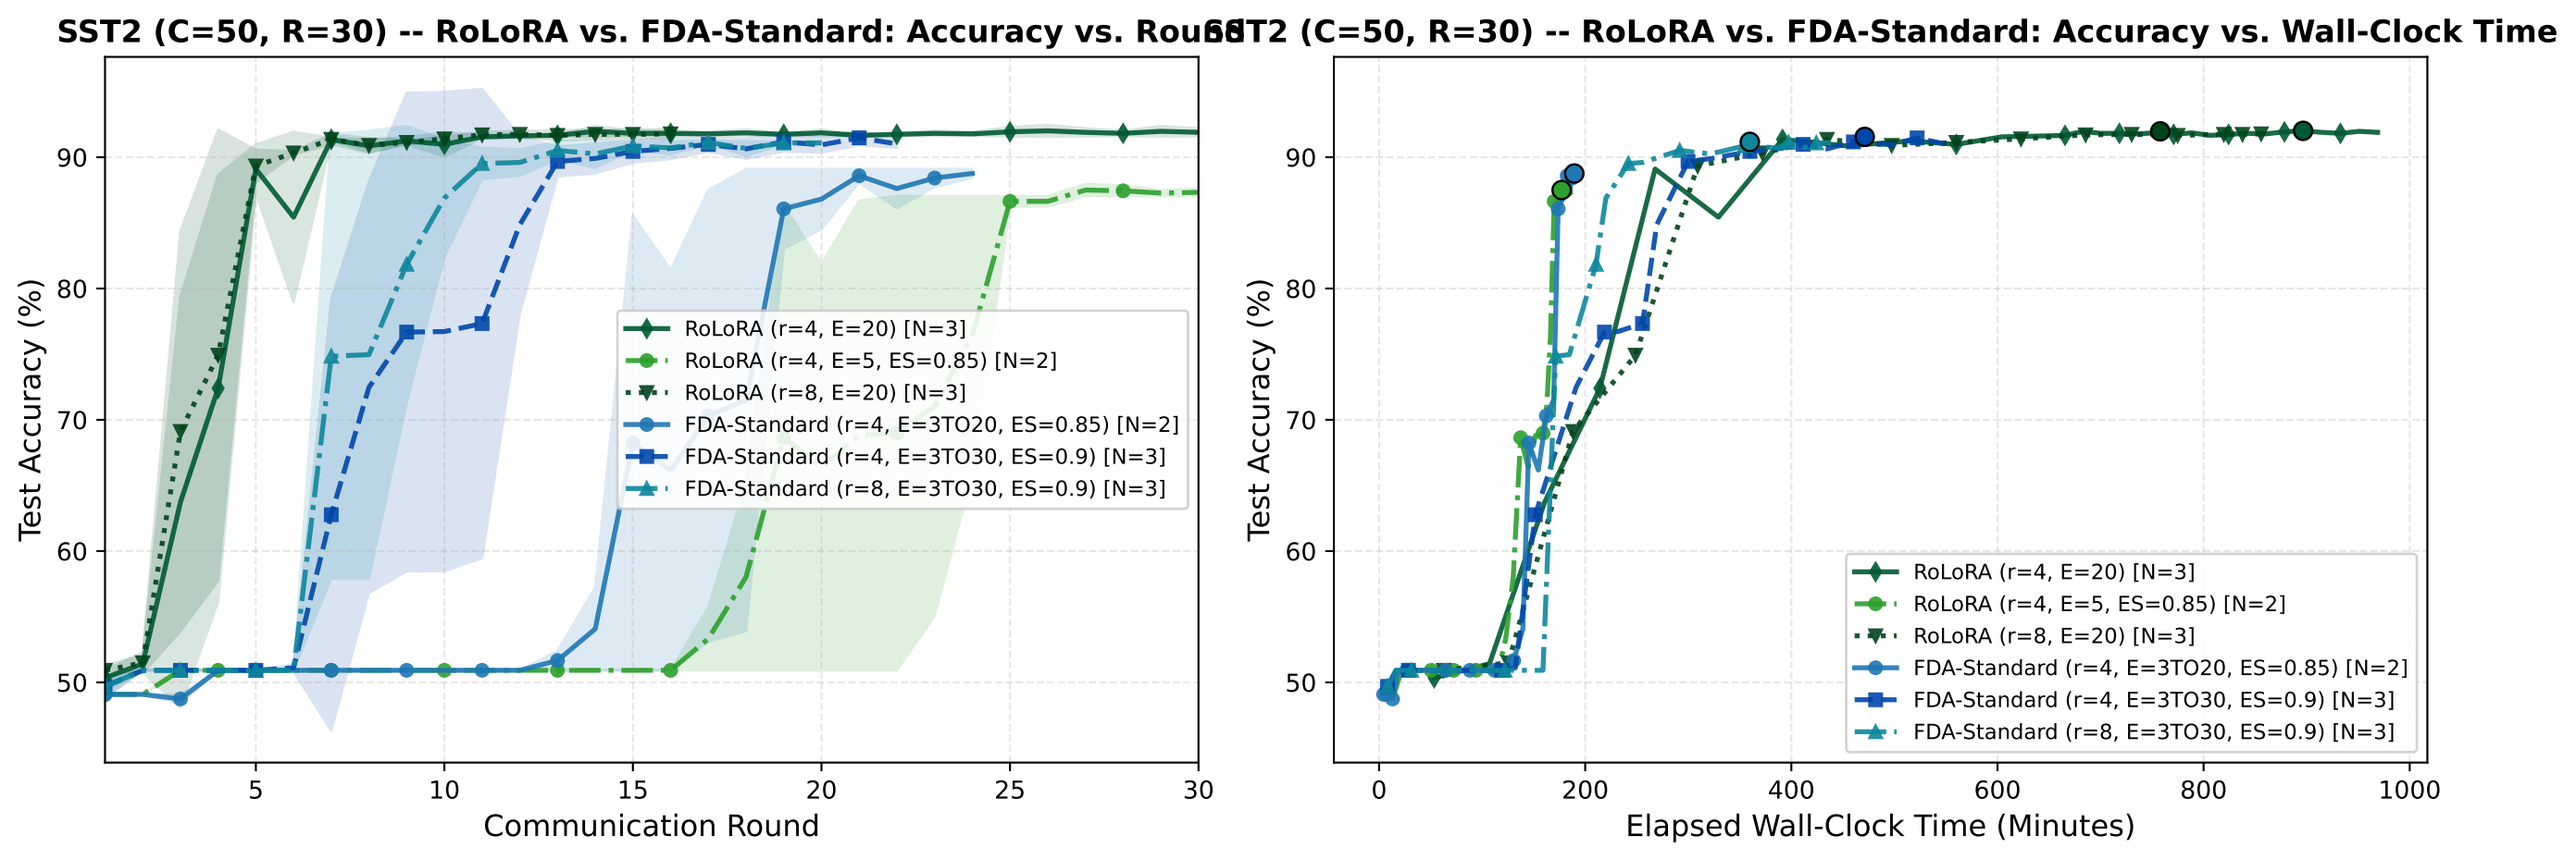
SST2 (C=50, R=30) -- RoLoRA vs. FDA-Standard: Accuracy vs. Rou
Test Accuracy (%)
Communication Round
RoLoRA (r=4, E=20) [N=3]
RoLoRA (r=4, E=5, ES=0.85) [N=2]
RoLoRA (r=8, E=20) [N=3]
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.85) [N=2]
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) [N=3]
FDA-Standard (r=8, E=3TO30, ES=0.9) [N=3]
SST2 (C=50, R=30) -- RoLoRA vs. FDA-Standard: Accuracy vs. Wall-Clock Time
Test Accuracy (%)
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
RoLoRA (r=4, E=20) [N=3]
RoLoRA (r=4, E=5, ES=0.85) [N=2]
RoLoRA (r=8, E=20) [N=3]
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.85) [N=2]
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) [N=3]
FDA-Standard (r=8, E=3TO30, ES=0.9) [N=3]