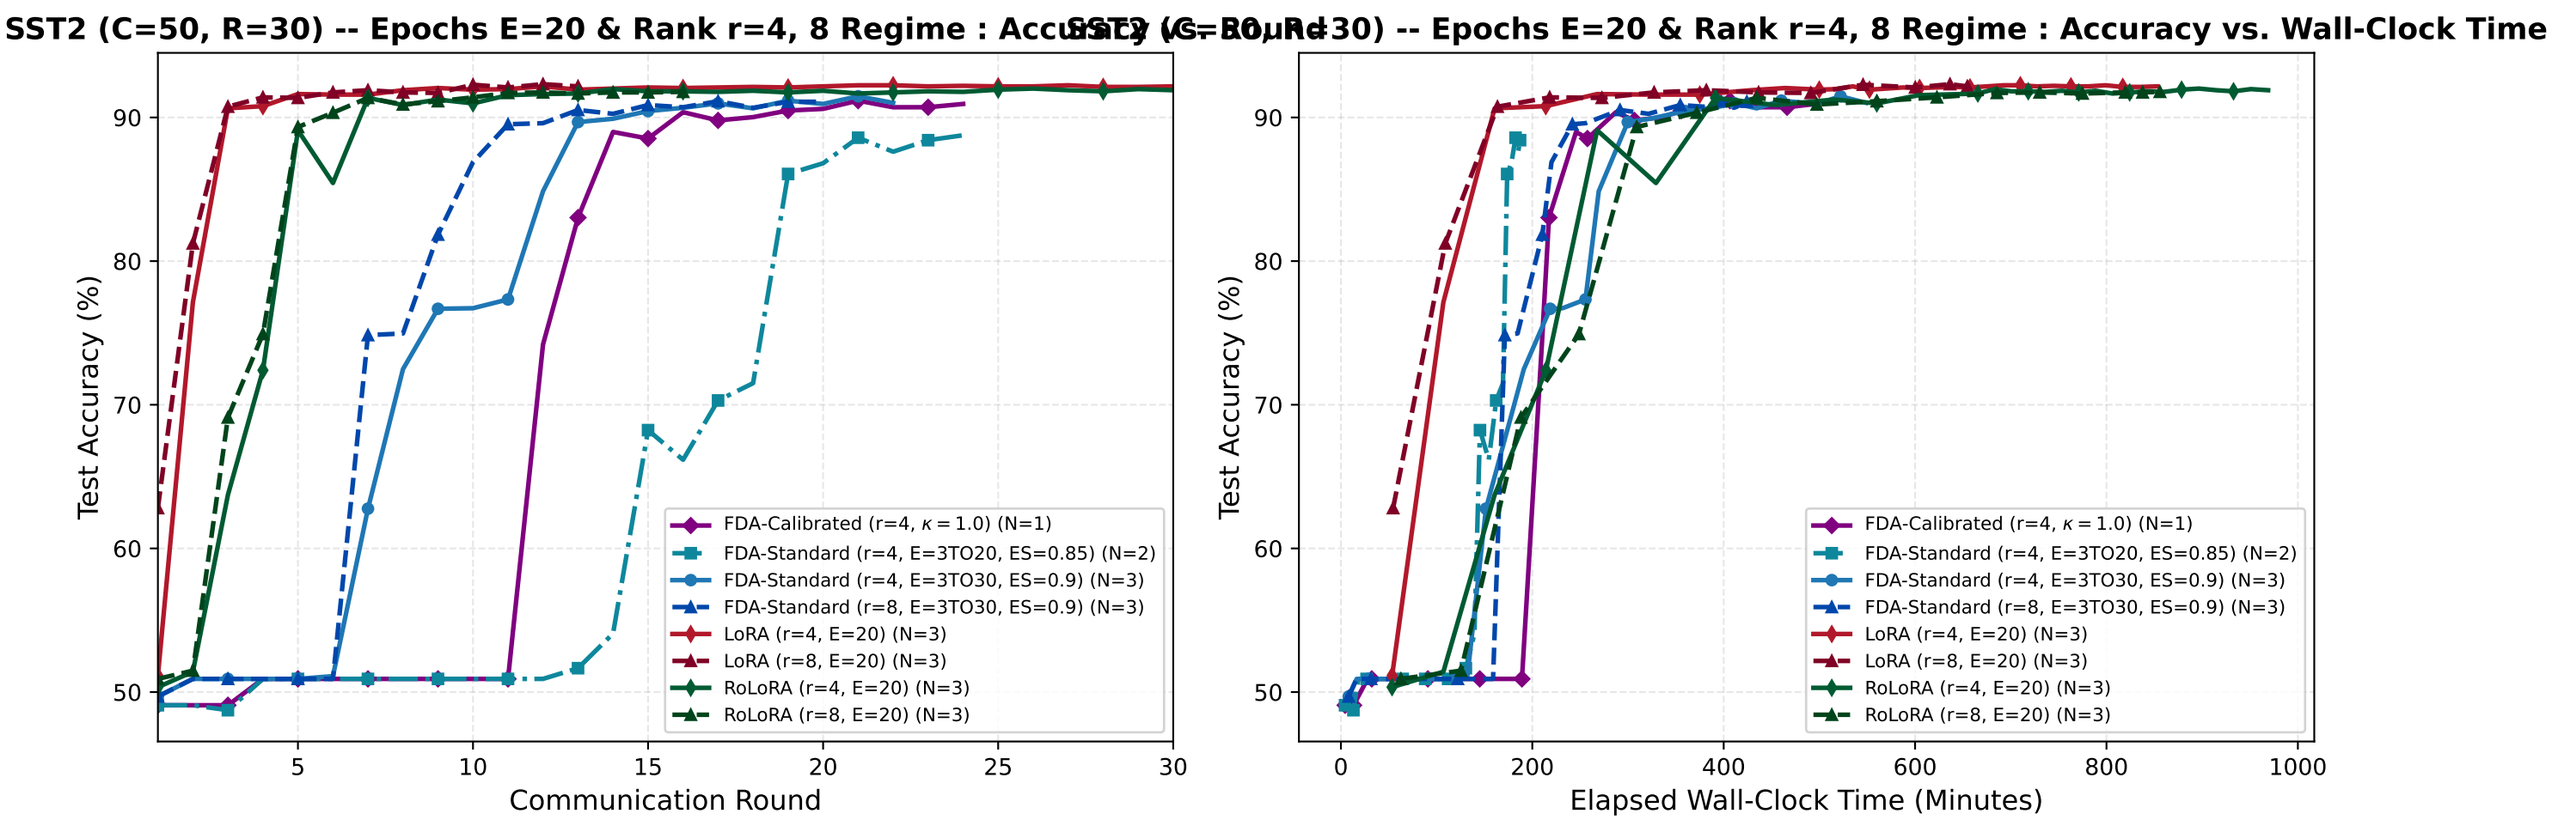
SST2 (C=50, R=30) -- Epochs E=20 & Rank r=4, 8 Regime : Accuracy vs. Communication Round
Test Accuracy (%)
Communication Round
FDA-Calibrated (r=4, κ = 1.0) (N=1)
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.85) (N=2)
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) (N=3)
FDA-Standard (r=8, E=3TO30, ES=0.9) (N=3)
LoRA (r=4, E=20) (N=3)
LoRA (r=8, E=20) (N=3)
RoLoRA (r=4, E=20) (N=3)
RoLoRA (r=8, E=20) (N=3)
SST2 (C=50, R=30) -- Epochs E=20 & Rank r=4, 8 Regime : Accuracy vs. Wall-Clock Time
Test Accuracy (%)
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
FDA-Calibrated (r=4, κ = 1.0) (N=1)
FDA-Standard (r=4, E=3TO20, ES=0.85) (N=2)
FDA-Standard (r=4, E=3TO30, ES=0.9) (N=3)
FDA-Standard (r=8, E=3TO30, ES=0.9) (N=3)
LoRA (r=4, E=20) (N=3)
LoRA (r=8, E=20) (N=3)
RoLoRA (r=4, E=20) (N=3)
RoLoRA (r=8, E=20) (N=3)