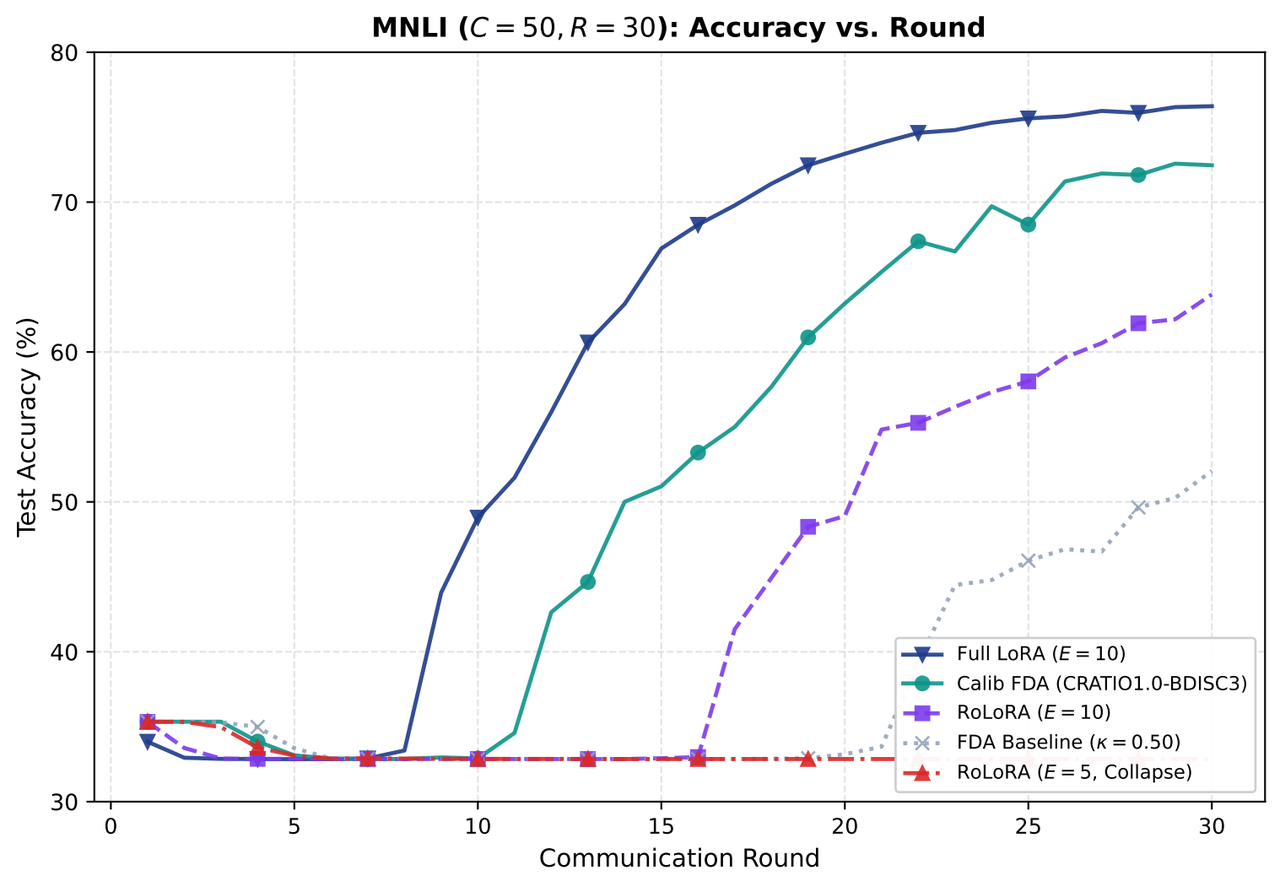
MNLI ($C = 50, R = 30$): Accuracy vs. Round
Test Accuracy (%)
Communication Round
Full LoRA ($E = 10$)
Calib FDA (CRATIO1.0-BDISC3)
RoLoRA ($E = 10$)
FDA Baseline ($\kappa = 0.50$)
RoLoRA ($E = 5$, Collapse)

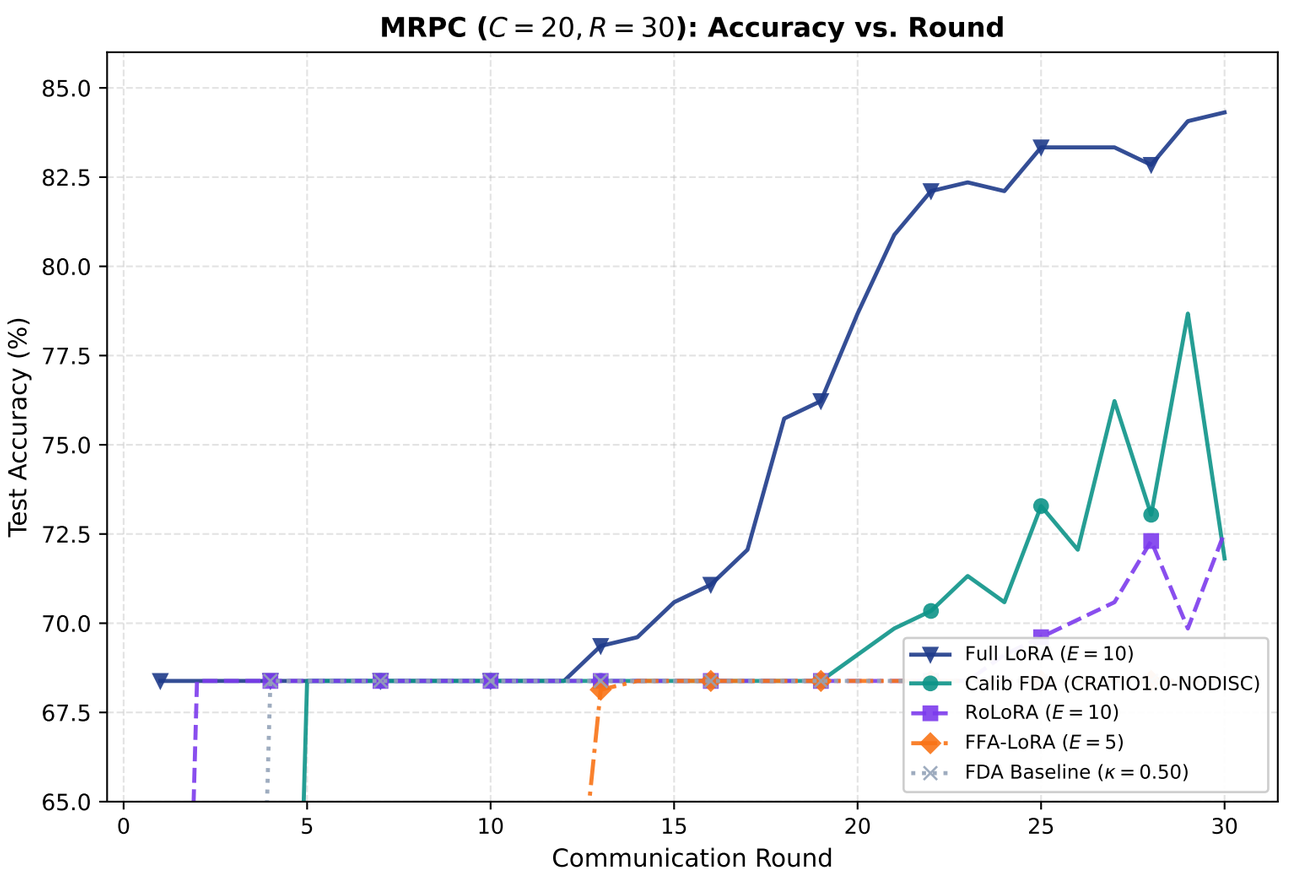
MRPC ($C = 20, R = 30$): Accuracy vs. Round
Test Accuracy (%)
Communication Round
Full LoRA ($E = 10$)
Calib FDA (CRATIO1.0-NODISC)
RoLoRA ($E = 10$)
FFA-LoRA ($E = 5$)
FDA Baseline ($\kappa = 0.50$)

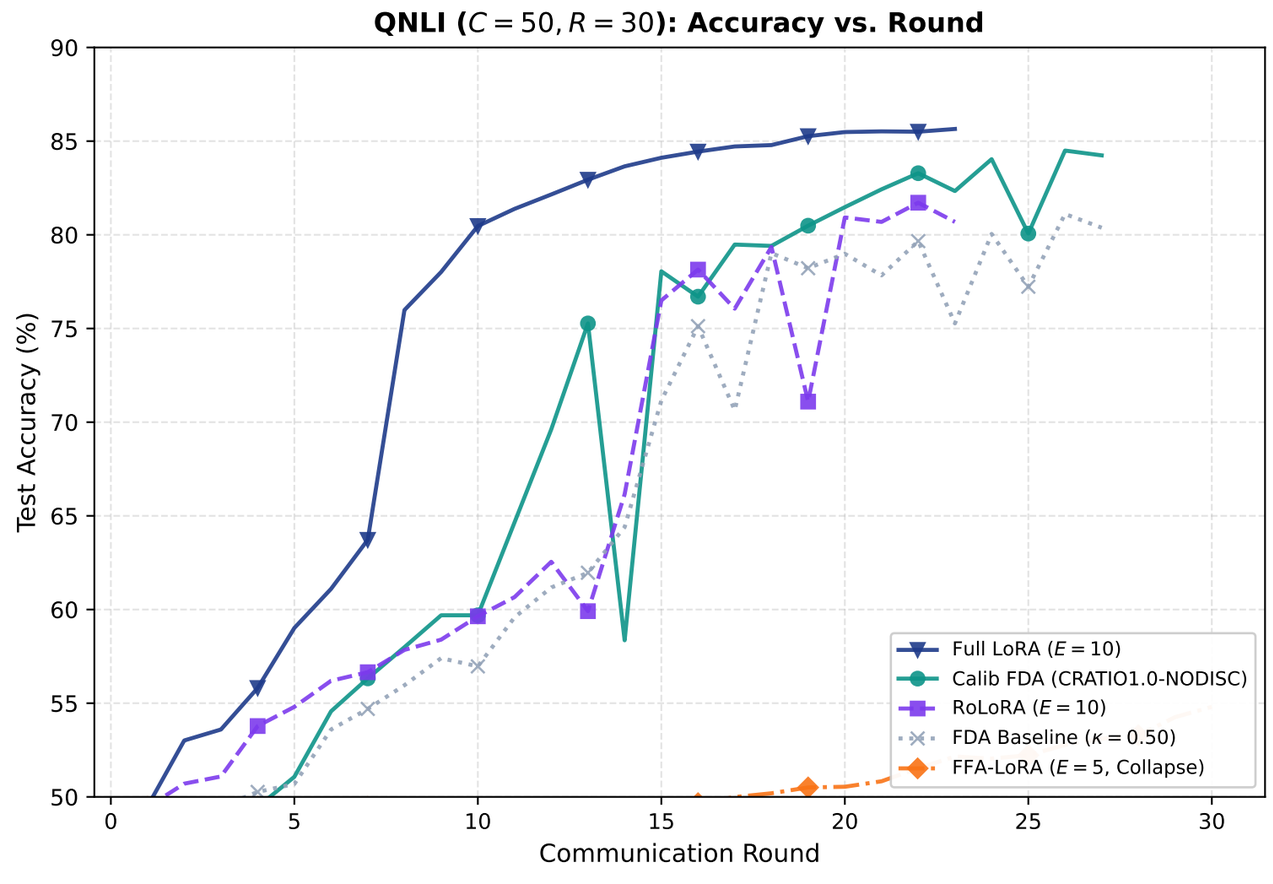
QNLI ($C = 50, R = 30$): Accuracy vs. Round
Test Accuracy (%)
Communication Round
Full LoRA ($E = 10$)
Calib FDA (CRATIO1.0-NODISC)
RoLoRA ($E = 10$)
FDA Baseline ($\kappa = 0.50$)
FFA-LoRA ($E = 5$, Collapse)

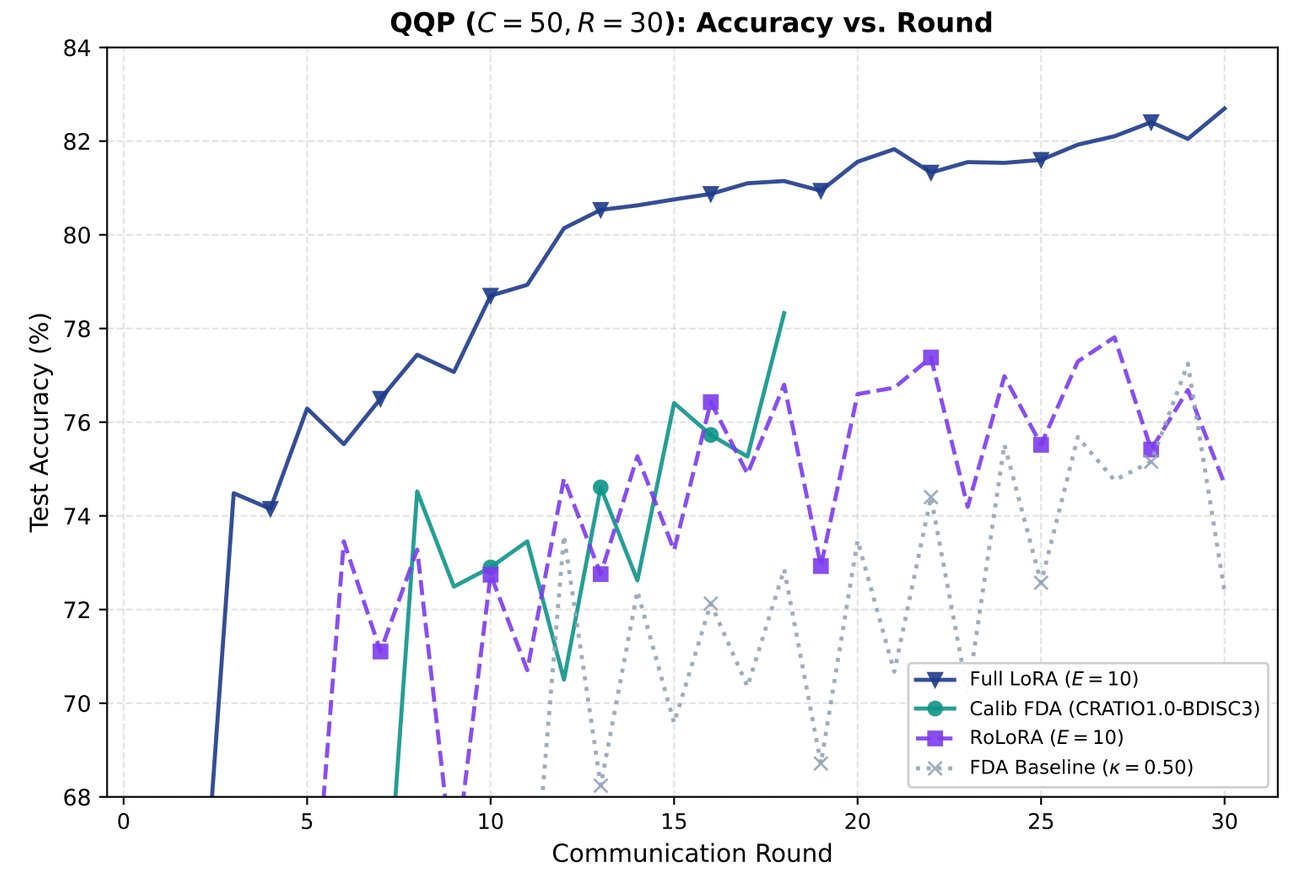
QQP ($C = 50, R = 30$): Accuracy vs. Round
Test Accuracy (%)
Communication Round
Full LoRA ($E = 10$)
Calib FDA (CRATIO1.0-BDISC3)
RoLoRA ($E = 10$)
FDA Baseline ($\kappa = 0.50$)