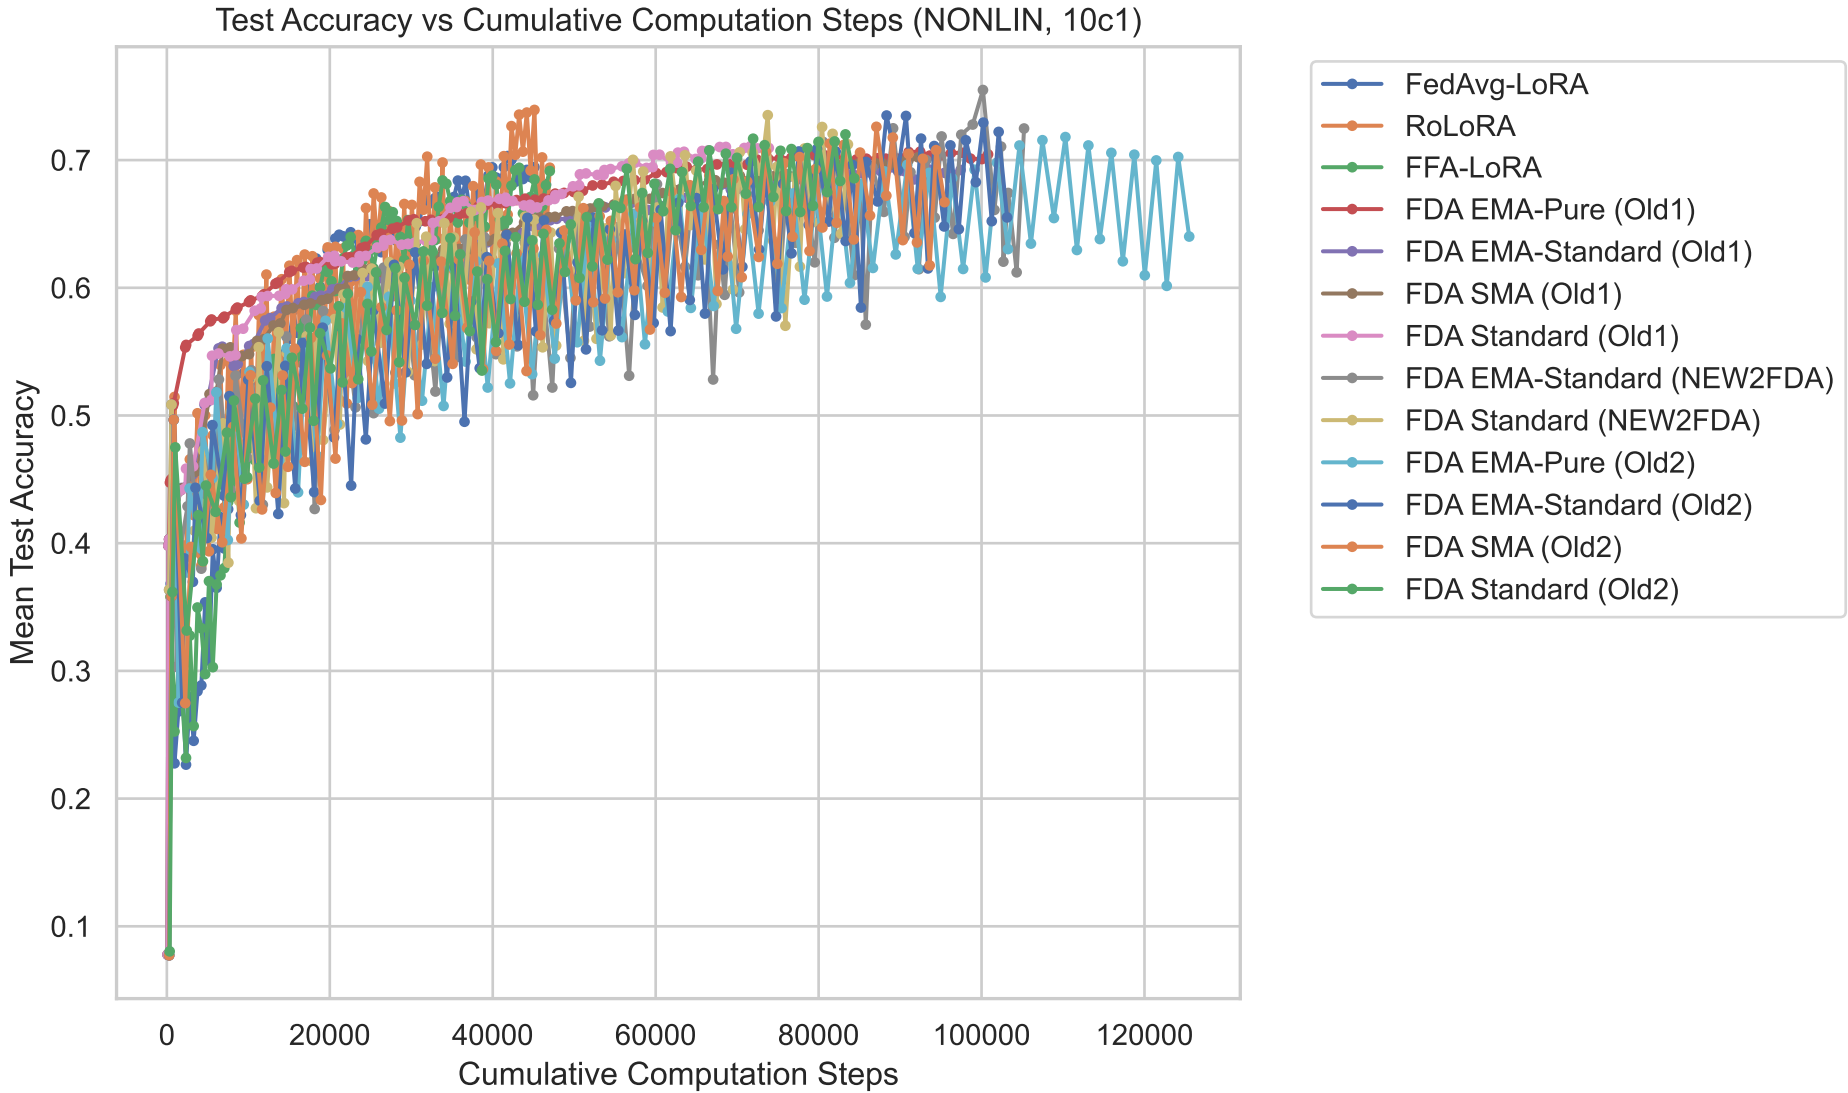
Test Accuracy vs Cumulative Computation Steps (NONLIN, 10c1)
Mean Test Accuracy
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Cumulative Computation Steps
FedAvg-LoRA
RoLoRA
FFA-LoRA
FDA EMA-Pure (Old1)
FDA EMA-Standard (Old1)
FDA SMA (Old1)
FDA Standard (Old1)
FDA EMA-Standard (NEW2FDA)
FDA Standard (NEW2FDA)
FDA EMA-Pure (Old2)
FDA EMA-Standard (Old2)
FDA SMA (Old2)
FDA Standard (Old2)