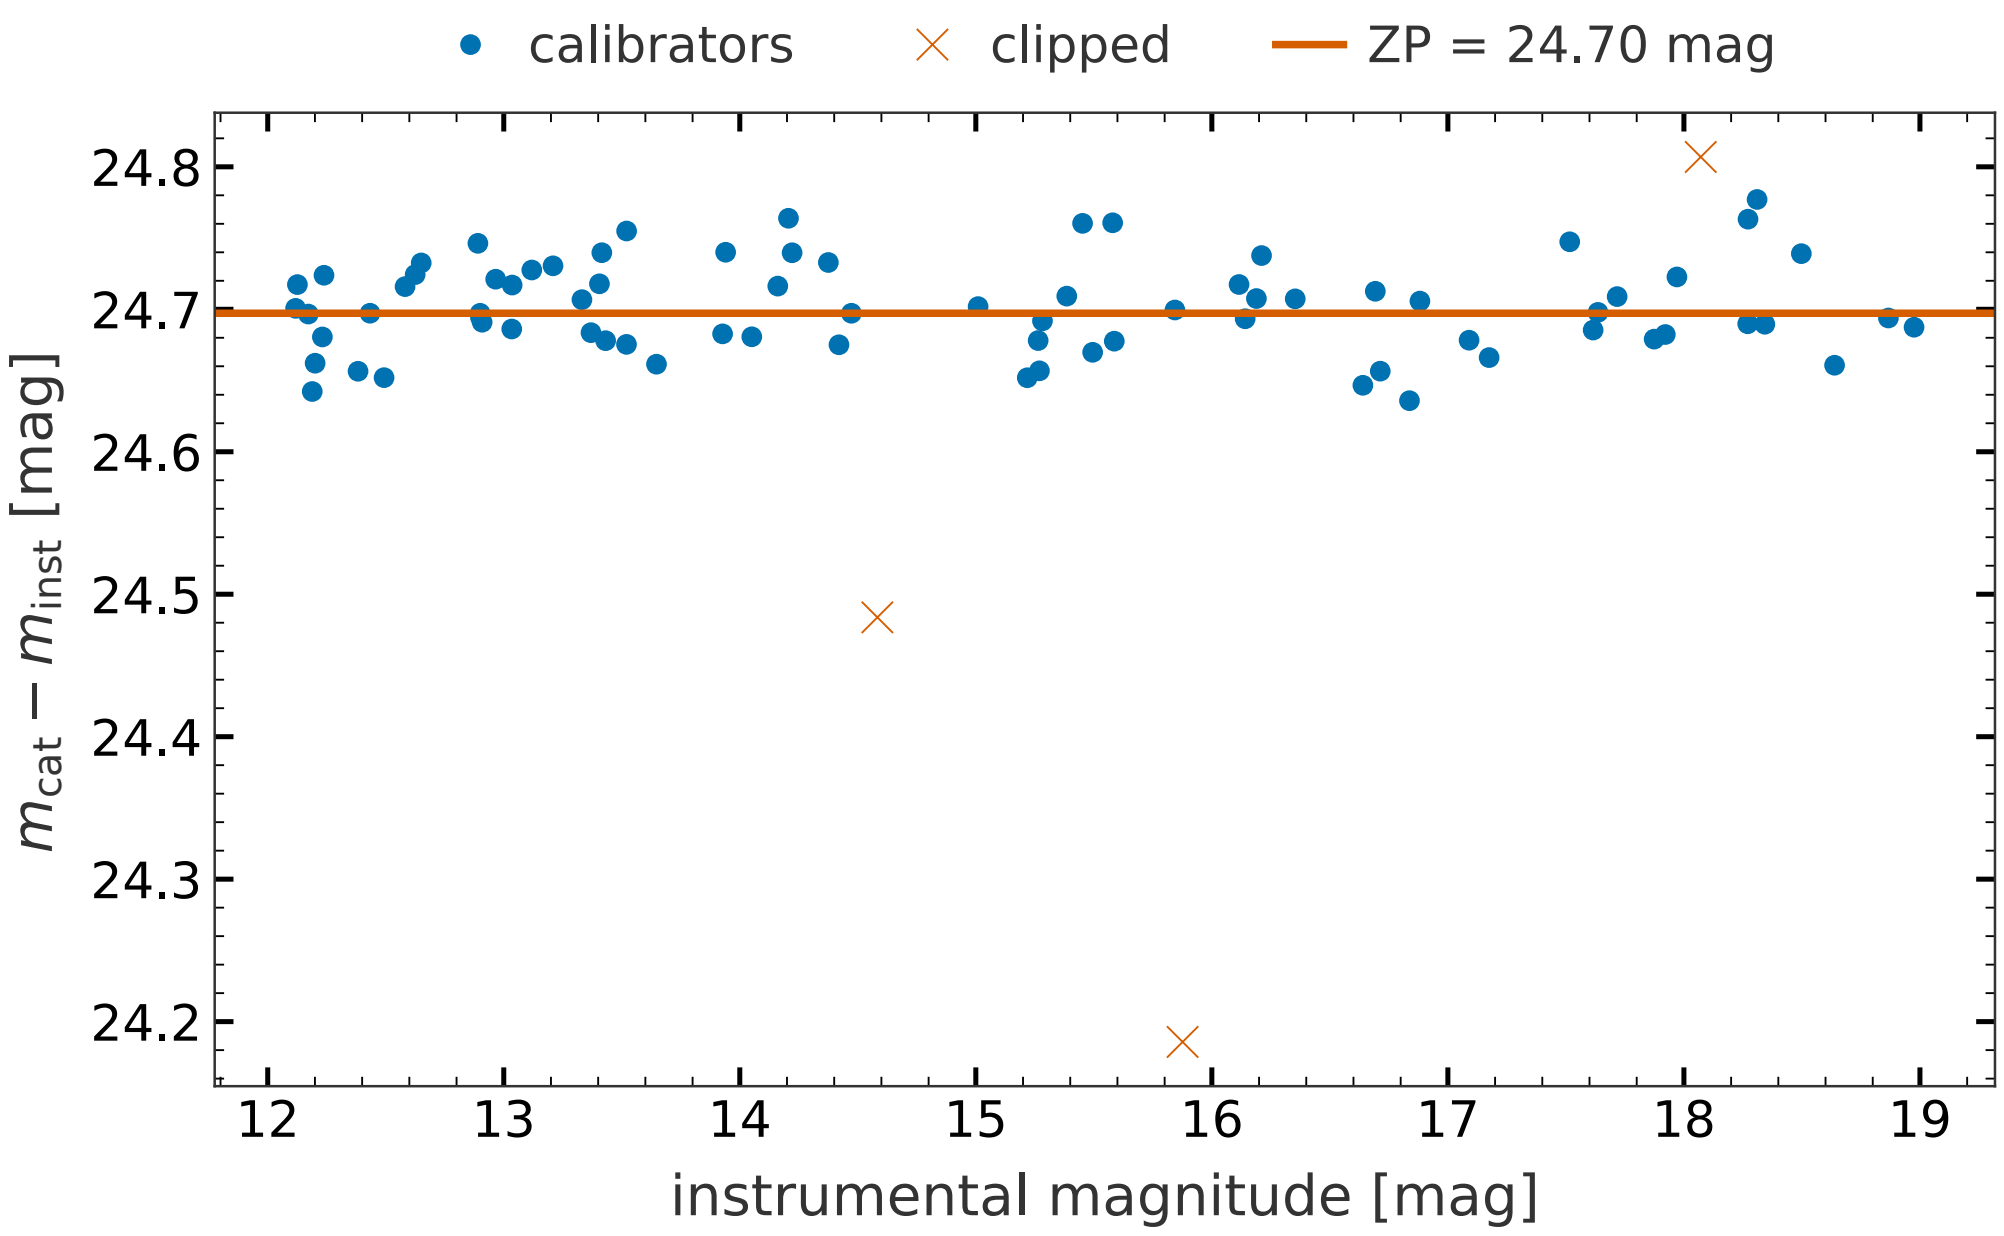
calibrators
clipped
ZP = 24.70 mag
24.8
24.7
24.6
24.5
24.4
24.3
24.2
$m_{cat} - m_{inst}$ [mag]
12
13
14
15
16
17
18
19
instrumental magnitude [mag]