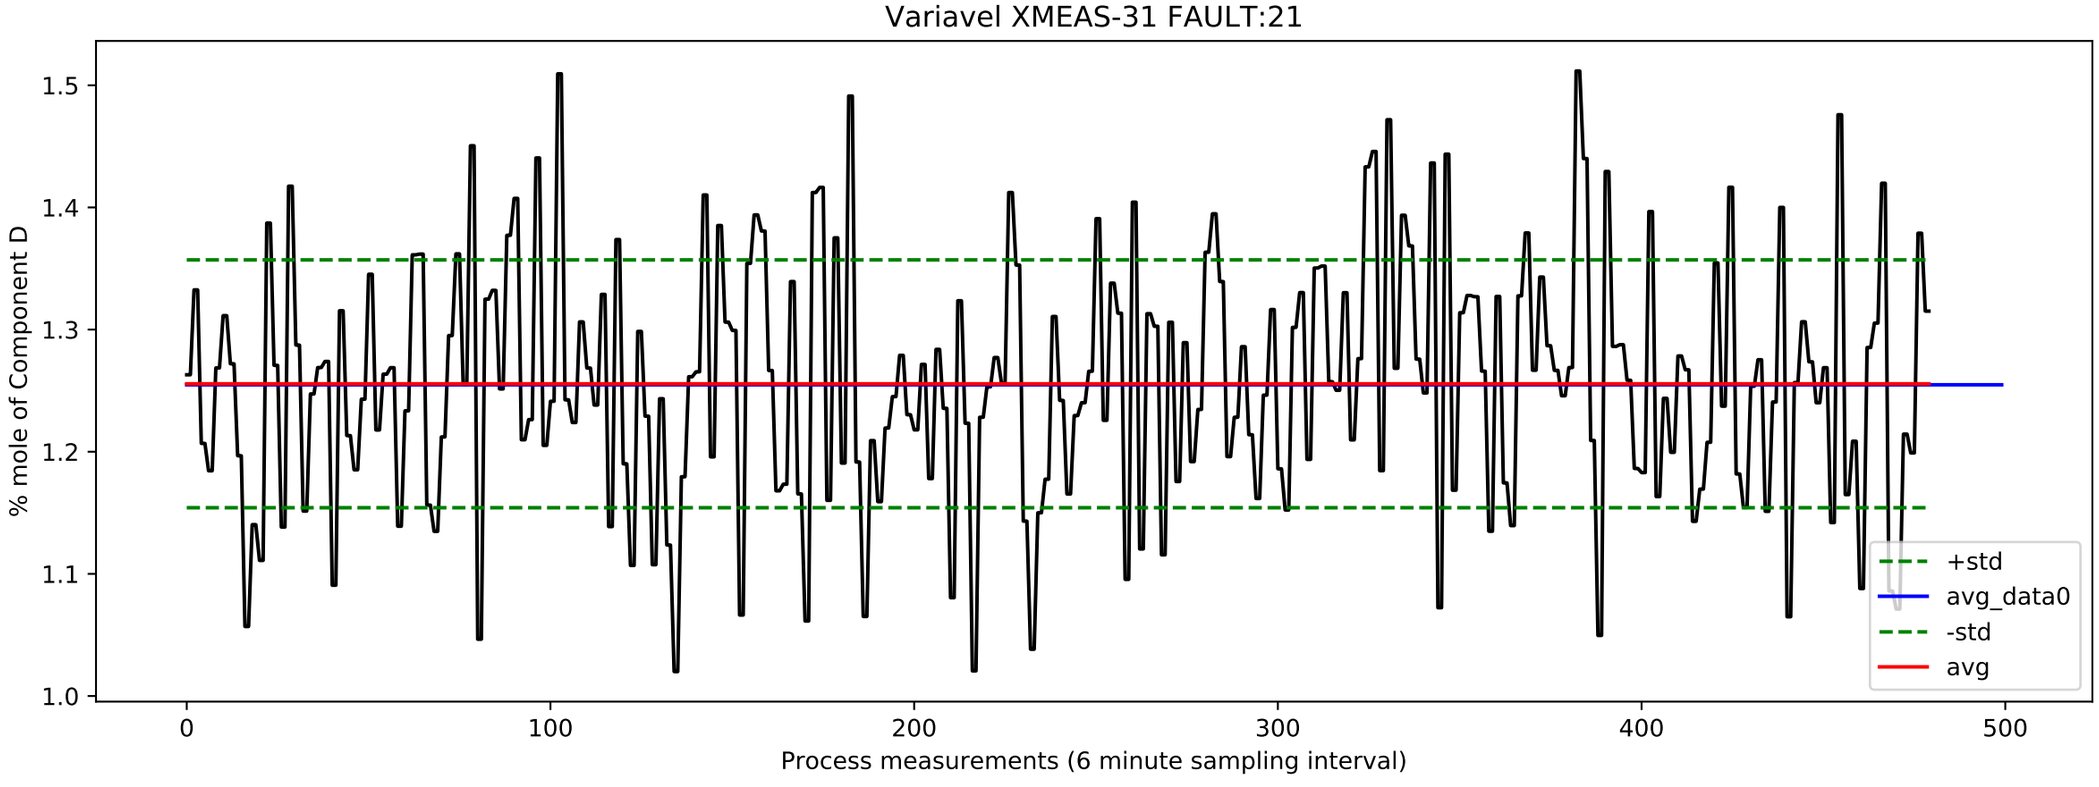
Variavel XMEAS-31 FAULT:21
% mole of Component D
Process measurements (6 minute sampling interval)
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
0
100
200
300
400
500
+std
avg_data0
-std
avg