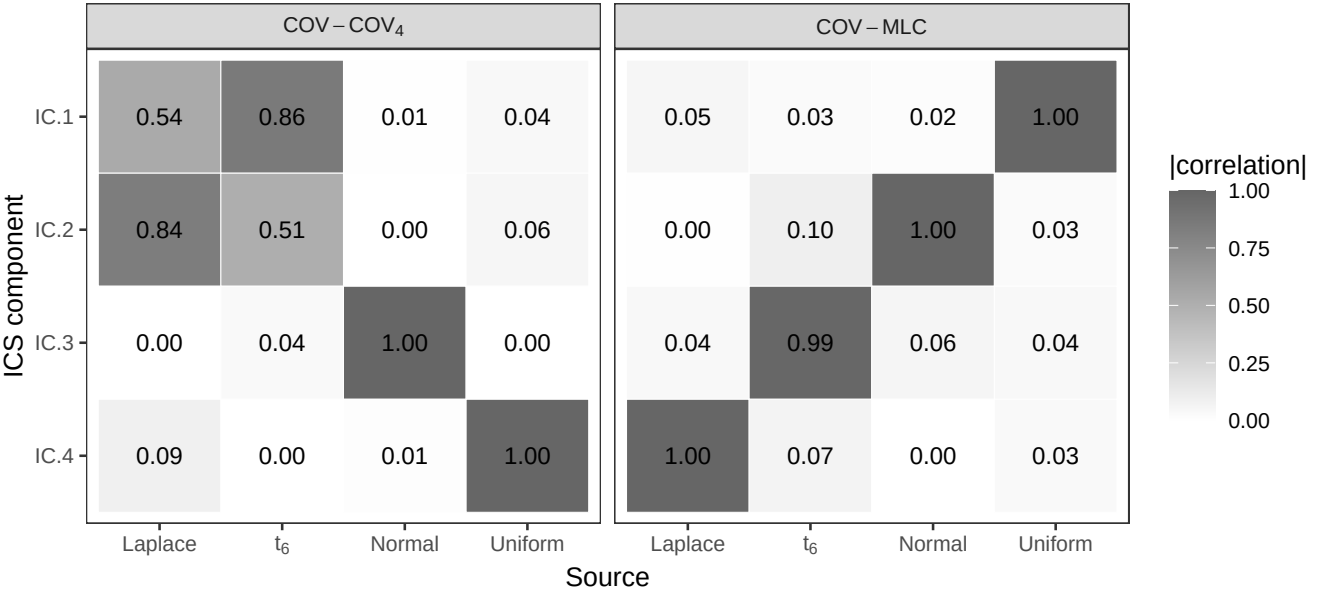
COV – COV4
COV – MLC
ICS component
IC.1
IC.2
IC.3
IC.4
0.54
0.86
0.01
0.04
0.05
0.03
0.02
1.00
0.84
0.51
0.00
0.06
0.00
0.10
1.00
0.03
0.00
0.04
1.00
0.00
0.04
0.99
0.06
0.04
0.09
0.00
0.01
1.00
1.00
0.07
0.00
0.03
Laplace
t6
Normal
Uniform
Laplace
t6
Normal
Uniform
Source
|correlation|
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00