Aspen
MEDICAL PRODUCTS

POPPLE 631 LSO
POPPLE 637 LSO

LUMBAR SACRAL ORTHOSIS
LUMBAL-SAKRALE ORTHESE
ÓRTESIS LUMBOSACRA
ORTESI SACRO-LOMBARE
ORTHÈSE LOMBO-SACRÉE
LUMBALE SACRALE ORTHESE
BEDERNÍ KŘÍŽOVÁ ORTÉZA
LUMBAL SAKRAL ORTOSE
ΟΣΦΥΪΚΗ ΟΡΘΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ
LUMBAL KORSRYGGORTOE
ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
LANNERANGAN SAKRAALINEN ORTOOSI
LUMBAL SAKRAL ORTOS
ОРТЕЗ ДЛЯ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
ÓRTESE SACRO LOMBAR
腰骶矫形器

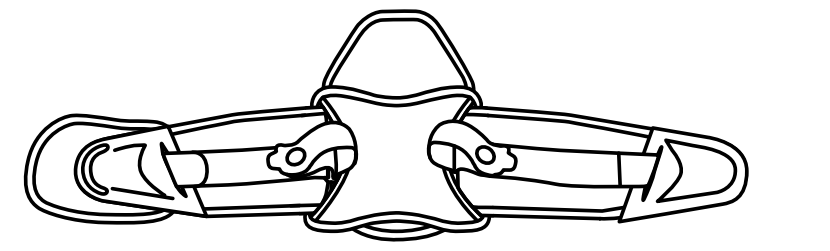
POPPLE 631 LSO

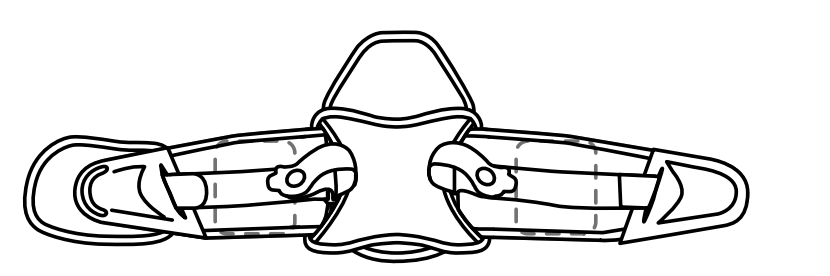
POPPLE 637 LSO

MD MEDICAL DEVICE
SINGLE PATIENT- MULTIPLE USE
CAUTION

CE
EU REP
EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Pat. aspenmp.com/patents

Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspenmp.com • +1-800-295-2776 • +1-949-681-0200
©2025 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.
LB0135B revised 12/2025

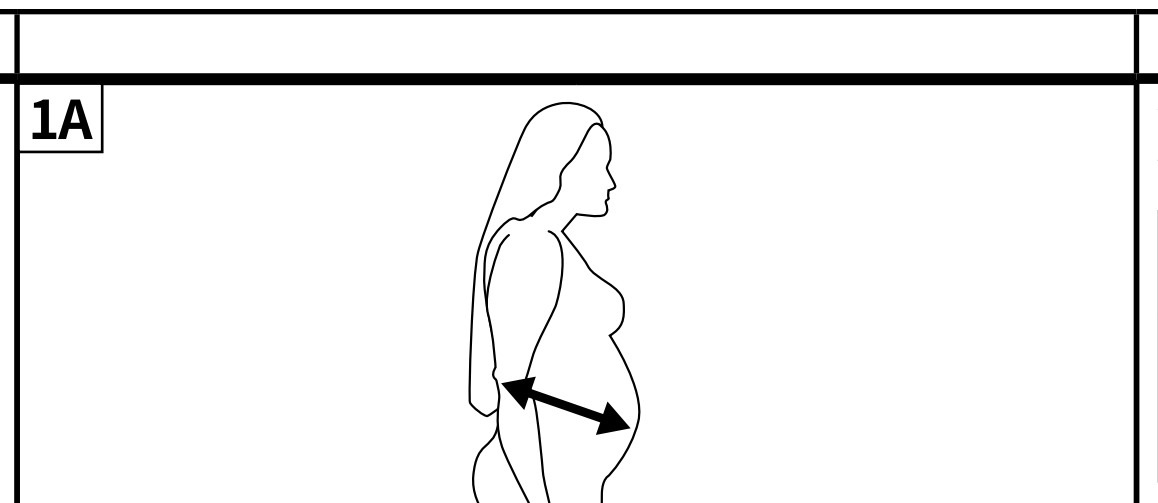



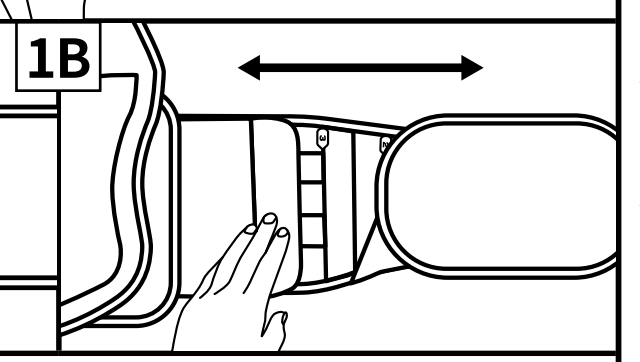

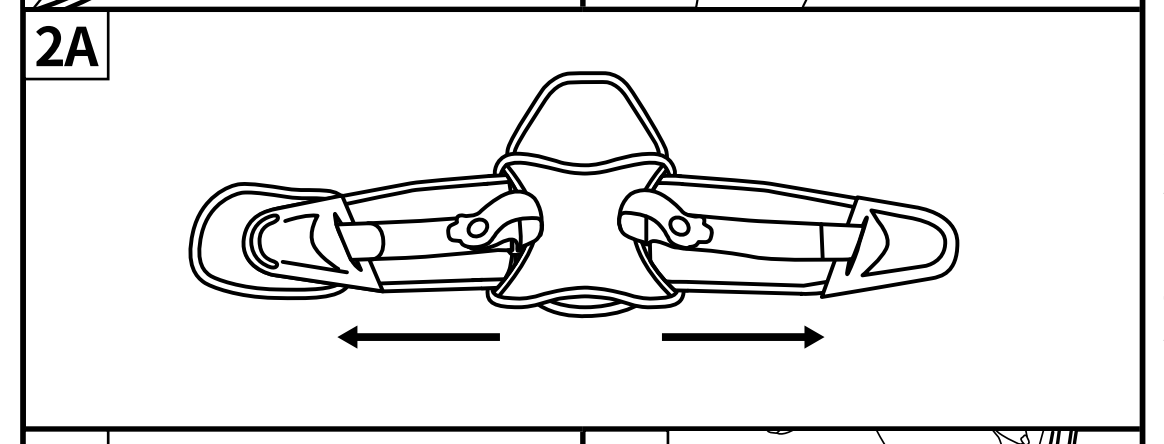



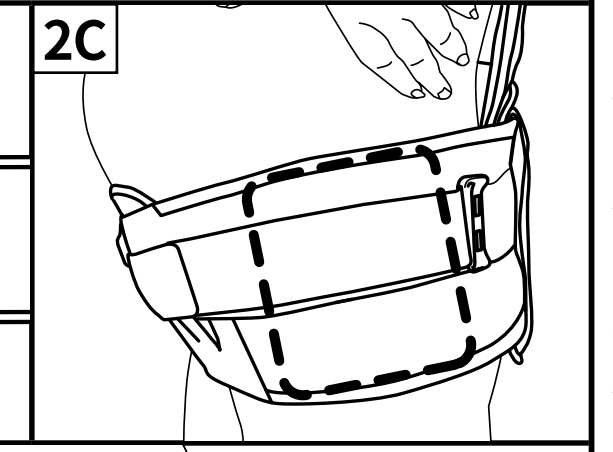

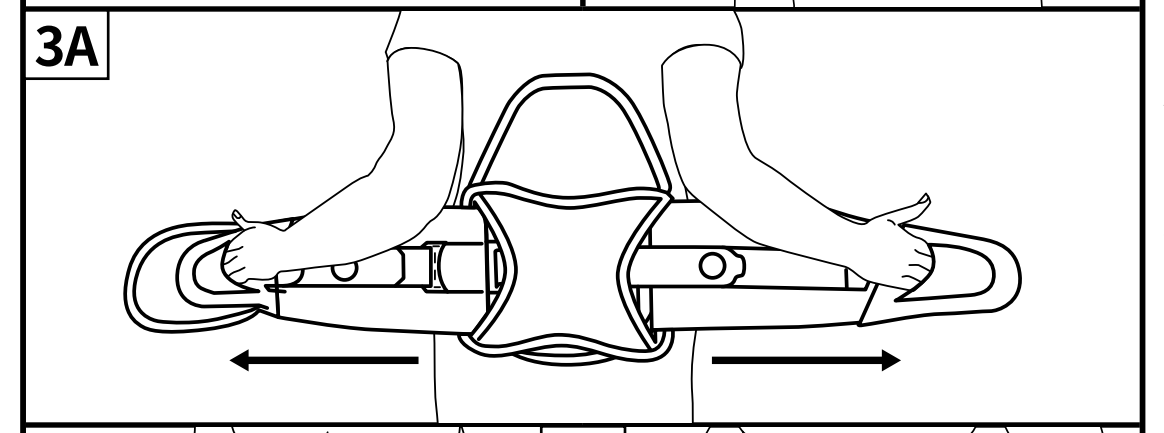



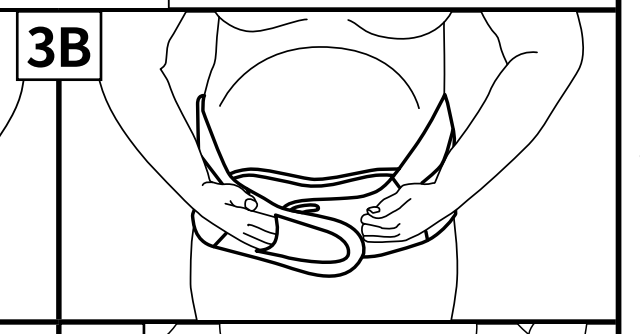



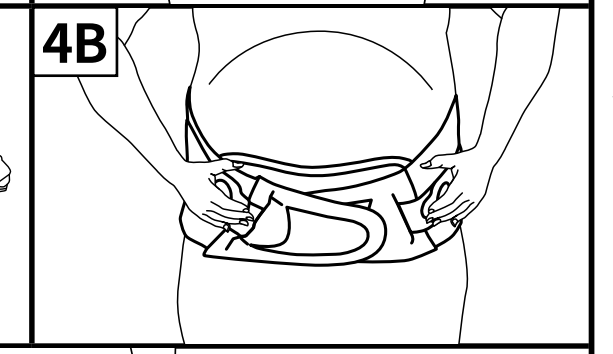

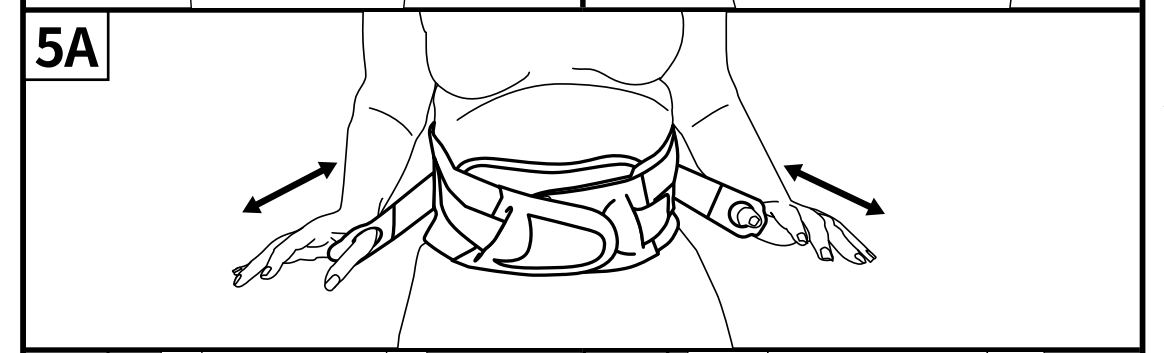



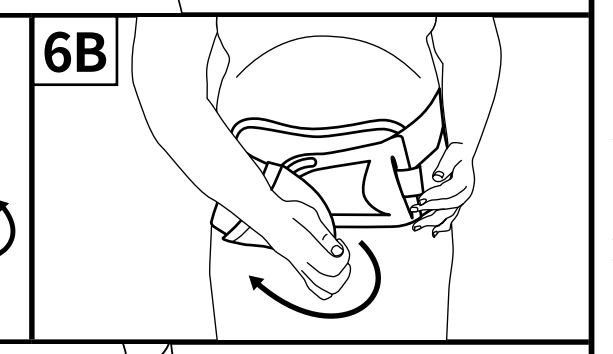

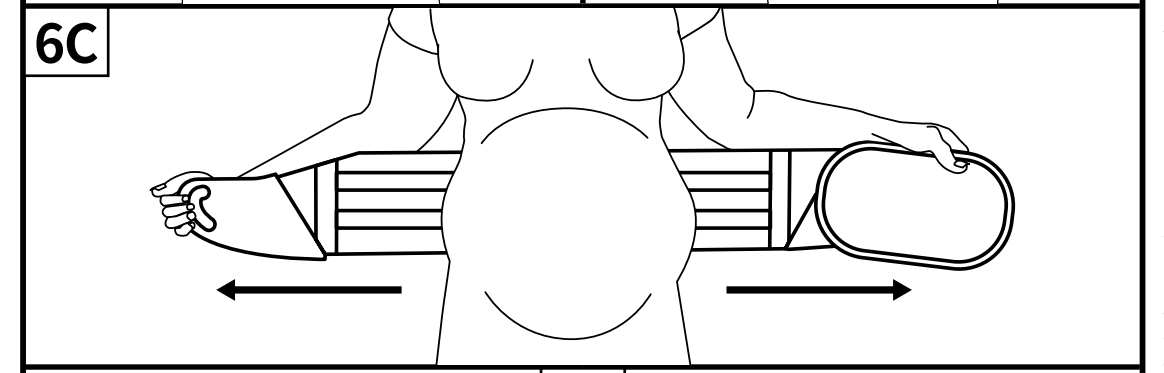



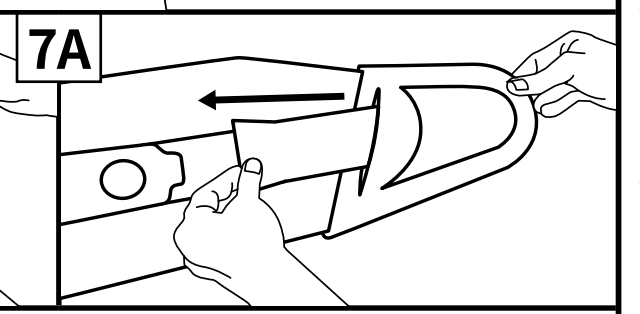

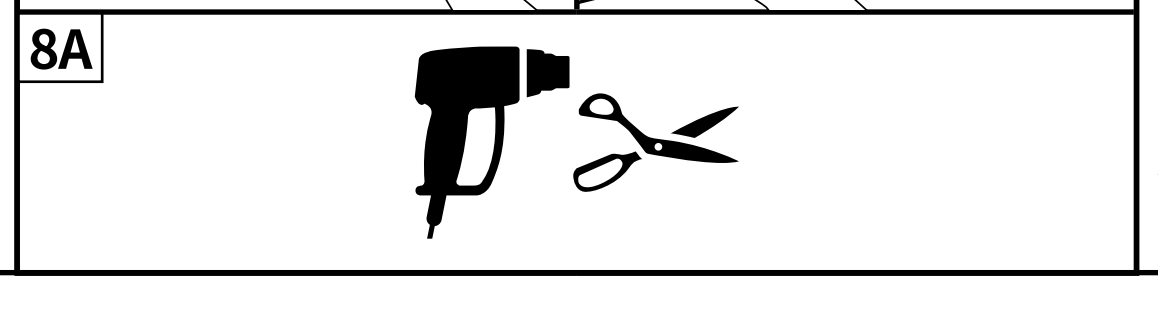

ENGLISH

1. SIZING AND ADJUSTMENT

A. Select appropriate brace size by measuring around the waist.

SIZING GUIDE		
SIZE	CIRCUMFERENCE	
Small	31 in - 37 in	78.74 cm - 93.98 cm
Medium	36 in - 48 in	91.44 cm - 121.92 cm
Large	47 in - 68 in	119.38 cm - 172.72 cm

B. To change the size of the belt, peel up the inside end of the side panel on each side. Adjust to proper fit and reattach.

2. PREPARATION

A. Place the pull tabs 2 inches (5.1 cm) from the back panel of the brace. Pull the ends of the belt away from each other ensuring that it is fully extended.

(POPPLE 637 LSO ONLY)

B. With brace extended fully, place one lateral panel on midline on each side panel of the brace. Press down to secure to brace.
C. When brace is properly fit to the patient, the lateral panels should fit at patient's midline.

3. APPLICATION

A. Apply the fully extended brace making sure the back panel is centered and low on the back.
B. Apply the brace to support the abdomen, the right side overlapping the left.

4. TIGHTENING

A. Slip your thumbs through the holes in the pull tabs. Pull away from your body. Adjust the compression as needed.
B. When tightened, secure the pull tabs back down on the brace.

5. ADJUSTMENT

A. Adjust the support by loosening or tightening the pull tabs as needed.

6. BRACE REMOVAL

A. Place the pull tabs on the side of the brace.
B. Peel the right side of the brace off the left side of the brace.
C. Fully extend the arms of the brace in preparation for next use.

7. STRAP LENGTH MODIFCATION

A. Compression straps can be made longer or shorter. Peel up hook end and adjust length before placing back down.

8. MODIFICATION OPTIONS

A. This product may be substantially modified by an individual with expertise. For more information, please visit www.aspenmp.com/education/product-modifications.

INTENDED USE

The intended use is to provide motion restriction and stability of the lumbar-sacral spine.

INDICATIONS

Low back pain, Sciatica, Pelvic girdle pain, Degenerative disc disease, Bulging or herniated disc, Spondylolysis, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Spondylosis (Osteoarthritis/Degenerative Joint Disease).

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity or allergies to any of the materials from which the brace is made. Swelling of the lymphatic tissue caused by circulatory disorders. Patients who are not allowed to wear a brace according to medical instructions.

PRECAUTIONS

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered as medical recommendations. If you suffer from a serious medical condition, we strongly suggest that you consult with a licensed health care professional before using this product. Proper fitting is required for this product to be effective. Under some circumstances, this product may be prescribed by a physician. Please see the limited warranty for further information.

CARE INSTRUCTIONS

Hand wash only at 30° C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or other chemicals.

MATERIALS

Acetal, Nylon, HDPE, Polyester, Elastane, Polyacrylate, Polyurethane, Polyethylene, Rubber, Spandex.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

DISPOSAL

Product may be safely disposed in accordance with local laws.

REPORTING

Please report any serious incident involving the use of this device to both the Competent Authority in your state and to the manufacturer (listed on this document).

LIMITED WARRANTY

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product that it is free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products, LLC in the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or part(s).

Aspen Medical Products, LLC shall have no obligation under this limited warranty in the event:
(a) The product was not purchased from Aspen Medical Products, LLC or through its authorized channels of distribution;
(b) The product is altered;
(c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products, LLC are inserted into the product; or
(d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products, LLC Instructions for Use.

THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FAILURE IN SERVICE OF, OR DEFECT IN, THE PRODUCT. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCTS, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from location to location.

A listing of authorized distributors in your area is available upon request.

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered as medical recommendations.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR APPLICATION BY LICENSED HEALTH CARE PRACTITIONERS AS DIRECTED BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED MEDICAL AUTHORITY. PERMANENT INJURY MAY RESULT FROM USE OTHER THAN AS DIRECTED BY A PHYSICIAN OR OTHER MEDICAL AUTHORITY. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR LIABILITY FOR INJURY OR DAMAGE BY REASON OF ANY APPLICATION OF THIS PRODUCT. PLEASE SEE THE LIMITED WARRANTY FOR FURTHER INFORMATION IN THIS REGARD.

DEUTSCH

ASPEN MEDICAL PRODUCTS GmbH Im Leuschnerpark 4, 64347 Griesheim
aspenmp.de · +49 (0) 6155 89791-0 · Pat. aspenmp.de/patents

1. GRÖSSE UND ANPASSUNG

A. Wählen Sie die passende Korsettgröße aus, indem Sie Ihren Taillenumfang messen.

GRÖSSENTABELLE		
GRÖßE	UMFANG	
Small	31 - 37 in	78.74 cm - 93.98 cm
Medium	36 - 48 in	91.44 cm - 121.92 cm
Large	47 - 68 in	119.38 cm - 172.72 cm

B. Um die Größe des Gurtes zu ändern, ziehen Sie das innere Ende der Seitenplatte auf jeder Seite nach oben. Passen Sie das Korsett so an, dass es gut sitzt, und befestigen Sie es erneut.

2. VORBEREITUNG

A. Platzieren Sie die Aufreißlaschen 2 Zoll (5,1 cm) von der hinteren Platte des Korsetts entfernt. Ziehen Sie die Enden des Gurtes auseinander, bis er vollständig gelöst ist.

(NUR POPPLE 637 LSO)

B. Mit vollständig gelöster Stütze eine seitliche Platte auf die Mittellinie auf jede Seitenplatte der Stütze legen. Zum Sichern auf das Korsett nach unten drücken.
C. Wenn das Korsett entsprechend am Patienten angebracht ist, sollten die Seitenplatten auf der Mittellinie des Patienten zusammenpassen.

3. ANWENDUNG

A. Legen Sie das vollständig gelöste Korsett an und achten Sie dabei darauf, dass die hintere Platte zentriert und im unteren Bereich des Rückens ist.
B. Bringen Sie das Korsett fest um den Bauch an, wobei die rechte Seite die linke überlappen muss.

4. FESTZIEHEN

A. Schieben Sie Ihre Daumen durch die Löcher in den Aufreißlaschen. Ziehen Sie von Ihrem Körper weg. Stellen Sie die Kompression nach Bedarf ein.
B. Wenn Sie die Laschen festgezogen haben, befestigen Sie sie wieder an dem Korsett.

5. EINSTELLUNG

A. Passen Sie die Unterstützung an, indem Sie die Aufreißlaschen nach Bedarf lösen oder festziehen.

6. ABNEHMEN DES KORSETTS

A. Positionieren Sie die Aufreißlaschen an der Seite des Korsetts.
B. Ziehen Sie die rechte Seite des Korsetts von der linken Seite des Korsetts ab.
C. Lösen Sie die Stege der Orthese zur Vorbereitung auf den nächsten Einsatz vollständig.

7. ÄNDERUNG DER GURTLÄNGE

A. Kompressionsgurte können länger oder kürzer gemacht werden. Ziehen Sie das Hakenende ab und passen Sie die Länge an, bevor Sie es wieder auflegen.

8. ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

A. Dieses Produkt kann von einer erfahrenen Person wesentlich angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.aspenmp.com/education/product-modifications.

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist die Bewegungseinschränkung und das Herstellen von Stabilität der thorakalen, lumbalen und sakralen Wirbelsäule.

INDIKATIONEN

Schmerzen im unteren Rücken, Ischias, Schmerzen im Beckengürtel, degenerative Bandscheibenerkrankung, Bandscheibenvorfall, Spondylolyse, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose, Spondylose (Osteoarthritis/degenerative Gelenkerkrankung).

KONTRAINDIKATIONEN

Überempfindlichkeit oder Allergien gegen eines der Materialien, aus denen das Korsett hergestellt ist. Anschwellen des Lymphgewebes verursacht durch Kreislaufstörungen. Patienten, die entsprechend den medizinischen Anweisungen kein Korsett tragen dürfen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Geräts sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen dienen nur als Richtlinie und sind nicht als medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn Sie unter einer ernsten Krankheit leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Dieses Produkt muss richtig angelegt werden, um wirksam zu sein. Unter manchen Bedingungen kann dieses Produkt von einem Arzt angeordnet werden. Bitte beachten Sie die beschränkte Garantie für weitere Informationen.

PFLEGEHINWEISE

Nur von Hand waschen bei 30 °C; mit einem milden Reinigungsmittel waschen; an der Luft trocknen; keine Bleiche oder sonstige Chemikalien verwenden.

MATERIALIEN

Acetal, Nylon, HDPE, Polyester, Elastan, Polyacrylat, Polyurethan, Polyethylen, Gummi, Spandex.

OHNE NATURKAUTSCHUKLATEX.

ENTSORGUNG

Das Produkt kann sicher entsprechend der örtlichen Gesetzgebung entsorgt werden.

MELDUNG

Bitte melden Sie alle schweren Zwischenfälle im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Vorrichtung der zuständigen Behörde in Ihrem Staat und dem (in diesem Dokument aufgelisteten) Hersteller.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 garantiert dem Benutzer, der dieses Produkt ursprünglich gekauft hat, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Die einzige Verpflichtung von Aspen Medical Products, LLC bei einer Garantieverletzung wird die Reparatur oder der Ersatz des defekten Produktes oder des Teils/der Teile sein.

Aspen Medical Products, LLC wird unter dieser beschränkten Garantie keine Verpflichtung haben, wenn:
(a) das Produkt nicht bei Aspen Medical Products, LLC oder über seine autorisierten Vertriebskanäle erworben wurde;
(b) das Produkt verändert wurde;
(c) irgendwelche, nicht von Aspen Medical Products, LLC bereitgestellte Teile in das Produkt eingefügt werden, oder
(d) das Produkt nicht entsprechend der Gebrauchsanweisungen von Aspen Medical Products, LLC verwendet wird.

DAS VORSTEHENDE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE BEI EINEM AUSFALL ODER DEFEKT DES PRODUKTES. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC WIRD UNTER DIESER ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT FÜR JEGLICHE INDIREKTEN, BESONDEREN, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN HAFTBAR SEIN. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DIE GEWÄHR DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNGEN SEITENS ASPEN MEDICAL PRODUCTS FÜR SCHÄDEN, DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DER PRODUKTE ERGEBEN, WELCHE HIERMIT VON ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ABGELEHNT UND AUSGESCHLOSSEN WERDEN.

Diese Garantie gibt Ihnen konkrete Rechtsansprüche und Sie könnten andere Rechte haben, die je nach Standort variieren.

Eine Liste der autorisierten Lieferanten in Ihrer Gegend ist auf Anfrage verfügbar.

Hinweis für Sehbehinderte und Blinde:

Das Produkt wird von Fachpersonal an den Patienten abgegeben und dieser wird in den Gebrauch eingewiesen.

ESPAÑOL

1. TAMAÑO Y AJUSTE

A. Tome las medidas del contorno de la cintura para seleccionar la talla adecuada del soporte lumbar.

GUÍA DE TALLAS		
TALLA	CIRCUNFERENCIA	
Pequeño (S)	31 - 37 pulgadas	78.74 cm - 93.98 cm
Mediano (M)	36 - 48 pulgadas	91.44 cm - 121.92 cm
Grande (L)	47 - 68 pulgadas	119.38 cm - 172.72 cm

B. Para cambiar la talla del cinturón, despegue el extremo interior del panel lateral en cada lado. Ajuste hasta conseguir el tamaño adecuado y vuelva a colocar.

2. PREPARACIÓN

A. Coloque las lengüetas a 2 pulgadas (5.1 cm) del panel posterior del soporte. Tire de los extremos del cinturón alejándolos unos de otros para asegurarse de que estén completamente extendidos.

(SOLO POPPLE 637 LSO)

B. Con el soporte lumbar totalmente extendido, coloque un panel lateral sobre la línea media de cada lado del soporte. Presione para sujetar al soporte.
C. Cuando el soporte se ajusta correctamente al paciente, los paneles laterales deben ajustarse en la línea media del paciente.

3. COLOCACIÓN

A. Coloque el soporte completamente extendido, asegurándose de que el panel posterior esté centrado y en la parte baja de la espalda.
B. Coloque el soporte para dar apoyo al abdomen, con el lado derecho superponiéndose al izquierdo.

4. APRIETE

A. Deslice los pulgares a través de los orificios en las lengüetas de tracción. Tire alejándolos de su cuerpo. Ajuste la compresión, según sea necesario.
B. Una vez apretado, vuelva a asegurar las lengüetas hacia abajo en el soporte.

5. AJUSTE

A. Ajuste el soporte aflojando o apretando las lengüetas de tracción según sea necesario.

6. RETIRO DEL SOPORTE

A. Coloque las lengüetas de tracción en el costado del soporte.
B. Separe el lado derecho del soporte del lado izquierdo del mismo.
C. Extienda completamente los brazos del soporte como preparación para el próximo uso.

7. MODIFICACIÓN DE LA LONGITUD DE LA CORREA

A. Las correas de compresión pueden hacerse más largas o más cortas. Levante el extremo con gancho y ajuste la longitud antes de volver a colocarlo.

8. OPCIONES DE MODIFICACIÓN

A. Este producto puede ser modificado sustancialmente por una persona con experiencia. Para obtener más información, visite www.aspenmp.com/education/product-modifications.

USO PREVISTO

El uso previsto es proporcionar restricción de movimiento y estabilidad de la columna lumbar-sacra.

INDICACIONES

Dolor lumbar, ciática, dolor en la cintura pélvica, enfermedad degenerativa del disco, protusión o hernia de disco, espondilólisis, espondilolistesis, estenosis espinal, espondilosis (osteoartritis/enfermedad degenerativa de las articulaciones).

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergias a cualquiera de los materiales de los que está hecho el soporte. Hinchazón del tejido linfático causada por trastornos circulatorios. Pacientes a quienes no se les permite usar un soporte de acuerdo con instrucciones médicas.

PRECAUCIONES

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Se necesita una capacitación adecuada acerca del uso de este dispositivo antes de colocarlo. Estas instrucciones son solo pautas y no se ofrecen como recomendaciones médicas. Si padece una afección médica grave, le recomendamos muy especialmente que consulte con un profesional de la salud con licencia antes de usar este producto. Se requiere un ajuste adecuado para que este producto sea eficaz. En algunas circunstancias, este producto puede ser recetado por un médico. Consulte la garantía limitada para obtener más información.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Lave a mano solamente y a 30 °C. Lave con detergente suave. Deje secar al aire. No use blanqueador ni otros productos químicos.

MATERIALES

Acetal, nailon, HDPE, poliéster, elastano, poliacrilato, poliuretano, polietileno, caucho, spandex.

NO ESTÁ HECHO CON LÁTEX DE GOMA NATURAL.

ELIMINACIÓN

El producto se puede eliminar de forma segura de acuerdo a las normas locales.

INFORME

Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso de este dispositivo tanto a la autoridad competente de su estado como al fabricante (mencionado en este documento).

GARANTÍA LIMITADA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantiza al comprador original y al usuario que este producto está libre de defectos de material y mano de obra. La única obligación de Aspen Medical Products, LLC en el caso de violación de la garantía, será la de reparar o reemplazar el producto o las piezas con fallas.

Aspen Medical Products, LLC no tendrá obligación alguna respecto de esta garantía limitada en los siguientes casos:
(a) El producto no fue comprado a Aspen Medical Products, LLC ni a través de sus canales de distribución autorizados.
(b) El producto fue modificado.
(c) Cualquier repuesto no suministrado por Aspen Medical Products, LLC fue insertado en el producto.
(d) El producto no se utiliza de acuerdo con las Instrucciones de Uso de Aspen Medical Products, LLC.

EL PRESENTE CONSTITUYE EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO O DEFECTO EN EL PRODUCTO. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC, NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA CONFORME A ESTA GARANTÍA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O EMERGENTES. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUSO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO DETERMINADO, Y TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POR LOS DAÑOS QUE SE DERIVEN O ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO DE LOS PRODUCTOS, QUE POR LA PRESENTE SON RECHAZADOS Y EXCLUIDOS POR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garantía le otorga derechos legales específicos que pueden variar según la ubicación.

Una lista de distribuidores autorizados en su área está disponible a su pedido.

ITALIANO

1. TAGLIA E REGOLAZIONE

A. Selezionare la taglia appropriata del tutore misurando la circonferenza della vita.

GUIDA ALLE TAGLIE		
TAGLIA	CIRCONFERENZA	
Piccola (S)	31" - 37"	78.74 cm - 93.98 cm
Media (M)	36" - 48"	91.44 cm - 121.92 cm
Grande (L)	47" - 68"	119.38 cm - 172.72 cm

B. Per modificare la taglia della fascia, sollevare l'estremità interna del pannello laterale su ciascun lato. Regolare fino a ottenere la misura corretta e riapplicare.

2. PREPARAZIONE

A. Posizionare le linguette di trazione a 2 pollici (5,1 cm) dal pannello posteriore del tutore. Tirare le estremità della fascia in direzioni opposte assicurandosi che sia completamente estesa.

(SOLO PER POPPLE 637 LSO)

B. Con il tutore completamente esteso, posizionare un pannello laterale sulla linea mediana di ciascun pannello laterale del tutore. Premere per fissare al tutore.
C. Quando il tutore è adattato comodamente al paziente, i pannelli laterali devono trovarsi in corrispondenza della linea mediana del paziente.

3. APPLICAZIONE

A. Applicare il tutore completamente esteso assicurandosi che il pannello posteriore sia centrato e posizionato sulla parte bassa della schiena.
B. Applicare il tutore a supporto dell'addome, sovrapponendo il lato destro su quello sinistro.

4. STRINGIMENTO

A. Infilare i pollici nelle aperture delle linguette di trazione. Tirare verso l'esterno, allontanandole dal corpo. Regolare la compressione come necessario.
B. Una volta regolato lo stringimento, fissare di nuovo le linguette sul tutore.

5. REGOLAZIONE

A. Regolare il supporto allentando o stringendo le linguette di trazione come necessario.

6. RIMOZIONE DEL TUTORE

A. Posizionare le linguette di trazione sui lati del tutore.
B. Sollevare il lato destro del tutore per separarlo dal lato sinistro.
C. Estendere completamente le estremità del tutore in preparazione all'utilizzo successivo.

7. MODIFICA DELLA LUNGHEZZA DELLE CINGHIE

A. Le cinghie di compressione possono essere allungate o accorciate. Sollevare l'estremità con il velcro e regolare la lunghezza prima di riposizionarla.

8. OPZIONI DI MODIFICA

A. Questo prodotto può essere modificato da personale qualificato. Per maggiori informazioni, visitare: www.aspenmp.com/education/product-modifications.

USO PREVISTO

Il prodotto è progettato per fornire limitazione del movimento e stabilità della colonna vertebrale lombare-sacrale.

INDICAZIONI

Lombalgia, sciatalgia, dolore alla cintura pelvica, malattia degenerativa del disco, protrusione o ernia del disco, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi spinale, spondilosi (osteoartrite/malattia degenerativa delle articolazioni).

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità o allergie ai materiali con cui è realizzato il tutore. Gonfiore del tessuto linfatico causato da disturbi circolatori. Pazienti a cui, per indicazione medica, non è consentito indossare un tutore.

PRECAUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Prima dell'applicazione di questo dispositivo è necessario effettuare una formazione adeguata sull'utilizzo. Queste indicazioni sono solo linee guida e non sono offerte come raccomandazioni mediche. Se si soffre di una grave condizione medica, si consiglia vivamente di consultare un professionista sanitario autorizzato prima di utilizzare questo prodotto. Per l'efficacia di questo prodotto è necessario una vestizione adeguata. In alcune circostanze, questo prodotto può essere prescritto da un medico. Per ulteriori informazioni consultare la garanzia limitata.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Lavare a mano solo a 30° C; lavare con un detergente delicato; asciugare all'aria; non usare candeggina o altri prodotti chimici.

MATERIALI

Acetale, Nylon, HDPE, Poliestere, Elastan, Poliacrilato, Poliuretano, Polietilene, Gomma, Spandex.

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto in sicurezza ai sensi delle norme locali.

SEGNALAZIONI

Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave che coinvolge l'utilizzo di questo dispositivo sia all'autorità competente del tuo paese che al produttore (elencati in questo documento).

GARANZIA LIMITATA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantisce all'utente che acquista originariamente questo prodotto che è privo di difetti materiali e di lavorazione. L'unico obbligo di Aspen Medical Products, LLC in caso di violazione della garanzia sarà quello di riparare o sostituire il prodotto o le parti difettose.

Aspen Medical Products, LLC non avrà alcun obbligo ai sensi della presente garanzia limitata nei seguenti casi:
(a) Il prodotto non è stato acquistato da Aspen Medical Products, LLC o attraverso i suoi canali di distribuzione autorizzati;
(b) Il prodotto è stato alterato;
(c) Nel prodotto parti sono state inserite non fornite da Aspen Medical Products, LLC; o
(d) Il prodotto non è utilizzato ai sensi delle istruzioni per l'uso fornite da Aspen Medical Products, LLC.

QUANTO SOPRA È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO O IL DIFETTO DEL PRODOTTO. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NON SARÀ RESPONSABILE IN BASE A QUESTA O A QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA PER DANNI DIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESA LA GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O USO, E TUTTI GLI OBBLIGHI O RESPONSABILITÀ DA PARTE DI ASPEN MEDICAL PRODUCTS PER DANNI DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALL'USO DEI PRODOTTI, CHE SONO QUI DECLINATE ED ESCLUSE DA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici e l'utente può avere altri diritti che variano da località a località.

L'elenco dei distributori autorizzati nella zona dell'utente è disponibile su richiesta.

FRANÇAIS

1. TAILLE ET AJUSTEMENT

A. Sélectionnez la taille appropriée de l'orthèse appropriée en mesurant le tour de taille.

GUIDE DES TAILLES		
TAILLE	CIRCONFÉRENCE	
Petite	31 - 37 po	78.74 cm - 93.98 cm
Moyenne	36 - 48 po	91.44 cm - 121.92 cm
Grande	47 - 68 po	119.38 cm - 172.72 cm

B. Pour modifier la taille de votre ceinture, décollez l'extrémité interne du panneau latéral de chaque côté. Réglez le dispositif pour qu'il soit bien ajusté puis fixez à nouveau.

2. PRÉPARATION

A. Placez les tirettes à 2 pouces (5,1 cm) du panneau arrière de l'orthèse. Écartez les extrémités de la ceinture en vous assurant qu'elle est complètement étirée.

(POPPLE 637 LSO UNIQUEMENT)

B. Lorsque l'orthèse est complètement déployée, placez un panneau latéral sur la ligne médiane de chaque côté de l'orthèse. Appuyez pour fixer l'orthèse.
C. Lorsque l'orthèse est bien adaptée au patient, les panneaux latéraux doivent s'adapter à la ligne médiane du patient.

3. UTILISATION

A. Enfilez l'orthèse bien ouverte en vous assurant que le panneau dorsal soit centré et correctement placé au bas du dos.
B. Serrez bien l'orthèse autour de l'abdomen, le côté droit chevauchant le côté gauche.

4. SERRAGE

A. Faites glisser vos pouces à travers les trous dans les tirettes. Éloignez-les de votre corps. Ajustez la compression selon les besoins.
B. Une fois serré, fixez les tirettes à nouveau sur l'orthèse.

5. RÉGLAGE

A. Ajustez le support en desserrant ou en resserrant les tirettes selon vos besoins.

6. RETIRER L'ORTHÈSE

A. Placez les tirettes sur le côté de l'orthèse.
B. Décollez le côté droit de l'orthèse du côté gauche de l'orthèse.
C. Étendez complètement les bras de l'orthèse en prévision de la prochaine utilisation.

7. MODIFICATION DE LA LONGUEUR DES SANGLES

A. Les sangles de compression peuvent être allongées ou raccourcies. Décollez l'extrémité du crochet et ajustez la longueur avant de la remettre en place.

8. OPTIONS DE MODIFICATIONS

A. Ce produit peut être considérablement modifié par une personne expérimentée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet www.aspenmp.com/education/product-modifications.

UTILISATION PRÉVUE

L'utilisation prévue est d'assurer la restriction des mouvements et la stabilité de la colonne lombo-sacrée.

INDICATIONS

Douleurs lombaires, sciatique, douleurs de la ceinture pelvienne, discopathie dégénérative, hernie discale ou disque bombé, spondylolyse, spondylolisthésis, sténose vertébrale, spondylose (arthrose/maladie dégénérative des articulations).

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité ou allergies à l'un des matériaux utilisés pour fabriquer l'orthèse. Gonflement du tissu lymphatique causé par des troubles circulatoires. Patients non autorisés à porter une orthèse pour raisons médicales.

PRÉCAUTIONS

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. Une formation appropriée à l'utilisation de cet appareil doit avoir lieu avant son application. Ces instructions ne sont que des lignes directrices et ne constituent pas des recommandations médicales. Si vous souffrez d'un problème médical grave, nous vous conseillons vivement de consulter un professionnel de la santé agréé avant d'utiliser ce produit. Un réglage adéquat est nécessaire pour que ce produit soit efficace. Dans certaines circonstances, ce produit peut être prescrit par un médecin. Veuillez consulter la garantie limitée pour de plus amples informations.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Laver à la main uniquement à 30 °C ; Laver avec un détergent doux ; Sécher à l'air libre ; Ne pas utiliser d'eau de Javel ou d'autres produits chimiques.

MATÉRIAUX

Acétal, nylon, HDPE, polyester, élasthanne, polyacrylate, polyuréthane, polyéthylène, caoutchouc, élasthanne.

PAS FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

TRAITEMENT POUR ÉLIMINATION

Le produit peut être éliminé en toute sécurité conformément aux lois locales.

SIGNALEMENT

Veuillez signaler tout incident grave impliquant l'utilisation de ce dispositif à la fois à l'autorité compétente de votre État et au fabricant (figurant dans la liste présente dans ce document).

GARANTIE LIMITÉE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantit à l'utilisateur qui est l'acheteur d'origine de ce produit qu'il est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. La seule obligation d'Aspen Medical Products, LLC en cas de rupture de garantie est de réparer ou de remplacer le produit ou la (les) pièce(s) défectueuse(s).

Dans les cas suivants, Aspen Medical Products, LLC n'aura aucune obligation au titre de cette garantie limitée :
(a) Le produit n'a pas été acheté auprès d'Aspen Medical Products, LLC ou via ses canaux de distribution autorisés ;
(b) Le produit est modifié ;
(c) Toute pièce non fournie par Aspen Medical Products, LLC a été insérée dans le produit ; ou
(d) Le produit n'est pas utilisé conformément au mode d'emploi d'Aspen Medical Products, LLC.

CE QUI PRÉCÈDE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE DÉFAUT DE SERVICE OU DE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC N'EST PAS RESPONSABLE, EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET TOUTES LES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITÉS DE LA PART DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POUR LES DOMMAGES RÉSULTANT DE OU LIÉS À L'UTILISATION DES PRODUITS, QUI SONT PAR LA PRÉSENTE DÉCLINÉS ET EXCLUS PAR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un endroit à l'autre.

Une liste des distributeurs autorisés dans votre région est disponible sur demande.

NETHERLANDS

1. MAATVOERING EN AANPASSING

A. Bepaal de juiste bracemaat door de omvang van uw taille te meten.

MAATSCHEMA		
MAAT	OMTREK	
Klein	31 - 37 inch	78.74 cm - 93.98 cm
Middelgroot	36 - 48 inch	91.44 cm - 121.92 cm
Groot	47 - 68 inch	119.38 cm - 172.72 cm

B. Om de maat van de riem te veranderen, pelt u aan beide kanten het uiteinde van het binnenste zijpaneel omhoog. Zorg dat het goed past en maak het opnieuw vast.

2. VOORBEREIDING

A. Plaats de treklipjes op 2 inches (5,1 cm) afstand van het achterpaneel van de beugel. Trek de uiteinden van de band van elkaar af en zorg ervoor dat deze volledig is uitgeschoven.

(ALLEEN POPPLE 637 LSO)

B. Wanneer de brace volledig is uitgeschoven, plaatst u één lateraal paneel op de middenlijn van elk zijpaneel van de brace. Druk naar beneden om de beugel vast te zetten.
C. Wanneer de brace goed op de patiënt is afgestemd, moeten de zijpanelen op de middenlijn van de patiënt passen.

3. SOLLICITATIE

A. Breng de volledig uitgeschoven beugel aan en zorg ervoor dat het achterpaneel gecentreerd is en laag op de rug ligt.
B. Breng de beugel strak aan rond het abdomen en zorg ervoor dat de rechterkant de linkerkant overlapt.

4. AANSPANNEN

A. Steek uw duimen door de gaten in de treklipjes. Trek het weg van uw lichaam. Pas de compressie indien nodig aan.
B. Nadat u de beugel hebt vastgedraaid, trekt u de treklipjes weer vast aan de beugel.

5. AANPASSING

A. Pas de ondersteuning aan door de treklipjes indien nodig losser of strakker te draaien.

6. BRACE VERWIJDEREN

A. Plaats de treklipjes aan de zijkant van de beugel.
B. Trek de rechterkant van de beugel los van de linkerkant van de beugel.
C. Strek de armen van de brace volledig uit ter voorbereiding op het volgende gebruik.

7. WIJZIGING VAN DE BANDLENGTE

A. Compressiebanden kunnen langer of korter gemaakt worden. Trek het uiteinde van de haak omhoog en pas de lengte aan voordat u de haak terugplaatst.

8. AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN

A. Dit product kan grotendeels worden aangepast door een expert. Ga voor meer informatie naar wwww.aspenmp.com/education/product-modifications.

BEOOGD GEBRUIK

Het beoogde gebruik is het bieden van bewegingsbeperking en stabiliteit van de thoracaal-lumbaal-sacrale wervelkolom.

INDICATIES

Lage rugpijn, ischias, bekkenpijn, degeneratieve schijfziekte, uitpuilende schijf of hernia, spondylolyse, spondylolisthesis, spinale stenose, spondylose (Artrose/Degeneratieve gewrichtsziekte).

CONTRA-INDICATIES

Overgevoeligheid of allergie voor een van de materialen waarvan de beugel is gemaakt. Zwelling van het lymfeweefsel veroorzaakt door stoornissen in de bloedsomloop. Patiënten die volgens medische instructies geen beugel mogen dragen.

VOORZORGSMAATREGELEN

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. Oefening in het gebruik van dit instrument dient plaats te vinden voordat het wordt toegepast. Deze aanwijzingen zijn slechts richtlijnen en worden niet als medische adviezen verstrekt. Als u lijdt aan een ernstige medische aandoening, raden wij u ten zeerste aan om een erkende zorgverlener te raadplegen alvorens dit product te gebruiken. De juiste afstelling is nodig voor de effectiviteit van dit product. Onder bepaalde omstandigheden kan dit product worden voorgeschreven door een arts. Zie de beperkte garantie voor meer informatie.

VERZORGING

Alleen met de hand wassen op 30° C; Was met een mild wasmiddel; Aan de lucht drogen; Gebruik geen bleekmiddel of andere chemicaliën.

MATERIALEN

Acetaal, nylon, HDPE, polyester, elastaan, polyacrylaat, polyurethaan, polyethyleen, rubber, spandex.

NIET GEMAAKT MET NATUURLIJKE RUBBER LATEX.

AFVALVERWIJDERING

Product mag veilig worden verwijderd volgens de lokale wetgeving.

RAPPORTERING

Meld elk ernstig incident met betrekking tot het gebruik van dit instrument aan zowel de Bevoegde Autoriteit in uw staat als de fabrikant (op dit document vermeld).

BEPERKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garandeert de gebruiker die dit originele product koopt dat het geen materiaal- en fabricagefouten bevat. Het is de volledige verplichting van Aspen Medical Products, LLC om in geval van een tekortkoming in de garantie het defecte product of onderdeel(en) te repareren of te vervangen.

Aspen Medical Products, LLC heeft geen enkele verplichting onder deze beperkte garantie in het geval:
(a) Het product niet gekocht is bij Aspen Medical Products, LLC of via de geautoriseerde distributiekanalen;
(b) Het product aangepast wordt;
(c) Onderdelen in het product worden geplaatst die niet door Aspen Medical Products, LLC worden geleverd; of
(d) Het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van Aspen Medical Products, LLC.

HET VOORGAANDE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE VOOR HET NIET FUNCTIONEREN VAN OF DEFECT AAN HET PRODUCT. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC IS NIET AANSPRAKELIJK OP GROND VAN DEZE OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VOOR DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN ALLE VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID VAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, DIE HIERBIJ WORDEN AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN DOOR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben die per locatie verschillen.

U kunt een lijst van geautoriseerde distributeurs bij u in de buurt opvragen.

ČEŠTINA

1. VELIKOST A ÚPRAVA

A. Zvolte vhodnou velikost ortézy změřením obvodu pasu a boků.

TABULKA VELIKOSTÍ		
VELIKOST	OBVOD	
Malé	31 - 37 palců	78.74 cm - 93.98 cm
Střední	36 - 48 palců	91.44 cm - 121.92 cm
Velké	47 - 68 palců	119.38 cm - 172.72 cm

B. Chcete-li změnit velikost pásu, odloupněte vnitřní konec bočního panelu na každé straně. Upravte pro správné usazení a znovu připojte.

2. PŘÍPRAVA

A. Umístěte úchyty pro zatažení 2 palců (5,1 cm) od zadního panelu ortézy. Konce ortézy odtáhněte od sebe a zajistěte, aby byla plně vysunuta.

(POUZE POPPLE 637 LSO)

B. Při plně natažené ortéze umístěte jeden boční panel na středovou čáru pro oba boční panely ortézy. Stlačte a ortézu zajistěte.
C. Pokud je ortéza správně nasazena na pacientovi, boční panely by měly zapadat do střední linie pacienta.

3. POUŽITÍ

A. Nasaďte zcela vysunutou ortézu a ujistěte se, že je zadní panel vycentrován a nízko vzadu.
B. Nasaďte ortézu pevně kolem břicha, tak aby se pravá strana překrývala s levou.

4. DOTAŽENÍ

A. Protáhněte palce otvory v poutkách. Tahejte směrem od těla. Podle potřeby upravte stažení.
B. Po utažení zajistěte poutka zpět na výztuhu.

5. NASTAVENÍ

A. Upravte podpěru povolením nebo utažením úchytů podle potřeby.

6. ODSTRANĚNÍ ORTÉZY

A. Tažné zarážky umístěte na boční stranu výztuhy.
B. Odlepte pravou stranu ortézy od levé strany rovnátka.
C. Před dalším použitím zcela natáhněte ramena ortézy.

7. ÚPRAVA DÉLKY PÁSKU

A. Kompresní popruhy lze vyrobit delší nebo kratší. Odlepte konec háčku a upravte délku, než jej zasunete zpět.

8. MOŽNOSTI ÚPRAV

A. Tento produkt může být podstatně upraven osobou s odbornými znalostmi. Další informace najdete na adrese www.aspenmp.com/education/product-modifications.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Zajistit omezení pohybu a stabilitu hrudně-bederně-křížové páteře.

INDIKACE

Bolest dolní části zad, ischias, bolest pánevního pletence, degenerativní onemocnění ploténky, vyklenutá nebo herniovaná ploténka, spondylolýza, spondylolistéza, spinální stenóza, spondylóza (osteoartritida/degenerativní onemocnění kloubů).

KONTRAINDIKACE

Přecitlivělost nebo alergie na některý z materiálů, z nichž je ortéza vyrobena. Otok lymfatické tkáně způsobený poruchami oběhu. Pacienti, kteří nesmí nosit ortézu na základě lékařských pokynů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE POKYNY. Před použitím tohoto zařízení je třeba zajistit řádné proškolení. Tyto pokyny jsou pouze pokyny a nejsou nabízeny jako lékařská doporučení. Pokud trpíte vážným zdravotním stavem, důrazně doporučujeme, abyste se před použitím tohoto produktu poradili s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Aby byl tento produkt účinný, je nutné jeho správné nastavení. Za určitých okolností může tento produkt předepsat lékař. Další informace naleznete v omezené záruce.

POKYNY K PÉČI

Ruční praní pouze při 30°C; Vyperte v jemném pracím prostředku; Sušte na vzduchu; Nepoužívejte bělidlo ani jiné chemické látky.

MATERIÁLY

Acetal, nylon, HDPE, polyester, elastan, polyakrylát, polyuretan, polyethylen, guma, spandex.

NENÍ VYROBENO Z LATEXU Z PŘÍRODNÍHO KAUČUKU.

LIKVIDACE

Produkt může být bezpečně zlikvidován v souladu s místními zákony.

HLÁŠENÍ

Veškeré závažné nehody týkající se používání tohoto zařízení oznamte jak příslušnému orgánu ve vašem státu, tak výrobci (uvedenému v tomto dokumentu).

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 zaručuje uživateli, který původně zakoupil tento produkt, že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Výhradní povinností společnosti Aspen Medical Products, LLC v případě porušení záruky je opravit nebo vyměnit vadný produkt nebo část (součásti).

Společnost Aspen Medical Products, LLC nebude mít podle této omezené záruky žádnou povinnost v případě, že:
(a) Produkt nebyl zakoupen od společnosti Aspen Medical Products, LLC nebo prostřednictvím jejích autorizovaných distribučních kanálů;
(b) Produkt je pozměněn;
(c) Do produktu jsou vloženy jakékoli součásti, které nedodává společnost Aspen Medical Products, LLC; nebo
(d) Produkt se nepoužívá v souladu s pokyny k použití společnosti Aspen Medical Products, LLC.

VÝŠE UVEDENÉ JE JEDINÝM A VÝLUČNÝM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY V PŘÍPADĚ PORUCHY NEBO ZÁVADY PRODUKTU. SPOLEČNOST ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NENESE ODPOVĚDNOST PODLE TÉTO ANI PODLE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO POUŽITÍ, A VEŠKERÉ ZÁVAZKY NEBO ZÁVAZKY ZE STRANY ZDRAVOTNICKÝCH PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI ASPEN A ZA ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM PRODUKTŮ, KTERÉ JSOU TÍMTO SPOLEČNOSTÍ ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ODMÍTNUTY A VYLOUČENY.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít další práva, která se liší od místa k místu.

Seznam autorizovaných distributorů ve vaší oblasti je k dispozici na vyžádání.

DANSK

1. STØRRELSER OG JUSTERING
A. Vælg den korrekte bøjlestørrelse ved at måle rundt om taljen og hofterne.

STØRRELSE GUIDE		
STØRRELSE	**OMKREDS**	
Small	31 - 37 tommer	78.74 cm - 93.98 cm
Medium	36 - 48 tommer	91.44 cm - 121.92 cm
Large	47 - 68 tommer	119.38 cm - 172.72 cm

B. Træk den indvendige ende af sidepanelet op på hver side for at ændre bæltestørrelsen. Juster til den ønkede længde, og fastgør den derefter igen.

2. FORBEREDELSE
A. Placer trækfligene 2 tommer (5,1 cm) fra bøjlens bagpanel. Træk bælteenderne væk fra hinanden, og sørg for, at det er helt udstrakt.

(KUN FOR POPPLE 637 LSO)
B. Med bøjlen helt udstrakt placeres det ene sidepanel på midten af hvert sidepanel på bøjlen. Tryk ned for at fastgøre til bøjle.
C. Når bøjlen er korrekt tilpasset patienten, skal sidepanelerne passe til patientens midterlinie.

3. ANVENDELSE
A. Påfør den fuldt udstrakte bøjle, og sørg for, at bagpanelet er centreret og lavt bagpå.
B. Påfør bøjlen tæt omkring maven, den højre side skal overlappe den venstre.

4. STRAMNING
A. Stik tommelfingrene gennem hullerne i trækfligene. Træk væk fra din krop. Juster kompression efter behov.
B. Efter stramning fastgøres trækfligene tilbage på bøjlen.

5. JUSTERING
A. Juster støtten ved at løsne eller stramme trækfligene efter behov.

6. FJERNELSE AF BØJLE
A. Placer trækfligene på siden af bøjlen.
B. Træk den højre side af bøjlen af venstre side af bøjlen.
C. Stræk bøjlearmene helt ud, så den er klar til næste brug.

7. ÆNDRING AF STROPLÆNGDE
A. Kompressionsstropper kan gøres længere eller kortere. Løft krogenden op og juster længden, før du lægger den ned igen.

8. ÆNDRINGSMULIGHEDER
A. Dette produkt kan ændres væsentligt af en fagkyndig person. Du kan finde flere oplysninger på www.aspenmp.com/education/product-modifications.

ANVENDELSESFORMÅL
Anvendelsesformålet er at begrænse bevægelighed og stabilisere lændehvirvelsøjlen.

INDIKATIONER
Lændesmerter, iskias, bækkensmerter, degenerativ discusprolaps, diskusprolaps eller diskusprolaps, spondylolyse, spondylolistese, spinal stenose, spondylose (slidgigt/degenerativ ledsygdom).

KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed eller allergi over for de materialer, bøjlen er fremstillet af. Hævelse af lymfevævet forårsaget af kredsløbsforstyrrelser. Patienter, der ikke må gå med bøjle i henhold til lægens vejledning.

FORHOLDSREGLER
DISSE INSTRUKTIONER SKAL LÆSES FØR BRUG. Korrekt træning i brug af denne enhed skal finde sted, inden den anvendes. Disse anvisninger er kun retningslinjer og skal ikke bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinsk tilstand, er det kraftigt anbefalet at du konsulterer en autoriseret sundhedsperson, inden du bruger dette produkt. En korrekt montering er kræve for at dette produkt skal være effektivt. Under nogle omstændigheder kan dette produkt ordineres af en læge. Se den begrænsede garanti for yderligere information.

PLEJEINSTRUKTIONER
Håndvask kun ved 30 ° C; Vask med en mild rengøringsmiddel; Lufttørring; Brug ikke blegemiddel eller andre kemikalier.

MATERIALER
Acetal, nylon, HDPE, polyester, elastan, polyacrylat, polyuretan, polyethylen, gummi, spandex.

DER ER INTET NATURGUMMILATEX I ENHEDEN.

MED HENSYN TIL BORTSKAFFELSE
Produktet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale love.

MELDINGEN
Venligst rapportér enhver alvorlig hændelse, der involverer brugen af denne enhed til både den kompetente myndighed i din stat og til producenten (angivet i dette dokument).

BEGRÆNSET GARANTI
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, giver garanti over for brugeren, der oprindeligt køber dette produkt, at det er fri for mangler i materiale og udførelse. Den eneste forpligelse Aspen Medical Products, LLC har i tilfælde af misligholdelse af garantien er repareration eller udskiftning af det eller de defekte produkter eller dele.

Aspen Medicinal firmaer, LLC er ikke forpligtet til i henhold til denne begrænsede garanti i tilfælde af:
(a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af de autoriserede distributionskanaler;
(b) Produktet er blevet ændret;
(c) Alle dele, der er sat i produktet og ikke er leveret af Aspen Medical Products, LLCt; eller
(d) Produktet anvendes ikke i overensstemmelse med Aspen Medical Products, LLC brugsvejledning.

DET FOREGÅENDE ER DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR FEJL I SERVICE AF, ELLER OM DER ER DEFEKTER I PRODUKTET. ASPEN MEDICINSKE PRODUKTER, LLC HAR IKKE ANSVARET UNDER DENNE ELLER UNDERFORSTÅENDE GARANTI FOR ALLE DIREKTE, SPECIALE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGENDE SKADER. DENNE GARANTI ER I FORBINDELSE MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKET ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVT GARANTIEN FOR SALGSBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER BRUG, OG ALLE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR PÅ DEN DEL AF ASPEN LÆGEMIDLER, DER BRUGES I FORBINDELSE MED LÆGEMIDLER, ANVENDELSE AF PRODUKTERNE, DER ER FRISKRIVET OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og eventuelle andre rettigheder, dette kan variere fra sted til sted.

En liste over autoriserede distributører i dit område er tilgængelig efter anmodning.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
Α. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος νάρθηκα μετρώντας γύρω από την μέση και τα ισχία.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ		
ΜΕΓΕΘΟΣ	**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**	
ΜΙΚΡΟ	31 - 37 ιντ.	78.74 - 93.98 εκ.
ΜΕΣΑΙΟ	36 - 48 ιντ.	91.44 - 121.92 εκ.
ΜΕΓΑΛΟ	47 - 68 ιντ.	119.38 - 172.72 εκ.

Β. Για να αλλάξετε το μέγεθος της ζώνης, σηκώστε προς τα έξω την εσωτερική άκρη του πλαϊνού φύλλου στην κάθε πλευρά. Προσαρμόστε έτσι ώστε να πετύχετε σωστή εφαρμογή και επανατοποθετήστε.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Α. Τοποθετήστε τα δαχτυλίδια 2 ίντσες (5.1 εκ.) από το πίσω φύλλο του νάρθηκα. Τραβήξτε τις άκρες της ζώνης προς την αντίθετη κατεύθυνση και βεβαιωθείτε πως έχει εκταθεί εντελώς.

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ POPPLE 637 LSO)
Β. Με τον νάρθηκα εντελώς εκτεταμένο, τοποθετήστε ένα πλευρικό φύλλο στην μέση γραμμή στο κάθε πλαϊνό φύλλο του νάρθηκα. Πιέστε προς τα κάτω για να ασφαλίσετε στον νάρθηκα.
C. Όταν ο νάρθηκας έχει εφαρμοστεί κανονικά στον ασθενή, τα πλευρικά φύλλα θα πρέπει να εφαρμόζουν στην μέση γραμμή του ασθενούς.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΉ
Α. Εφαρμόστε τον νάρθηκα στην εντελώς ανοικτή θέση και βεβαιωθείτε ότι το πίσω φύλλο είναι κεντραρισμένο και χαμηλά στην πλάτη.
Β. Εφαρμόστε τον νάρθηκα σφιχτά γύρω από την κοιλιά, με την δεξιά πλευρά να επικαλύπτει την αριστερή.

4. ΣΦΊΞΙΜΟ
Α. Περάστε τους αντίχειρές σας μέσα από τις τρύπες των δαχτυλιδιών. Τραβήξτε μακριά από το σώμα σας. Προσαρμόστε την συμπίεση όσο χρειάζεται.
Β. Όταν είναι σφιχτό, ασφαλίστε τα δαχτυλίδια πάλι επάνω στον νάρθηκα.

5. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ
Α. Ρυθμίστε την υποστήριξη χαλαρώνοντας ή σφίγγοντας τα δαχτυλίδια όπως χρειάζεται.

6. ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΝΆΡΘΗΚΑ
Α. Τοποθετήστε τα δαχτυλίδια στο πλάι του νάρθηκα.
Β. Ξεκολλήστε τη δεξιά πλευρά του νάρθηκα από την αριστερή πλευρά του νάρθηκα.
C. Εκτείνετε πλήρως τους βραχίονες του νάρθηκα για να προετοιμαστείτε για την επόμενη χρήση.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ
Α. Οι ιμάντες συμπίεσης μπορούν να γίνουν μακρύτεροι ή κοντύτεροι. Ξεκολλήστε το άκρο του αγκίστρου και ρυθμίστε το μήκος πριν το τοποθετήσετε ξανά.

8. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α. Το προϊόν αυτό μπορεί να τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από κάποιο άτομο με εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.aspenmp.com/education/product-modifications.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η χρήση για την οποία προορίζεται είναι ο περιορισμός της κίνησης και η σταθεροποίηση της οσφυϊκής μοίρας-ιερού οστού της σπονδυλικής στήλης.

ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ
Πόνος στη μέση, Ισχιαλγία, Πόνος στη πυελική ζώνη, Εκφυλιστική δισκοπάθεια, Διόγκωση ή κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, Σπονδυλόλυση, Σπονδυλολίσθηση, Στένωση σπονδυλικής στήλης, Σπονδύλωση (Οστεοαρθρίτιδα/Εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων).

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Υπερευαισθησία ή αλλεργίες σε κάποιο από τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο νάρθηκας. Οίδημα του λυμφατικού ιστού προκαλούμενο από κυκλοφορικές διαταραχές. Ασθενείς που δεν τους επιτρέπεται να φορούν νάρθηκα σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. Θα πρέπει να προηγείται σωστή εκπαίδευση στην χρήση αυτής της συσκευής πριν την χρήση της. Οι οδηγίες αυτές αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές μόνο και δεν προσφέρονται ως ιατρικές συστάσεις. Εάν πάσχετε από κάποια σοβαρή ιατρική κατάσταση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον κατάλληλο επαγγελματία στον χώρο της υγείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Για να είναι αποτελεσματικό το προϊόν αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το προϊόν αυτό μπορεί να συνταγογραφηθεί από γιατρό. Δείτε την περιορισμένη εγγύηση για περεταίρω πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Πλύσιμο με το χέρι μόνο στους 30° C. Πλένετε με ήπιο καθαριστικό. Στεγνώστε στον αέρα. Μην κάνετε χρήση χλωρίου ή άλλων χημικών.

ΥΛΙΚΑ
Ακετάλη, Νάιλον, HDPE, Πολυεστέρας, Ελαστάνη, Πολυακρυλικό, Πολυουρεθάνη, Πολυαιθυλένιο, Καουτσούκ, Σπάντεξ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΛΑΤΕΞ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Το προϊόν μπορεί να απορριφθεί με ασφάλεια σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σχετικό με την χρήση της συσκευής αυτής στην αρμόδια αρχή της χώρας σας και στον κατασκευαστή (αναγράφεται στο παρόν έγγραφο).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, εγγυάται προς τον χρήστη που έχει κάνει την αρχική αγορά του παρόντος προϊόντος πως δεν έχει ελαττώματα στα υλικά και την ποιότητα κατασκευής. Η μόνη υποχρέωση της Aspen Medical Products, LLC στην περίπτωση της μη ορθής εγγύησης θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή εξαρτήματος(-ων) του.

Η Aspen Medical Products, LLC δεν φέρει καμία υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση στην περίπτωση που:
(α) Το προϊόν δεν έχει αγοραστεί από την Aspen Medical Products, LLC ή μέσω των εξουσιοδοτημένων της προμηθευτικών οδών.
(β) Το προϊόν έχει υποστεί μετατροπές.
(γ) Εξαρτήματα τα οποία δεν έχει προμηθεύσει η Aspen Medical Products, LLC έχουν ενσωματωθεί στο προϊόν, ή
(δ) Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης της Aspen Medical Products, LLC.

ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ή ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ, Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ASPEN ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ASPEN, LLC.

Η παρούσα εγγύηση σας προσφέρει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα που διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.

Κατάλογος εξουσιοδοτημένων προμηθευτών στην περιοχή σας είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος.

NORSK

1. STØRRELSER OG JUSTERING
A. Velg en ryggstøtte i passende størrelse ved å måle rundt midjen og hoftene.

TILPASSINGSVEILEDNING		
STØRRELSE	**OMKRETS**	
Liten	31 - 37 tommer	78.74 cm - 93.98 cm
Medium	36 - 48 tommer	91.44 cm - 121.92 cm
Stor	47 - 68 tommer	119.38 cm - 172.72 cm

B. For å endre størrelsen på stroppen, trekk opp den innvendige enden av sidepanelet på hver side. Juster til riktig passform, og fest på nytt.

2. FORBEREDELSER
A. Plasser trekkflikene 2 tommer (5,1 cm) fra bakpanelet på ryggstøtten. Trekk endene av stroppen bort fra hverandre, og sørg for at den er helt strukket ut.

(KUN POPPLE 637 LSO)
B. Med ryggstøtten helt utvidet, plasser et sidepanel på senterlinjen på hvert sidepanel av ryggstøtten. Trykk ned for å feste det til ryggstøtten.
C. Når ryggstøtten sitter som den skal på pasienten, bør sidepanelene passe ved pasientens senterlinje.

3. PÅFØRING
A. Påfør den fullt forlengde ryggstøtten og sørg for at bakpanelet er sentrert og lav på ryggen.
B. Påfør ryggstøtten rundt magen med høyre side overlappende venstre side.

4. INNSTRAMMING
A. Før tomlene dine gjennom hullene i trekkflikene. Trekk bort fra kroppen din. Stram til etter behov.
B. Når de er strammet, fest trekkflikene tilbake på ryggstøtten.

5. JUSTERING
A. Juster støtten ved å løsne eller stramme trekkflikene etter behov.

6. FJERNING AV RYGGSTØTTEN
A. Plasser trekklikene på siden av ryggstøtten.
B. Dra av høyre side av ryggstøtten fra venstre side.
C. Strekk armene på ryggstøtten helt ut som forberedelse til neste bruk.

7. ENDRING AV STROPPLENGDE
A. Kompresjonsstroppene kan gjøres lengre eller kortere. Dra av krokenden og juster lengden før du legger den ned igjen.

8. MODIFISERINGSALTERNATIVER
A. Dette produktet kan endres vesentlig av en person med ekspertise. For mer informasjon, besøk www.aspenmp.com/education/product-modifications.

TILTENKT BRUK
Den er ment å brukes for å gi bevegelsesbegrensning og stabilitet av thorakal-lumbal-sakral ryggsøylen.

INDIKASJONER
Korsryggsmerter, isjias, bekkensmerter, degenerativ skivesykdom, bulende eller herniert skive, spondylolyse, spondylolistese, spinalstenose, spondylose (slitasjegikt/degenerativ leddsykdom).

KONTRAINDIKASJONER
Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som ryggstøtten er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke har lov til å bruke en støtte i henhold til medisinske instruksjoner.

FORHOLDSREGLER
LES INSTRUKSJONER FØR BRUK. Passende opplæring i bruken av denne enheten bør finne sted før den tas i bruk. Disse retningslinjene er kun veiledende og tilbys ikke som medisinske anbefalinger. Hvis du lider av en alvorlig medisinsk tilstand, anbefaler vi sterkt at du konsulterer lisensiert helsepersonell før du bruker dette produktet. Riktig passform kreves for at dette produktet skal være effektivt. Under visse omstendigheter, kan dette produktet foreskrives av en lege. Se begrenset garanti for mer informasjon.

PLEIEINSTRUKSJONER
Håndvask kun ved 30 °C; Vask med mildt rengjøringsmiddel; Lufttørk; Ikke bruk blekemiddel eller andre kjemikalier.

MATERIALER
Acetal, nylon, HDPE, polyester, elastan, polyakrylat, polyuretan, polyetylen, gummi, spandex.

IKKE LAGET MED NATURLIG GUMMILATEKS.

AVHENDING
Produktet kan trygt avhendes i samsvar med lokale lover.

RAPPORTERING
Rapporter alvorlige hendelser som invplverer bruk av denne enheten til både kompetent myndighet i din stat og til produsenten (oppført i dette dokumentet).

BEGRENSET GARANTI
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterer til brukeren som opprinnelig kjøper dette produktet at det er fritt for mangler i materiale og utførelse. Den eneste forpliktelsen til Aspen Medical Products, LLC i tilfelle brudd på garantien skal være å garantere eller skifte ut det defekte produktet eller delen(e).

Aspen Medical Products, LLC skal ikke ha noen forpliktelse under denne begrensede garantien dersom:
(a) Produktet ikke ble kjøpt fra Aspen Medical Products, LLC eller gjennom dets autoriserte distribusjonskanaler;
(b) Produktet er endret;
(c) Deler som ikke leveres av Aspen Medical Products, LLC er satt inn i produktet; eller
(d) Produktet ikke brukes i samsvar med bruksanvisningen til Aspen Medical Products LLC.

DET FOREGÅENDE ER DET ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLET FOR SVIKT I SERVICE AV, ELLER MANGEL PÅ, PRODUKTET. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG UNDER DENNE ELLER NOEN IMPLISERT GARANTI FOR NOEN DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL ELLER SPESIFIKK BRUK, OG ALLE FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRA ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV PRODUKTENE, SOM HERVED FRASKRIVES OG EKSKLUDERES AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan ha andre rettigheter som varierer fra sted til sted.

En liste over autoriserte distributører i ditt område er tilgjengelig ved forespørsel.

POLSKI

1. DOPASOWANIE ROZMIARU I REGULACJA
A. Wybrać odpowiedni rozmiar pasa, mierząc obwód w talii.

PRZEWODNIK PO DOBIERANIU ROZMIARU		
ROZMIAR	**OBWÓD**	
S	31 - 37 in	78.74 cm - 93.98 cm
M	36 - 48 in	91.44 cm - 121.92 cm
L	47 - 68 in	119.38 cm - 172.72 cm

B. Aby zmienić rozmiar paska, należy odkleić wewnętrzny koniec panelu bocznego po każdej stronie. Dopasować i ponownie zamocować.

2. PRZYGOTOWANIE
A. Umieścić zakładki 2 cale (5,1 cm) od tylnego panelu ortezy. Końce paska odciągnąć od siebie, zapewniając pełne rozłożenie.

(TYLKO POPPLE 637 LSO)
B. Przy całkowicie rozłożonym stabilizatorze umieścić jeden panel boczny na linii środkowej na każdym panelu bocznym stabilizatora. Docisnąć, żeby zamocować.
C. Gdy orteza jest prawidłowo dopasowana do pacjenta, boczne panele powinny przylegać do środkowej linii ciała pacjenta.

3. ZASTOSOWANIE
A. Nałożyć całkowicie rozłożony stabilizator, upewniając się, że panel tylny jest wyśrodkowany i znajduje się nisko na plecach.
B. Założyć stabilizator ciasno wokół brzucha, prawą stroną nachodząc na lewą.

4. ZACISKANIE
A. Wsunąć kciuki przez otwory w zakładkach ściągających. Odciągnąć od siebie. Wyregulować dociągnięcie według potrzeb.
B. Po dociągnięciu należy zamocować zakładki na ortezie.

5. REGULACJA
A. W razie potrzeby wyregulować podparcie, poluzowując lub zaciskając zakładki.

6. ZDEJMOWANIE ORTEZY
A. Umieścić zaczepy po bokach ortezy.
B. Odkleić prawą stronę ortezy od jej lewej strony.
C. W pełni rozciągnąć ramiona ortezy, żeby przygotować ją do następnego użycia.

7. MODYFIKACJA DŁUGOŚCI PASKA
A. Paski kompresyjne można wydłużyć lub skrócić. Odchylić haczyk i wyregulować długość zanim ponownie umieści się haczyk na miejscu.

8. MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJI
A. Ten produkt może być modyfikowany przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.aspenmp.com/education/product-modifications.

PRZEZNACZENIE
Produkt jest przeznaczony do ograniczania ruchomości i stabilizacji odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

WSKAZANIA
Ból dolnej części pleców, rwa kulszowa, ból obręczy biodrowej, choroba zwyrodnieniowa krążka międzykręgowego, wybrzuszenie lub przepuklina dysku, (kregoszczelina) spondyloliza, kręgozmyk (spondylolisteza), zwężenie kanału kręgowego, spondyloza (osteoartroza/choroba zwyrodnieniowa stawów).

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość lub alergia na którykolwiek z materiałów, z których wykonano ortezę. Obrzęk tkanki limfatycznej spowodowany zaburzeniami krążenia. Pacjenci, którzy zgodnie z zaleceniami lekarza nie mogą nosić ortezy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ ULOTKĘ. Przed rozpoczęciem stosowania wyrobu u pacjentów należy przejść odpowiednie szkolenie z zakresu jego obsługi. Niniejsze instrukcje to jedynie wskazówki i nie należy ich traktować jak zalecenia od lekarza. Jeśli pacjent cierpi na poważną chorobę, zdecydowanie zalecamy, aby przed użyciem tego produktu skonsultować się z uprawnionym pracownikiem służby zdrowia. Aby ten produkt był skuteczny, konieczne jest jego właściwe dopasowanie. W pewnych okolicznościach produkt ten może zostać przepisany przez lekarza. Więcej informacji można znaleźć w ograniczonej gwarancji.

INSTRUKCJE KONSERWACJI
Prać wyłącznie ręcznie w temperaturze 30°C; Stosować delikatne środki piorące; Suszyć na powietrzu; Nie stosować wybielacza ani innych środków chemicznych.

MATERIAŁY
Acetal, nylon, HDPE, poliester, elastan, poliakrylan, poliuretan, polietylen, guma, spandex.

NIE WYKONANO Z NATURALNEGO LATEKSU.

UTYLIZACJA
Produkt może być bezpiecznie utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów związanych z użytkowaniem tego urządzenia zarówno właściwym władzom stanowym, jak i producentowi (wymienionemu w niniejszym dokumencie).

OGRANICZONA GWARANCJA
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, gwarantuje użytkownikowi, który zakupił oryginalny produkt, że jest on wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Jedynym obowiązkiem firmy Aspen Medical Products, LLC w przypadku naruszenia gwarancji jest naprawa lub wymiana wadliwego produktu lub jego części.

Firma Aspen Medical Products, LLC nie ma żadnych zobowiązań w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji w przypadku, gdy:
(a) Produkt nie został zakupiony w firmie Aspen Medical Products, LLC ani poprzez autoryzowane kanały dystrybucji;
(b) Produkt został zmodyfikowany;
(c) Do produktu wmontowano elementy, które nie zostały dostarczone przez Aspen Medical Products, LLC lub
(d) Produkt nie jest stosowany zgodnie z instrukcjami użytkowania firmy Aspen Medical Products, LLC.

POWYŻSZE JEST JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA LUB WADY PRODUKTU. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W RAMACH NINIEJSZEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY. NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, ORAZ WSZELKIE OBOWIĄZKI LUB ZOBOWIĄZANIA ZE STRONY ASPEN MEDICAL PRODUCTS ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM PRODUKTÓW, KTÓRE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE PRZEZ ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Niniejsza gwarancja przyznaje nabywcy określone prawa. Mogą też istnieć inne prawa, które różnią się w zależności od lokalizacji.

Lista autoryzowanych dystrybutorów z okolicy jest dostępna na żądanie.

SUOMI

1. MITOITUS JA SÄÄTÖ
A. Valitse sopiva tuen koko mittaamalla vyötärön ympäriltä.

MITOITUSOPAS		
KOKO	**YMPÄRYSMITTA**	
Pieni	31 - 37 in	78.74 cm - 93.98 cm
Keskikoinen	36 - 48 in	91.44 cm - 121.92 cm
Suuri	47 - 68 in	119.38 cm - 172.72 cm

B. Jos haluat muuttaa vyön kokoa, irrota sivupaneelin sisäpuoli ylöspäin kummaltakin puolelta. Säädä sopivaksi ja kiinnitä uudelleen.

2. VALMISTELU
A. Aseta vetokielekkeet 2 tuuman (5,1 cm) etäisyydelle tuen takapaneelista. Vedä hihnan päät irti toisistaan varmistaen, että hihna on täysin ulosvedetty.

(VAIN POPPLE 637 LSO)
B. Tuki täysin avattuna, aseta yksi sivupaneeli keskiviivalle tuen kummallekin sivupaneelille. Paina alaspäin kiinnittääksesi tukeen.
C. Kun tuki istuu oikein potilaalle, sivupaneelien tulisi olla potilaan keskilinjalla.

3. HAKEMUS
A. Aseta täysin ulosvedetty tuki ja varmista, että takapaneeli on keskitetty ja alhaalla selässä.
B. Aseta tuki tukemaan vatsaa siten, että oikea puoli on päällekkäin vasemman kanssa.

4. KIRISTÄMINEN
A. Työnnä peukalosi vetokielekkeiden reikien läpi. Vedä poispäin kehotasi. Säädä kompressiota tarpeen mukaan.
B. Kun olet kiristänyt, kiinnitä vetokielekkeet takaisin alaspäin tukeen.

5. SÄÄTÖ
A. Säädä tukea löysäämällä tai kiristämällä vetokielekkeitä tarpeen mukaan.

6. TUEN POISTO
A. Aseta vetokielekkeet tuen sivulle.
B. Kuori tuen oikea puoli tuen vasemmalta puolelta.
C. Levitä tuen varret kokonaan ulos seuraavaa käyttöä varten.

7. REMMIN PITUUDEN MUUTOS
A. Kompressioremmejä voidaan pidentää tai lyhentää. Kuori koukun pää ylös ja säädä pituus ennen kuin asetat sen takaisin alas.

8. MUOKKAUSVAIHTOEHDOT
A. Asiantunteva henkilö voi muokata tätä tuotetta huomattavasti. Lue lisää osoitteessa www.aspenmp.com/education/product-modifications.

KÄYTTÖTARKOITUS
Tarkoituksena on rajoittaa lannerangan ja selkärangan liikettä ja vakauttaa selkäranka.

KÄYTTÖTARKOITUKSET
Alaselkäkipu, iskias, lantionpohjan kipu, degeneratiivinen välilevysairaus, pullistuma tai välilevytyrä, spondylolyysi, spondylolisteesi, selkärangan ahtauma, spondyloosi (nivelrikko/degeneratiivinen nivelsairaus).

EI SOVELLU
Yliherkkyys tai allergia mille tahansa materiaalille, josta tukivarsi on valmistettu. Verenkiertohäiriöiden aiheuttama imukudoksen turvotus. Potilaat, jotka eivät saa käyttää tukea lääkärin ohjeiden mukaisesti.

VAROTOIMENPITEET
LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. Tämän laitteen käytön harjoittelun tulisi tapahtua asianmukaisesti ennen laitteen asetusta. Nämä ohjeet ovat vain viitteellisiä, eikä niitä tarjota lääketieteellisinä suosituksina. Jos kärsit vakavasta sairaudesta, suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun terveydenhuollon ammattilaiseen ennen tämän tuotteen käyttöä. Oikea sovitus vaaditaan tuotteen tehokkuuden takaamiseksi. Joissakin olosuhteissa lääkäri voi määrätä tämän tuotteen. Katso lisätietoja rajoitetusta takuusta.

HOITO-OHJEET
Käsinpesu vain 30° C; pesu miedolla pesuaineella; ilmakuivaus; älä käytä valkaisuainetta tai muita kemikaaleja.

MATERIAALIT
Asetaali, nailon, HDPE, polyesteri, elastaani, polyakrylaatti, polyuretaani, polyeteeni, kumi, spandex.

EI VALMISTETTU LUONNONKUMILATEKSISTA.

HÄVITTÄMINEN
Tuote voidaan hävittää turvallisesti paikallisten lakien mukaisesti.

RAPORTOINTI
Ilmoita tämän laitteen käyttöön liittyvistä vakavista tapahtumista sekä osavaltiosi toimivaltaiselle viranomaiselle että valmistajalle (lueteltu tässä asiakirjassa).

RAJOITETTU TAKUU
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, takaa käyttäjälle, joka alun perin ostaa tämän tuotteen, ettei siinä ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Aspen Medical Products, LLC:n ainoa velvollisuus takuun rikkomisen yhteydessä on korjata tai vaihtaa viallinen tuote tai osa(t).

Aspen Medical Products, LLC:llä ei ole tämän rajoitetun takuun mukaisia velvoitteita, jos:
(a) Tuotetta ei ostettu Aspen Medical Products, LLC:ltä tai sen valtuutettujen jakelukanavien kautta;
(b) Tuotetta on muunnettu;
(c) Mikä tahansa osa, joita Aspen Medical Products, LLC ei ole toimittanut, liitetään tuotteeseen; tai
(d) Tuotetta ei käytetä Aspen Medical Products, LLC:n Käyttöohjeiden mukaisesti.

EDELTÄVÄ ON AINOA JA YKSINOMAINEN KORVAUSVAATIMUS PUUTTEESEEN TAI VIRHEESEEN TUOTTEEN PALVELUSSA TAI TUOTTEESSA. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC EI OLE VASTUUSSA TÄMÄN TAKUUN TAI IMPLISIITTISEN TAKUUN MISTÄÄN SUORISTA, ERITYISISTÄ, TAPAHTUMISTA TAI SITÄ SEURANNEISTA VAHINGOISTA. TÄMÄ TAKUU KOSKEE KAIKKIA MUITA TAKUITA, ILMOITETTUJA TAI IMPLISIITTISIÄ, MUKAAN LUKIEN TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN TAI KÄYTTÖÖN, JA KAIKKI ASPEN-LÄÄKEVALMISTEIDEN VELVOLLISUUDET TAI VASTUUT VAHINGOILLE, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ TAI LIITTYVÄT TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN, MISTÄ ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC TÄMÄN JÄLKEEN SANOUTUU IRTI JA SULKEE POIS.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat alueittain.

Luettelo valtuutetuista jakelijoista alueellasi on saatavana pyynnöstä.

SVENSKA

1. STORLEK OCH JUSTERING
A. Välj rätt storlek på stödet genom att mäta runt midjan.

STORLEKSGUIDE		
STORLEK	**OMKRETS**	
Small	31 - 37 in	78.74 cm - 93.98 cm
Medium	36 - 48 in	91.44 cm - 121.92 cm
Large	47 - 68 in	119.38 cm - 172.72 cm

B. För att ändra storleken på bältet, dra upp den inre änden av sidopanelen på varje sida. Justera till rätt passform och fäst tillbaka.

2. FÖRBEREDELSE
A. Placera dragflikarna 2 tum (5,1 cm) från ryggpanelen på stödet. Dra isär bältets ändar och se till att det är helt utdraget.

(ENDAST POPPLE 637 LSO)
B. Med stödet fullt utsträckt, placera en sidopanel på mittlinjen av varje sidopanel på stödet. Tryck ner för att fästa på stödet.
C. När stödet är korrekt anpassat till patienten ska sidopanelerna passa patientens mittlinje.

3. APPLIKATION
A. Applicera det helt utdragna stödet och se till att bakpanelen är centrerad och sitter lågt på ryggen.
B. Applicera stödet för att stödja buken, där höger sida överlappar vänster.

4. ÅTDRAGNING
A. Dra tummarna genom hålen i dragflikarna. Dra bort från kroppen. Justera kompressionen efter behov.
B. När du har dragit åt, fäst dragflikarna igen på stödet.

5. JUSTERING
A. Justera stödet genom att lossa eller dra åt dragflikarna vid behov.

6. BORTTAGNING AV STÖD
A. Placera dragflikarna på stödsidans sida.
B. Dra bort höger sida av stödet från vänster sida av stödet.
C. Sträck ut stödbensarmarna helt inför nästa användning.

7. MODIFIERING AV REMLÄNGD
A. Kompressionsremmarna kan förlängas eller förkortas. Lyft upp krokänden och justera längden innan du fäster den igen.

8. MODIFIERINGSALTERNATIV
A. Denna produkt kan i hög grad modifieras av en person med expertis. För mer information, besök www.aspenmp.com/education/product-modifications.

AVSEDD ANVÄNDNING
Den avsedda användningen är att begränsa rörelse och ge stabilitet i lumbal-sakralryggen.

INDIKATIONER
Ländryggssmärta, ischias, bäckengördelsmärta, degenerativ disksjukdom, utbuktande eller hernierad disk, spondylolys, spondylolistes, spinal stenos, spondylos (artros/degenerativ ledsjukdom).

KONTRAINDIKATIONER
Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnad orsakad av cirkulationsstörningar. Patienter som inte får bära ortopediskt stöd enligt läkares instruktioner.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
LÄS INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. Korrekt utbildning i användningen av denna enhet bör äga rum innan den tillämpas. Dessa anvisningar är endast riktlinjer och erbjuds inte som medicinska rekommendationer. Om du lider av ett allvarligt medicinskt tillstånd rekommenderar vi starkt att du rådgör med en legitimerad sjukvårdspersonal innan du använder produkten. Korrekt montering krävs för att denna produkt ska vara effektiv. Under vissa omständigheter kan den här produkten ordineras av en läkare. Se den begränsade garantin för ytterligare information.

SKÖTSELRÅD
Handtvätt endast vid 30° C; Tvätta med milt rengöringsmedel; Lufttorka; Använd inte blekmedel eller andra kemikalier.

MATERIAL
Acetal, nylon, HDPE, polyester, elastan, polyakrylat, polyuretan, polyeten, gummi, spandex.

INTE TILLVERKAD MED NATURGUMMILATEX.

BORTSKAFFANDE
Produkten kan kasseras på ett säkert sätt i enlighet med lokala lagar.

RAPPORTERING
Vänligen rapportera alla allvarliga händelser som rör användningen av denna enhet till både den behöriga myndigheten i ditt land och till tillverkaren (listad i detta dokument).

BEGRÄNSAD GARANTI
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterar användaren som ursprungligen köper denna produkt att den är fri från defekter i material och utförande. Aspen Medical Products, LLC: s enda skyldighet i händelse av garantibrott är att reparera eller ersätta den defekta produkten eller delarna.

Aspen Medical Products, LLC har ingen skyldighet enligt denna begränsade garanti i händelse:
(a) Produkten köptes inte från Aspen Medical Products, LLC eller genom dess auktoriserade distributionskanaler;
(b) Produkten har ändrats;
(c) Eventuella delar som inte levererats av Aspen Medical Products, LLC sätts in i produkten; eller
(d) Produktens bruksanvisning används inte i enlighet med Aspen Medical Products, LLC.

FÖREGÅENDE ÄR DET ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRDEN FÖR FEL I TJÄNSTEN AV ELLER FEL I PRODUKTEN. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC FÅR INTE ANSVARAS UNDER DENNA ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR EVENTUELLA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR. DENNA GARANTI ERSÄTTER ALLA ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ANVÄNDNING, OCH ALLA FÖRPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRÅN ASPEN MEDICAL PRODUCTS FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I FÖRBINDELSE MED ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTERNA, VILKA HÄRMED AVVISAS OCH EXKLUDERAS AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från plats till plats.

En lista över auktoriserade distributörer i ditt område är tillgänglig på begäran.

РУССКИЙ

1. РАЗМЕРЫ И РЕГУЛИРОВКА
A. Измерьте окружность талии и бедер и выберите подходящий размер бандажа.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ		
РАЗМЕР	**ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ**	
Маленький	31 - 37 in	78.74 cm - 93.98 cm
Средний	36 - 48 in	91.44 cm - 121.92 cm
Большой	47 - 68 in	119.38 cm - 172.72 cm

B. Чтобы изменить размер ремня, приподнимите внутренний конец боковой панели с каждой стороны. Отрегулируйте панель, чтобы добиться правильной посадки, и снова зафиксируйте.

2. ПОДГОТОВКА
A. Расположите фиксаторы на расстоянии 2 дюймов (5,1 см) от задней панели бандажа. Потяните концы бандажа в разные стороны, убедившись, что он полностью растянут.

(ТОЛЬКО ДЛЯ POPPLE 637 LSO)
B. Полностью растянув бандаж, разместите каждую боковую панель на середине боковой части бандажа. Нажмите, чтобы зафиксировать бандаж.
C. Если бандаж правильно подогнан к пациенту, боковые панели должны находиться по бокам пациента.

3. НАЛОЖЕНИЕ
A. Полностью раскройте бандаж и расположите его так, чтобы задняя панель находилась по центру в нижней части позвоночника.
B. Наложите бандаж вокруг живота так, чтобы правая сторона перекрывала левую.

4. ЗАТЯГИВАНИЕ
A. Проденьте большие пальцы в отверстия в фиксаторах. Потяните их. При необходимости отрегулируйте сжатие.
B. После затягивания снова закрепите фиксаторы на бандаже.

5. РЕГУЛИРОВКА
A. Отрегулируйте степень поддержки, ослабляя или затягивая фиксаторы по мере необходимости.

6. СНЯТИЕ БАНДАЖА
A. Разместите фиксаторы по бокам бандажа.
B. Снимите правую сторону бандажа с левой.
C. Полностью выдвиньте рычаги бандажа так, чтобы подготовить их к следующему использованию.

7. ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ РЕМНЯ
A. Компрессионные ремни можно сделать длиннее или короче. Поднимите конец крючка и отрегулируйте длину, прежде чем прикрепить его обратно.

8. ВАРИАНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ
A. Специалист может значительно модифицировать данное изделие.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.aspenmp.com/education/product-modifications.

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Предназначен для ограничения подвижности и обеспечения стабильности грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Боль в пояснице, ишиас, боль в тазобедренных суставах, остеохондроз, грыжевое выпячивание или грыжа межпозвоночного диска, спондилолиз, спондилолистез, стеноз позвоночного канала, спондилез (остеоартрит/дегенеративное заболевание суставов).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность или аллергия на любой из материалов, из которых изготовлен бандаж. Отек лимфатической ткани из-за нарушения кровообращения. Пациенты, которым запрещено носить корсет по медицинским показаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
Предварительно необходимо пройти обучение тому, как пользоваться этим устройством. Данные указания являются общими советами, а не медицинскими рекомендациями. Если вы страдаете серьезным заболеванием, мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с квалифицированным медиком перед использованием этого изделия. Чтобы использование данного изделия принесло пользу, требуется его правильная установка. В некоторых случаях данное изделие используется по назначению врача. Дополнительную информацию см. в ограниченной гарантии.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Стирать только вручную при 30°C с мягким моющим средством, сушить на воздухе, не использовать отбеливатели и другие химические вещества.

МАТЕРИАЛЫ
Ацеталь, нейлон, HDPE, полиэстер, эластан, полиакрилат, полиуретан, полиэтилен, резина, спандекс.

НЕ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА.

УТИЛИЗАЦИЯ
Товар можно утилизировать в соответствии с местными правилами.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНЦИДЕНТАХ
О любых серьезных инцидентах, связанных с использованием данного устройства, следует сообщать как в компетентный орган вашего штата, так и производителю (указанному в этом документе).

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Компания Aspen Medical Products, LLC, Ирвин, Калифорния, 92618, гарантирует пользователю, который первоначально приобрел данный продукт, отсутствие в нем дефектов материалов и изготовления. Единственным обязательством Aspen Medical Products, LLC в случае нарушения гарантии является ремонт или замена дефектного изделия или его части.

Aspen Medical Products, LLC не несет обязательств по данной ограниченной гарантии, если:
(a) продукт не был приобретен у Aspen Medical Products, LLC или через официальные каналы продаж;
(b) в продукт были внесены изменения;
(c) в продукт были добавлены детали, не поставляемые Aspen Medical Products, LLC;
(d) продукт не используется в соответствии с Инструкциями по применению Aspen Medical Products, LLC.

ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ ДЕФЕКТА ИЗДЕЛИЯ. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC В РАМКАХ ДАННОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СО СТОРОНЫ ASPEN MEDICAL PRODUCTS В ОТНОШЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЙ; ТАКИМ ОБРАЗОМ, ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ НИХ И СНИМАЕТ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Данная гарантия дает вам определенные юридические права. Также вы можете обладать и другими правами, которые варьируются в зависимости от местоположения.

Список официальных дистрибьюторов в вашем регионе можно получить по запросу.

PORTUGUÊS

1. REGULAGEM E AJUSTE
A. Selecione o tamanho adequado da órtese medindo ao redor da cintura.

GUIA DE TAMANHO		
TAMANHO	**CIRCUNFERÊNCIA**	
P	31 - 37 pol	78.74 cm - 93.98 cm
M	36 - 48 pol	91.44 cm - 121.92 cm
G	47 - 68 pol	119.38 cm - 172.72 cm

B. Para alterar o tamanho da cinta, solte a extremidade interior do painel lateral em ambos os lados. Ajuste até o tamanho adequado e prenda outra vez.

2. PREPARAÇÃO
A. Coloque as linguetas a 2 pol (5.1 cm) do painel traseiro da órtese. Puxe as extremidades da cinta em direções opostas até que a mesma esteja completamente estendida.

(SOMENTE POPPLE 637 LSO)
B. Com a órtese totalmente estendida, coloque um dos painéis laterais sobre a linha média em cada lado da órtese. Pressione para baixo para fixar a órtese.
C. Quando a órtese estiver na posição correta no(a) paciente, os painéis laterais deverão encaixar na linha média do(a) paciente.

3. APLICAÇÃO
A. Coloque a órtese totalmente estendida, de forma que o painel traseiro fique centralizado e na parte inferior das costas.
B. Coloque a órtese para apoiar o abdômen, com a parte direita sobre a esquerda.

4. APERTANDO
A. Passe seus polegares por dentro das linguetas. Puxe-as para fora, afastando-as do corpo. Ajuste a compressão conforme necessário.
B. Ao alcançar a compressão desejada, prenda as linguetas novamente na órtese.

5. AJUSTE
A. Ajuste o suporte afrouxando ou apertando as linguetas conforme necessário.

6. REMOÇÃO DA ÓRTESE
A. Coloque as linguetas na lateral da órtese.
B. Separe o lado direito da órtese do lado esquerdo.
C. Estenda totalmente os braços da órtese em preparação para o próximo uso.

7. MODIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DA TIRA
A. As tiras de compressão podem ser alongadas ou encurtadas. Levante a extremidade do velcro e ajuste o comprimento antes de prendê-lo novamente.

8. OPÇÕES DE MODIFICAÇÃO
A. Este produto pode ser substancialmente modificado por alguém com experiência. Para obter mais informações, visite www.aspenmp.com/education/product-modifications.

USO PRETENDIDO
O uso pretendido é fornecer restrição de movimentos e estabilidade da coluna lombossacra.

INDICAÇÕES
Dor lombar, ciática, dor na cintura pélvica, doença degenerativa do disco, disco protuberante ou herniado, espondilólise, espondilolistese, estenose espinhal, espondilose (osteoartrite/doença articular degenerativa).

CONTRAINDICAÇÕES
Hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos materiais com os quais a órtese é feita. Inchaço do tecido linfático causado por distúrbios circulatórios. Pacientes que não podem usar uma órtese de acordo com instruções médicas.

PRECAUÇÕES
LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. O treinamento adequado sobre o uso deste dispositivo deve ocorrer antes de ser aplicado. Estas instruções são apenas diretrizes e não são disponibilizadas como recomendações médicas. Se você sofrer de uma séria condição médica, sugerimos que consulte um profissional de saúde licenciado antes de usar este produto. É necessário acompanhamento adequado para que este produto seja eficaz. Em algumas circunstâncias, este produto pode ser prescrito por um médico. Consulte a garantia limitada para obter mais informações a esse respeito.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS
Lavar à mão apenas a 30°C; lave com detergente neutro; seque ao ar livre; não use água sanitária ou outros produtos químicos.

MATERIAIS
Acetal, Nylon, HDPE, Poliéster, Elastano, Poliacrilato, Poliuretano, Polietileno, Borracha, Spandex.

NÃO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.

DESCARTE
O produto pode ser descartado com segurança de acordo com as leis locais.

INFORMES
Informe qualquer incidente grave envolvendo o uso deste dispositivo à autoridade competente em seu estado e ao fabricante (listado neste documento).

GARANTIA LIMITADA
A Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garante ao usuário que originalmente compra este produto que ele está livre de defeitos de material e mão de obra. A única obrigação da Aspen Medical Products, LLC, no caso de violação da garantia, será a reparação ou substituição do(s) produto(s) defeituoso(s).

A Aspen Medical Products, LLC, não terá nenhuma obrigação sob esta garantia limitada caso:
(a) O produto não tenha sido comprado da Aspen Medical Products, LLC, nem de seus canais de distribuição autorizados;
(b) O produto seja alterado;
(c) Quaisquer peças não fornecidas pela Aspen Medical Products, LLC, sejam inseridas no produto; ou
(d) O produto não seja usado de acordo com as instruções de uso de produtos médicos da Aspen Medical Products, LLC.

O ANTECEDENTE É O ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO PARA FALHA NO SERVIÇO OU DEFEITO NO PRODUTO. A ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC, NÃO DEVE SER RESPONSABILIZADA SOB ESTA OU QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO A GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU USO E TODAS AS OBRIGAÇÕES OU RESPONSABILIDADES POR PARTE DA ASPEN MEDICAL PRODUTOS POR DANOS DECORRENTES OU RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS, QUE SÃO REJEITADOS E EXCLUÍDOS PELA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você pode ter outros direitos que variam de local para local.

Uma lista de distribuidores autorizados em sua área está disponível mediante solicitação.

中文

1. 尺寸调整
A. 测量腰部周围的尺寸以选择合适的矫正器尺寸。

尺寸调整指南		
尺寸	**周长**	
小号	31 至 37 英寸	78.74 至 93.98 厘米
中号	36 至 48 英寸	91.44 至 121.92 厘米
大号	47 至 68 英寸	119.38 至 172.72 厘米

B. 如要调整皮带的尺寸，请将每侧的侧面板内端向上揭开。将其调整至合适状态并重新固定。

2. 准备
A. 将拉环放置在距离矫正器后面板 2 英寸（5.1 厘米）的位置。将皮带的两端向两侧拉，确保其完全伸展。

(仅限 POPPLE 637 LSO)
B. 在矫正器完全展开的情况下，在矫正器每一侧板上的中线放置一个侧面板。按下以固定矫正器。
C. 当矫正器正确地适合患者时，侧面板应贴合在患者的中线位置。

3. 应用
A. 使用完全展开的矫正器，确保背板位于背部中央靠下处。
B. 将矫正器佩戴在腹部，右侧覆盖左侧。

4. 收紧
A. 将双手拇指放入拉环的孔内。向远离身体的方向拉。根据需要调整压缩量。
B. 拧紧后，将拉环固定回矫正器上。

5. 调整
A. 根据需要松开或拧紧拉环来调整支撑。

6. 拆除矫正器
A. 将拉环放在矫正器的一侧。
B. 将矫正器的右侧从矫正器的左侧剥离。
C. 将矫正器的臂部完全展开，为下次使用做好准备。

7. 压缩带长度调整
A. 压缩带可以加长或缩短。剥开挂钩末端并调整长度，然后再放回原位。

8. 调整选项
A. 本产品可由具备专业经验的人员进行重大调整。如需了解更多信息，请访问 www.aspenmp.com/education/product-modifications。

预期用途
其预期用途是限制腰部和骶骨部位的活动，并提供稳定性。

适应症
腰痛、坐骨神经痛、骨盆带疼痛、退行性椎间盘疾病、椎间盘突出或脱出、脊椎裂、脊椎滑脱、椎管狭窄、脊椎病（骨关节炎/退行性关节病）。

禁忌症
对制造矫正器的任何材料存在过敏反应或过敏症。循环系统紊乱引起的淋巴组织肿胀。根据医嘱不可穿戴矫正器的患者。

注意事项
使用前请阅读说明。在使用此装置前，应进行使用装置的正确培训。这些指示仅作为指南，并不作为医学建议提供。如果您患有严重疾病，我们强烈建议您在使用本产品之前咨询有执照的医疗保健专业人士。要使本产品有效，必须正确贴身。在某些情况下，医生可能会在处方中要求使用本产品。请参阅有限保证以了解更多信息。

保养说明
仅在 30°C 的温度中手洗；用温和的洗涤剂洗涤；晾干；请勿使用漂白剂或其他化学品。

材料
乙缩醛、尼龙、HDPE、聚酯纤维、氨纶、聚丙烯酸酯、聚氨酯、聚乙烯、橡胶、氨纶 。

并非采用天然胶乳制造。

处置
可根据当地法律以安全的方式处置产品。

报告
请向您所在州的主管机关和制造商（见本文件中的列表）报告因使用此设备引起的任何严重事件。

有限保证
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 向最初购买此产品的用户保证，此产品不存在材料和生产工艺方面的缺陷。如果违反该保证，Aspen Medical Products，LLC 的唯一责任是修理或更换有缺陷的产品或部件。

在以下情况下，Aspen Medical Products, LLC 不承担此有限保证项下的任何义务：
（a）产品不是从 Aspen Medical Products, LLC 或其授权分销渠道购买；
（b）产品已被更改；
（c）产品中置入了并非由 Aspen Medical Products, LLC 提供的任何部件；或者
（d）未按照 Aspen Medical Products，LLC 的《使用说明》使用此产品。

若产品存在故障或缺陷，上述规定的责任是唯一和排他性的补救措施。对于任何直接、特殊、偶发或继发的损失，ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC 概不承担本保证或任何默示保证项下的责任。本保证替代所有其他明示或默示保证，包括关于适销性或特定目的适合性的保证，以及 ASPEN MEDICAL PRODUCTS 关于因产品的使用引起或相关的损害而产生的所有义务或责任。ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC 在此否认和排除所有该等保证、义务和责任。

本保证赋予您特定的法律权利，并且您可能还享有其他权利，这些权利因地而异。

您可以索取您所在地区的授权分销商名单。