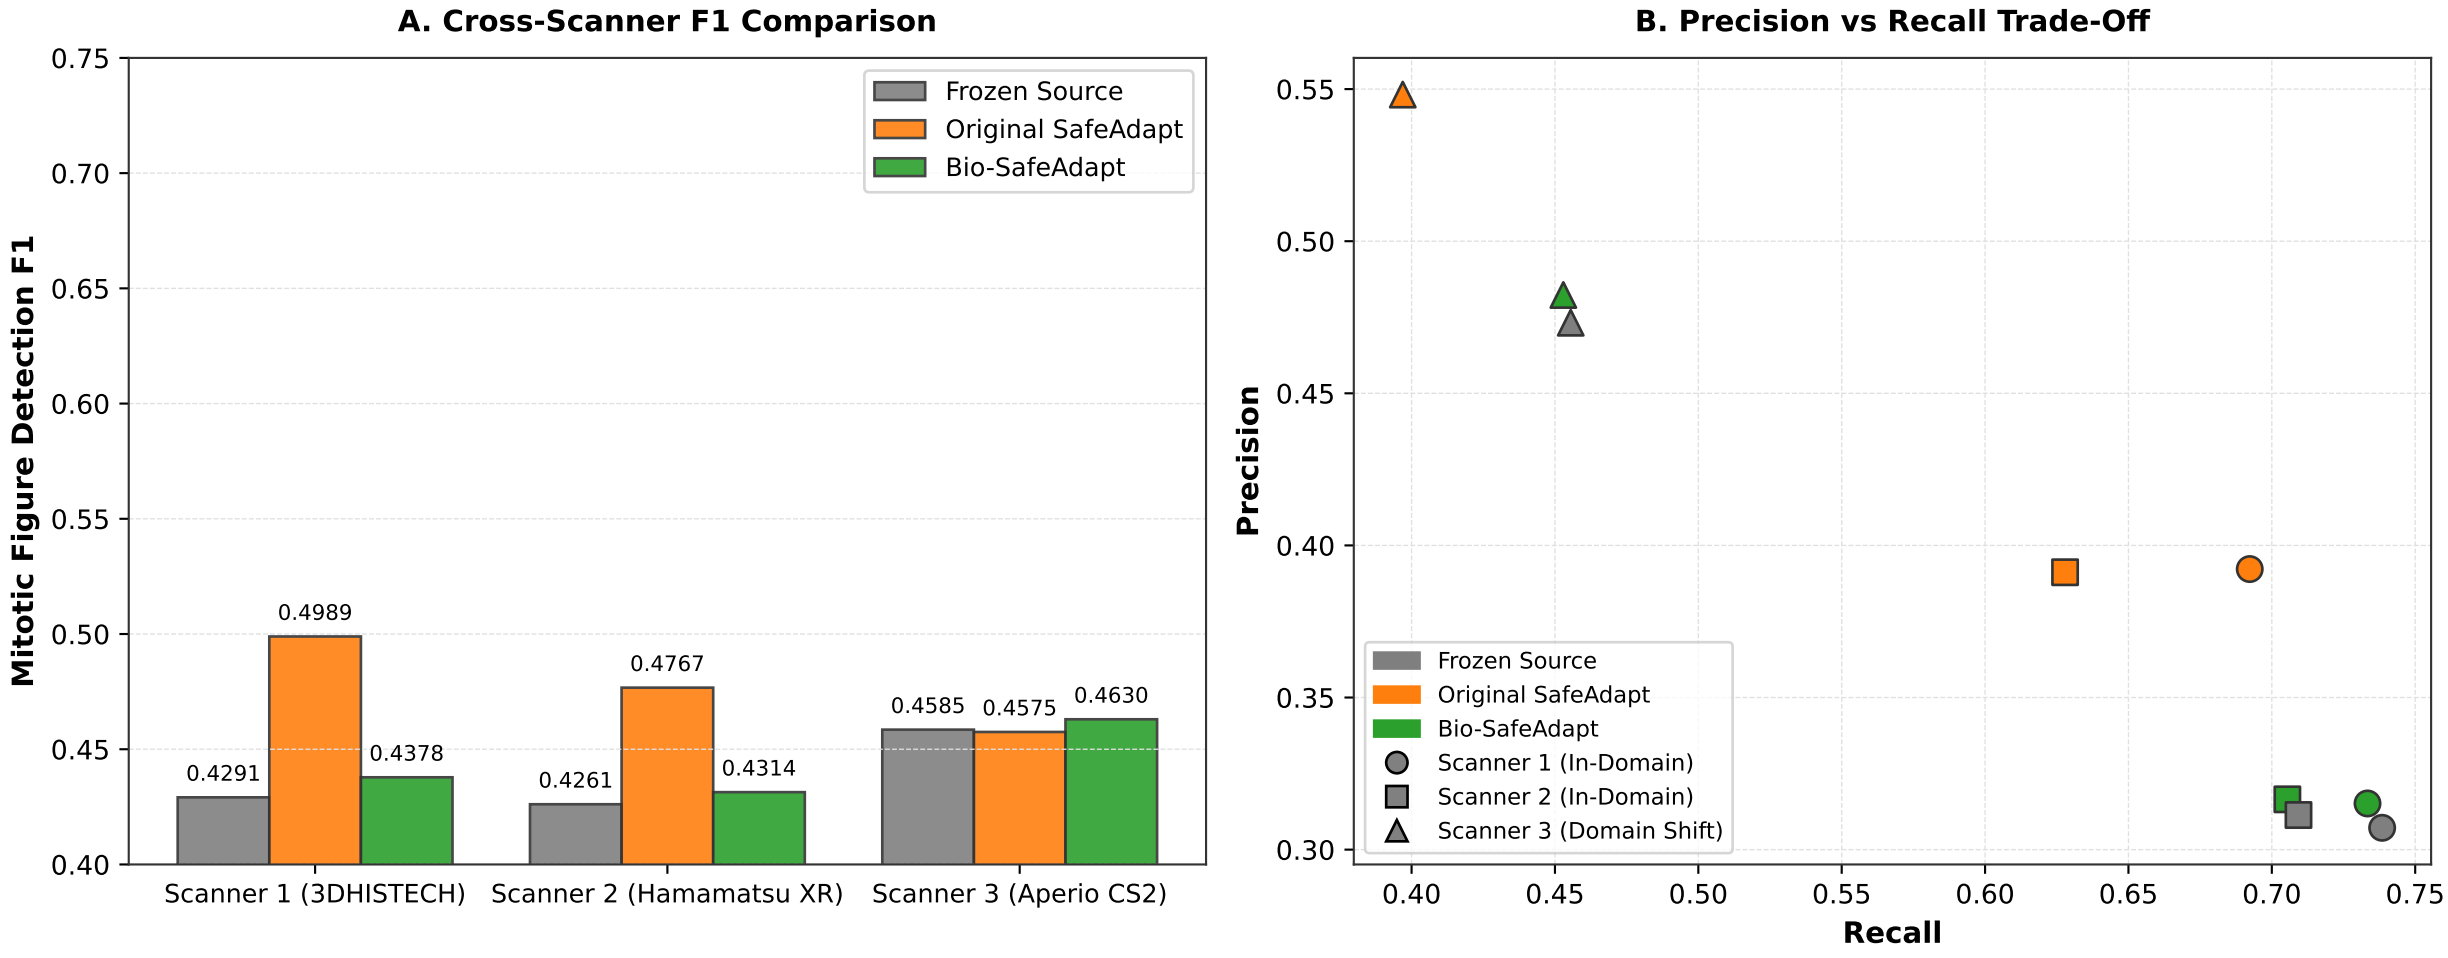
A. Cross-Scanner F1 Comparison
Mitotic Figure Detection F1
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
Frozen Source
Original SafeAdapt
Bio-SafeAdapt
0.4291
0.4989
0.4378
0.4261
0.4767
0.4314
0.4585
0.4575
0.4630
Scanner 1 (3DHISTECH)
Scanner 2 (Hamamatsu XR)
Scanner 3 (Aperio CS2)
B. Precision vs Recall Trade-Off
Precision
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
Frozen Source
Original SafeAdapt
Bio-SafeAdapt
Scanner 1 (In-Domain)
Scanner 2 (In-Domain)
Scanner 3 (Domain Shift)
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
Recall