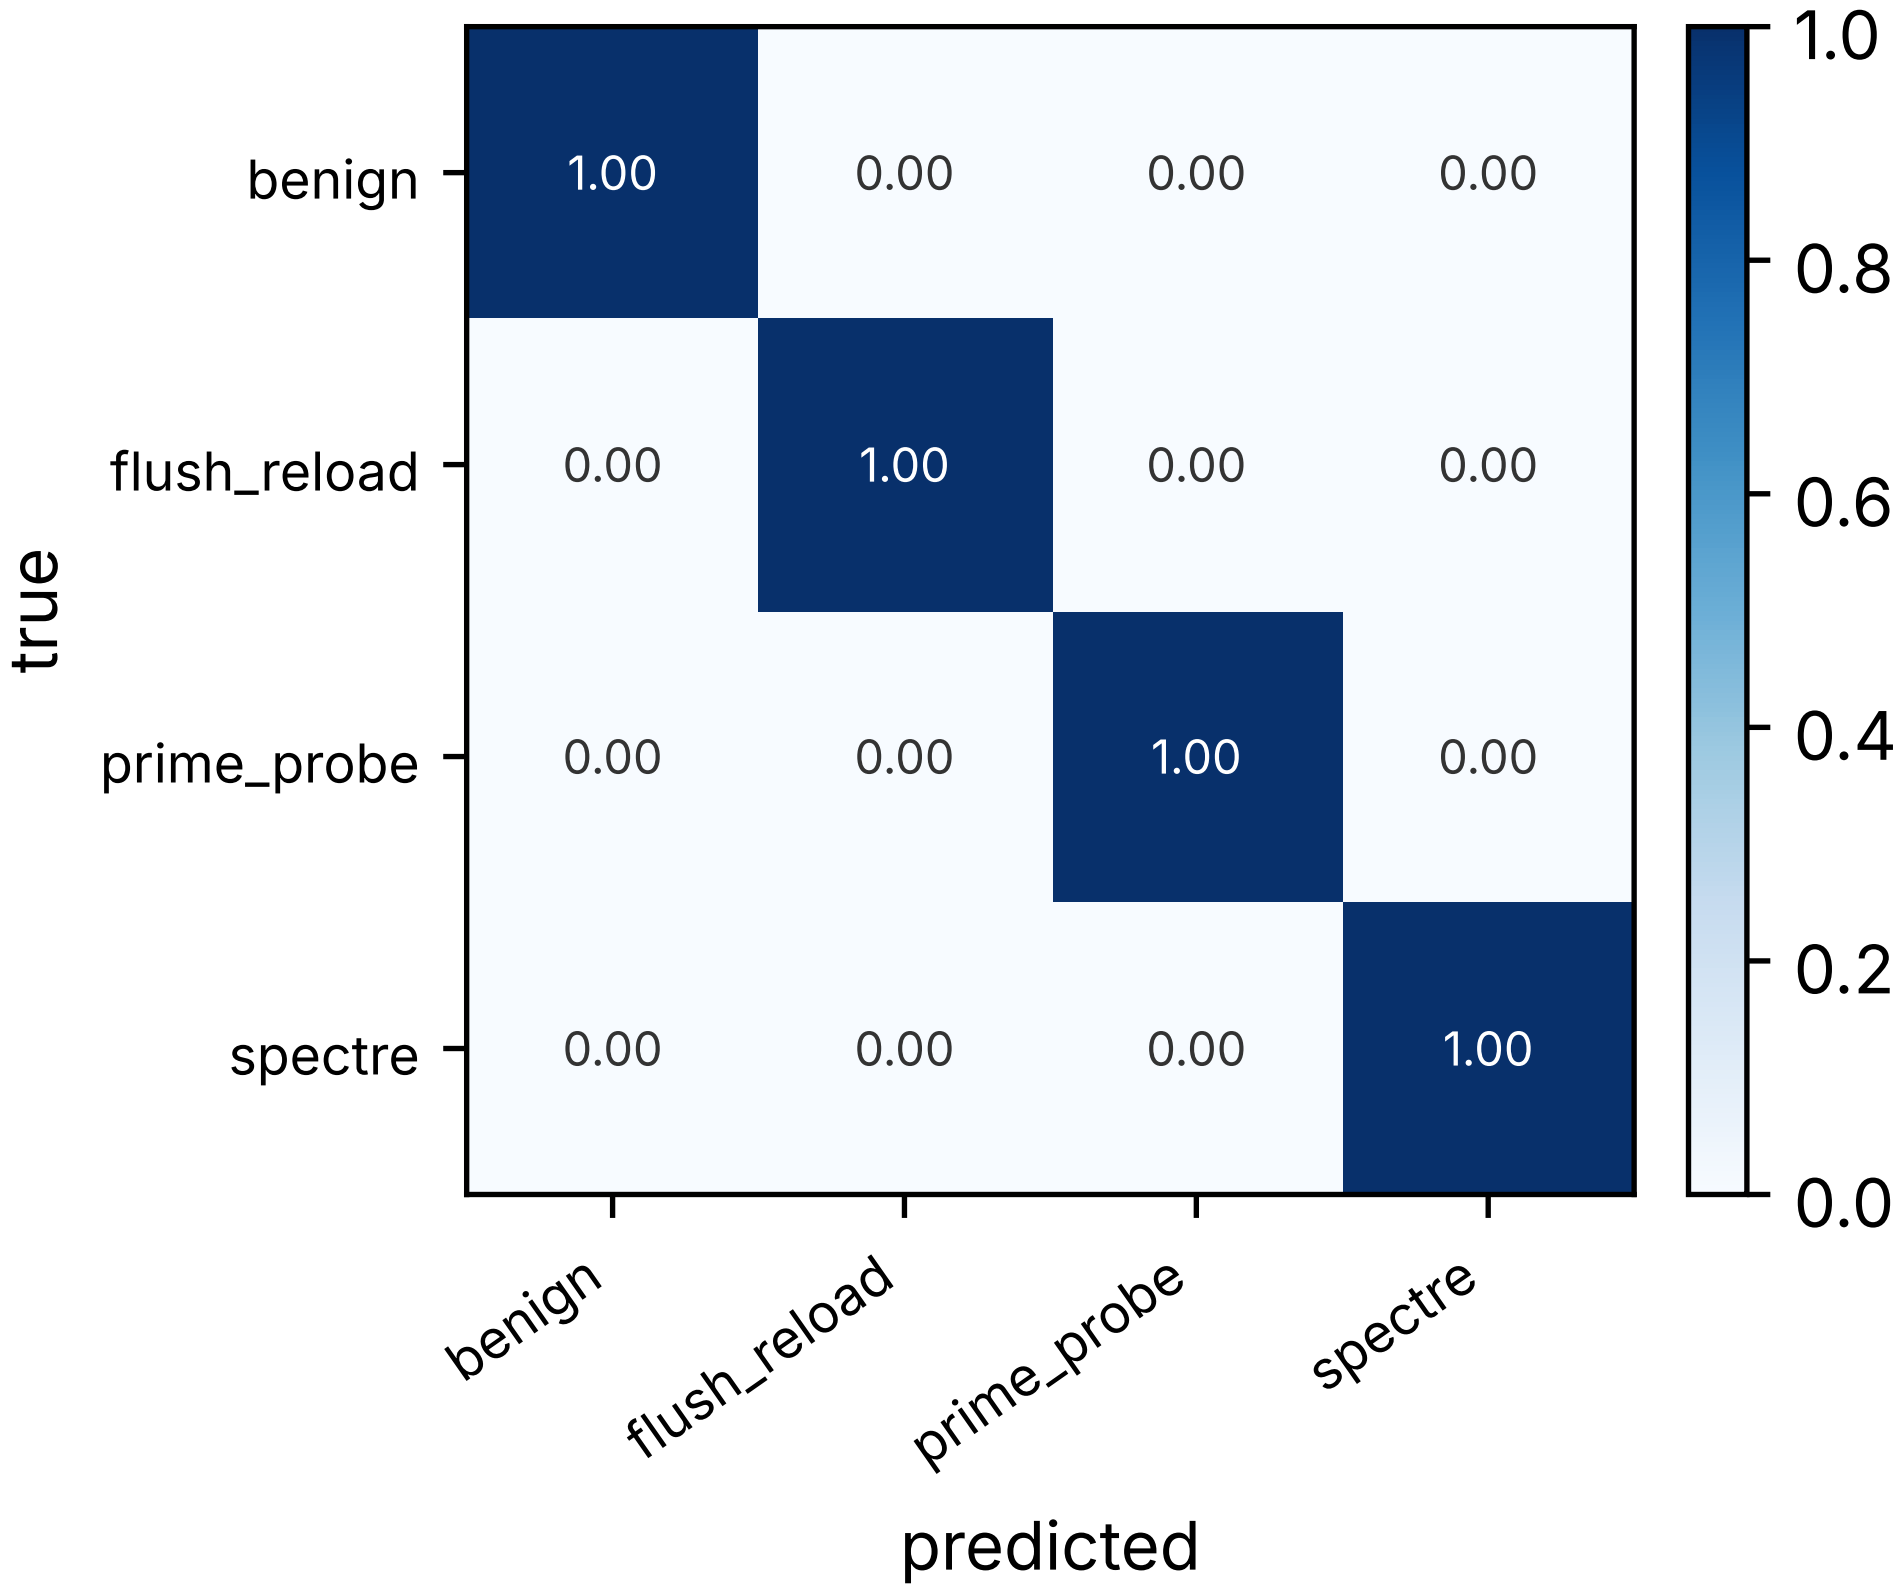
benign
flush_reload
prime_probe
spectre
true
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
benign
flush_reload
prime_probe
spectre
predicted
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0