

Strep A Rapid Test

התקן משולב לבדיקה מיידית של דלקת גרון

BMT
Diagnostics

2 הסר את מכסה האלומיניום



BMT
Diagnostics

1 הוצא את מגש המבחנות



BMT
Diagnostics

4 הסר את הפקק מהתקן הבדיקה



BMT
Diagnostics

3 הוצא את התקן הבדיקה מהאריזה




ביצוע הבדיקה

6



5

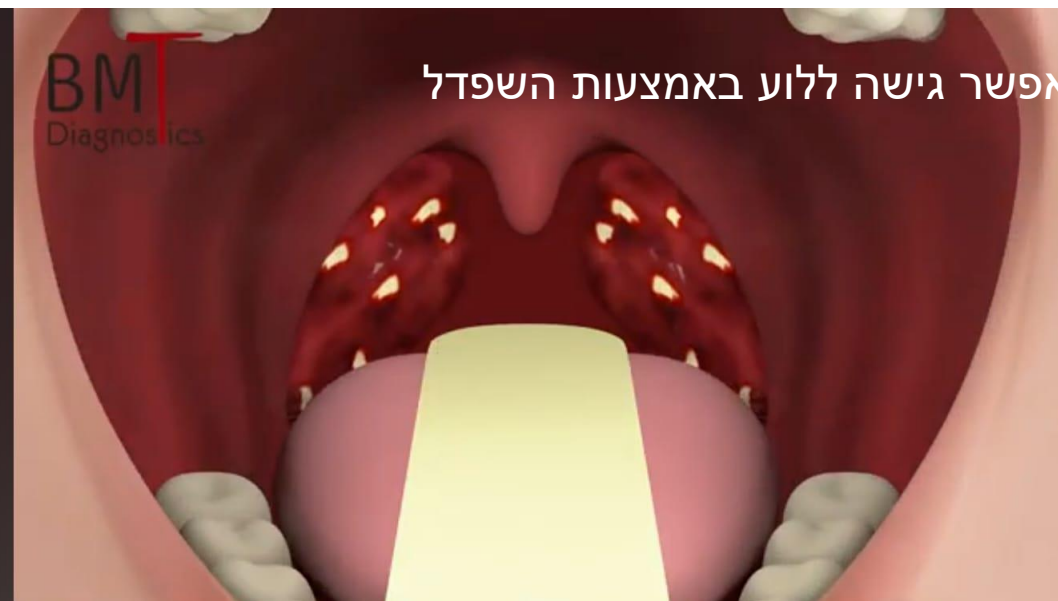

8



7



קריאת התוצאה

קרא את תוצאת הבדיקה

חכה 5 דקות לקריאת התוצאה



9

BMT Diagnostics



5:00

8