

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Pressões

DATA DE EMISSÃO

2025-11-06

Certificado nº: LMP20255019392/10

PÁGINA 1 DE 2

CLIENTE

Nome CORK SUPPLY ITALIA S.R.L
Morada Via desderi, 15/E - Asti-piemonte
14100-000 Itália

EQUIPAMENTO CALIBRADO

Designação	Manómetro analógico		
Marca	WIKA	Intervalo de indicação	-1 a 3 bar
Modelo	---	Resolução	0.2 bar
Nº Série	---	Resolução estimada	0.04 bar
Ref Interna	037	Classe	1.6

Estado do equipamento Não foram identificadas condições inadequadas que afetem os resultados.

CONDIÇÕES DO TRABALHO REALIZADO

Local	Porto	Temperatura	(20 ± 2)°C
Anexo Técnico de Acreditação	M0003-1	Humidade	(35 e 65)%hr

DESCRIÇÃO

Calibração segundo documentos normativos:
NP EN 837-1:2003 e LMP P01 02 REV.B1 de 2013-05-31

RASTREABILIDADE

Os resultados apresentados neste certificado estão rastreados a padrões nacionais ou internacionais que realizam as unidades de medição de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI).

INCERTEZA

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor de expansão $k = k'$, o qual para uma distribuição -t com $v_{ef} = v'_{ef}$ graus de liberdade efectivos corresponde a uma probabilidade de expansão de aproximadamente 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02M.

DATA CALIBRAÇÃO

2025-11-06

O IPAC é um dos signatários do Acordo de Reconhecimento Mútuo da EA e do ILAC para calibrações e ensaios.

Técnico



(Pedro Seixas)

Responsável Técnico



(Bruno Frontoura)

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Pressão

DATA DE EMISSÃO

2025-11-06


Certificado nº: LMP20255019392/10

PÁGINA 2 DE 2

RESULTADOS


Equipamento	Erro	k'	V'_{ef}	Incerteza Expandida	Erro
bar	bar			bar	% F.E.
-0.80	0.018	2.01	200	0.033	0.45
0.00	0.000	2.01	200	0.033	0.00
1.00	-0.025	2.01	200	0.033	-0.63
2.00	-0.031	2.01	200	0.033	-0.77
3.00	-0.015	2.01	201	0.033	-0.38

Erro máximo de histerese: 0.008 bar

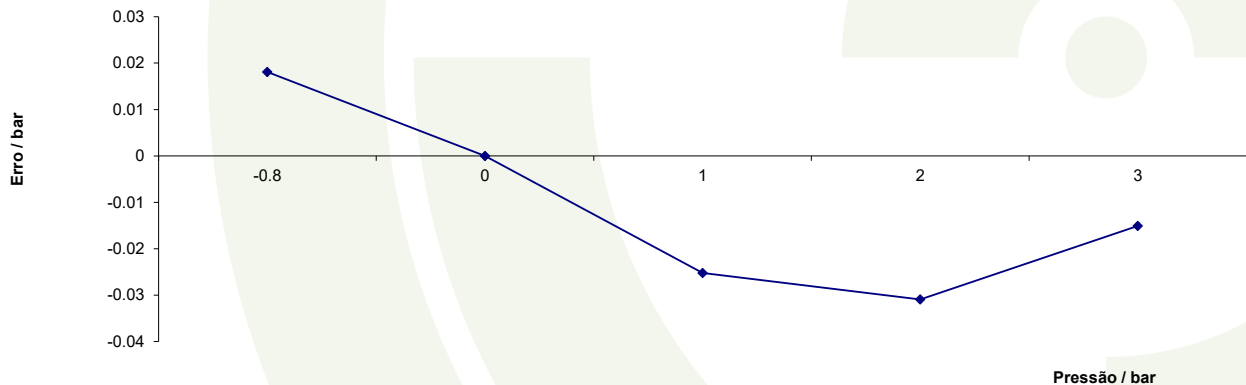


CONDIÇÕES AMBIENTAIS


Temperatura (°C)




Humidade (%hr)



Pressão Atmosférica (bar)



Densidade do Ar (kg.m⁻³)



OBSERVAÇÕES

Pressão gerada com Azoto. O equipamento foi calibrado com o mostrador na vertical.

É considerada a tomada de pressão como a referência do equipamento.

A unidade de pressão de acordo com o sistema internacional de unidades (SI) é o Pascal (1 bar = 100000 Pa).