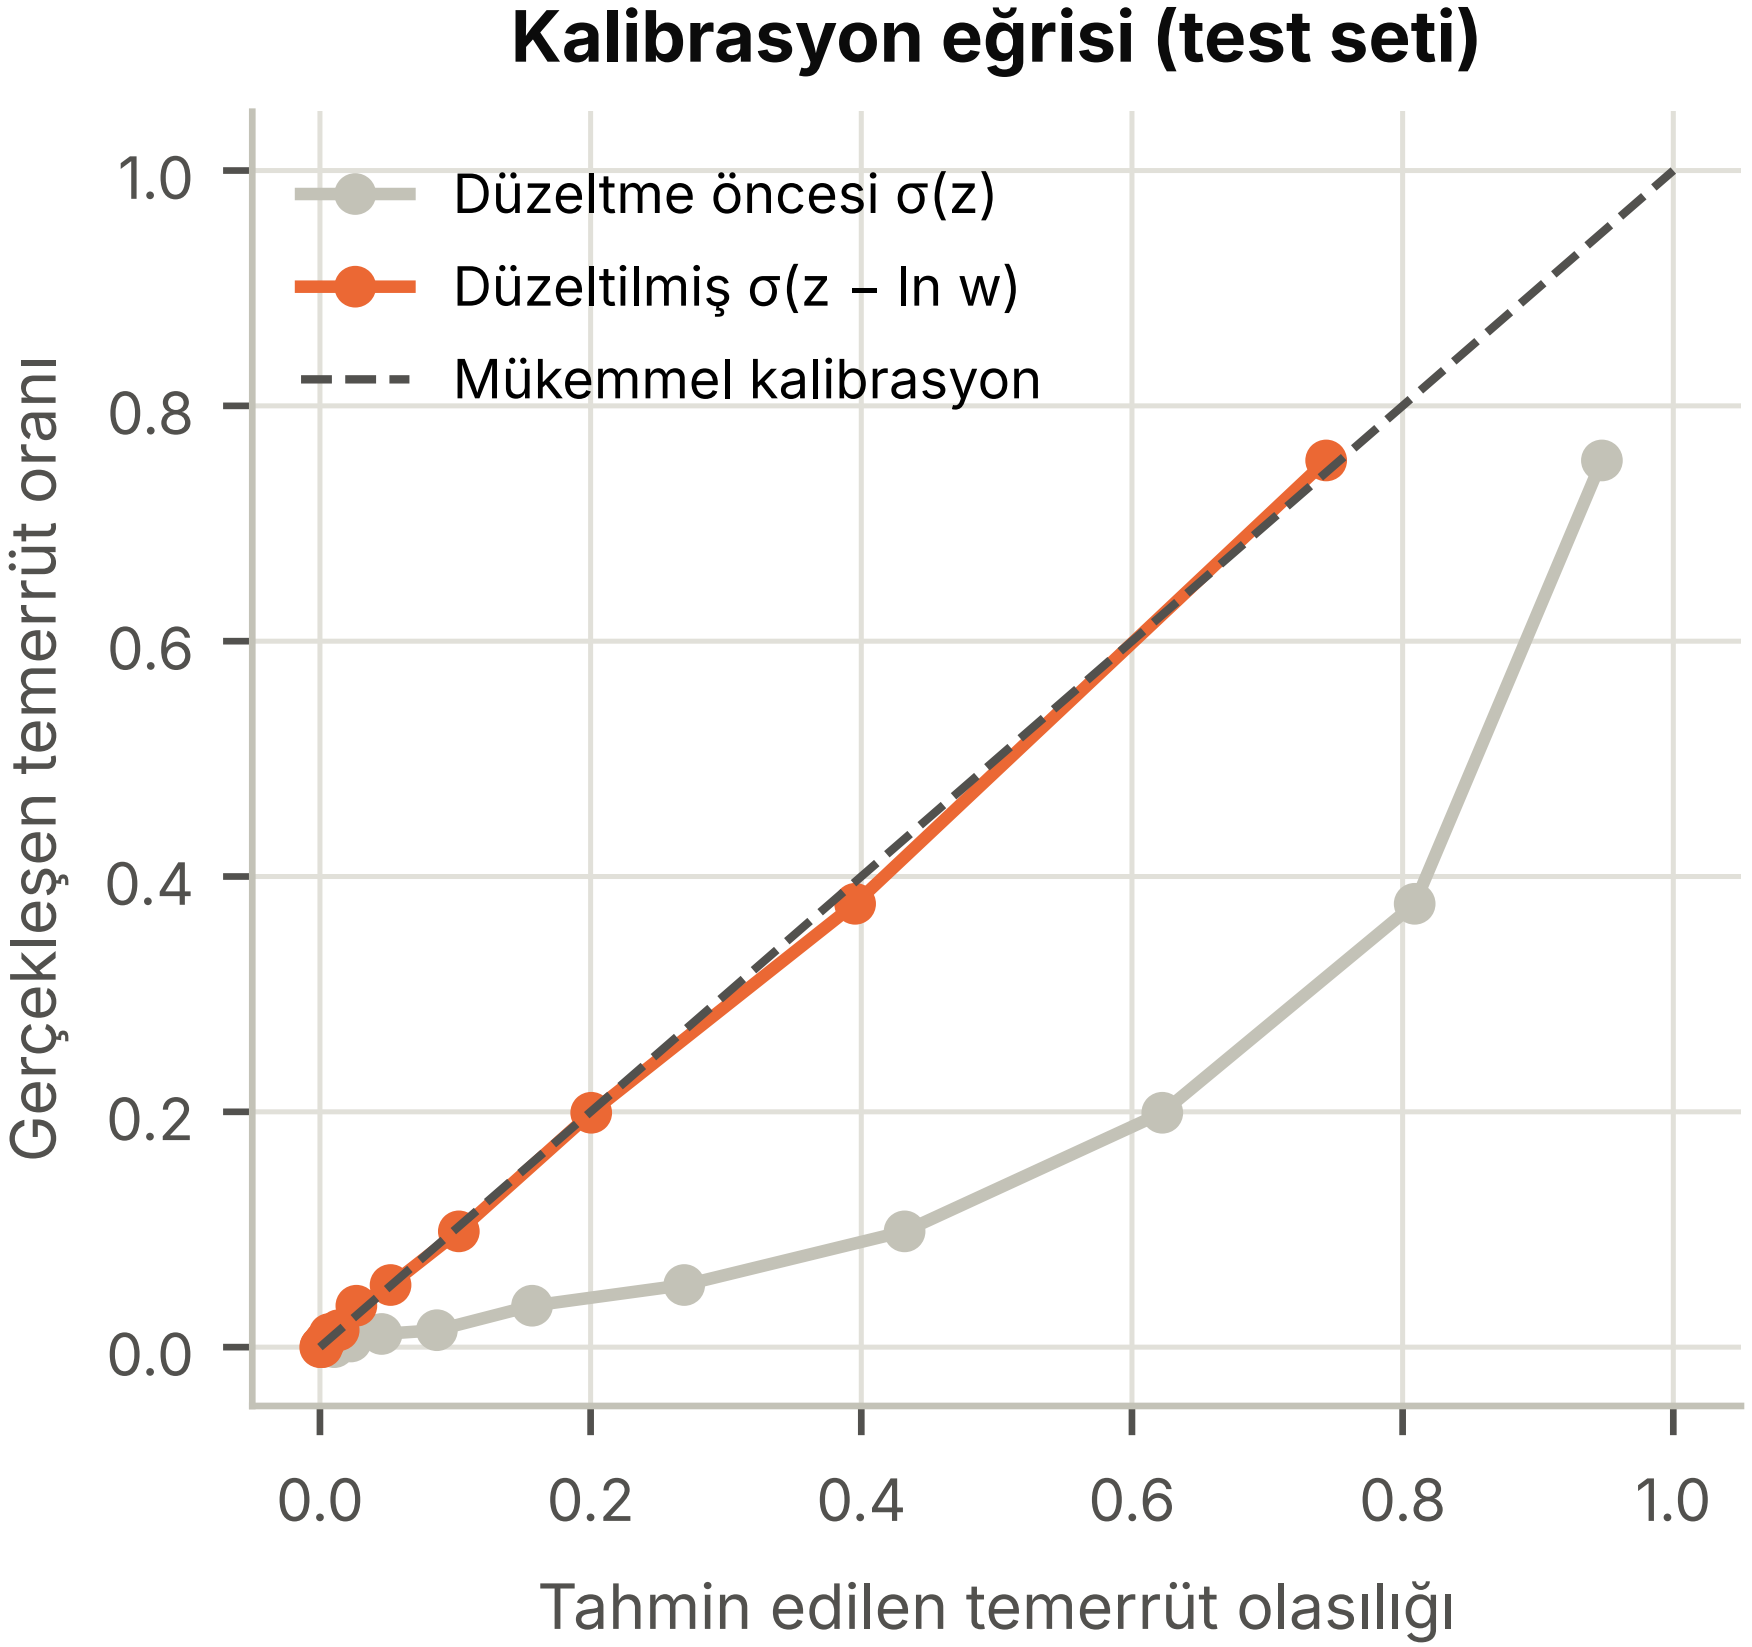
Kalibrasyon eğrisi (test seti)
Düzeltme öncesi σ(z)
Düzeltilmiş σ(z − ln w)
Mükemmel kalibrasyon
Gerçekleşen temerrüt oranı
Tahmin edilen temerrüt olasılığı
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0