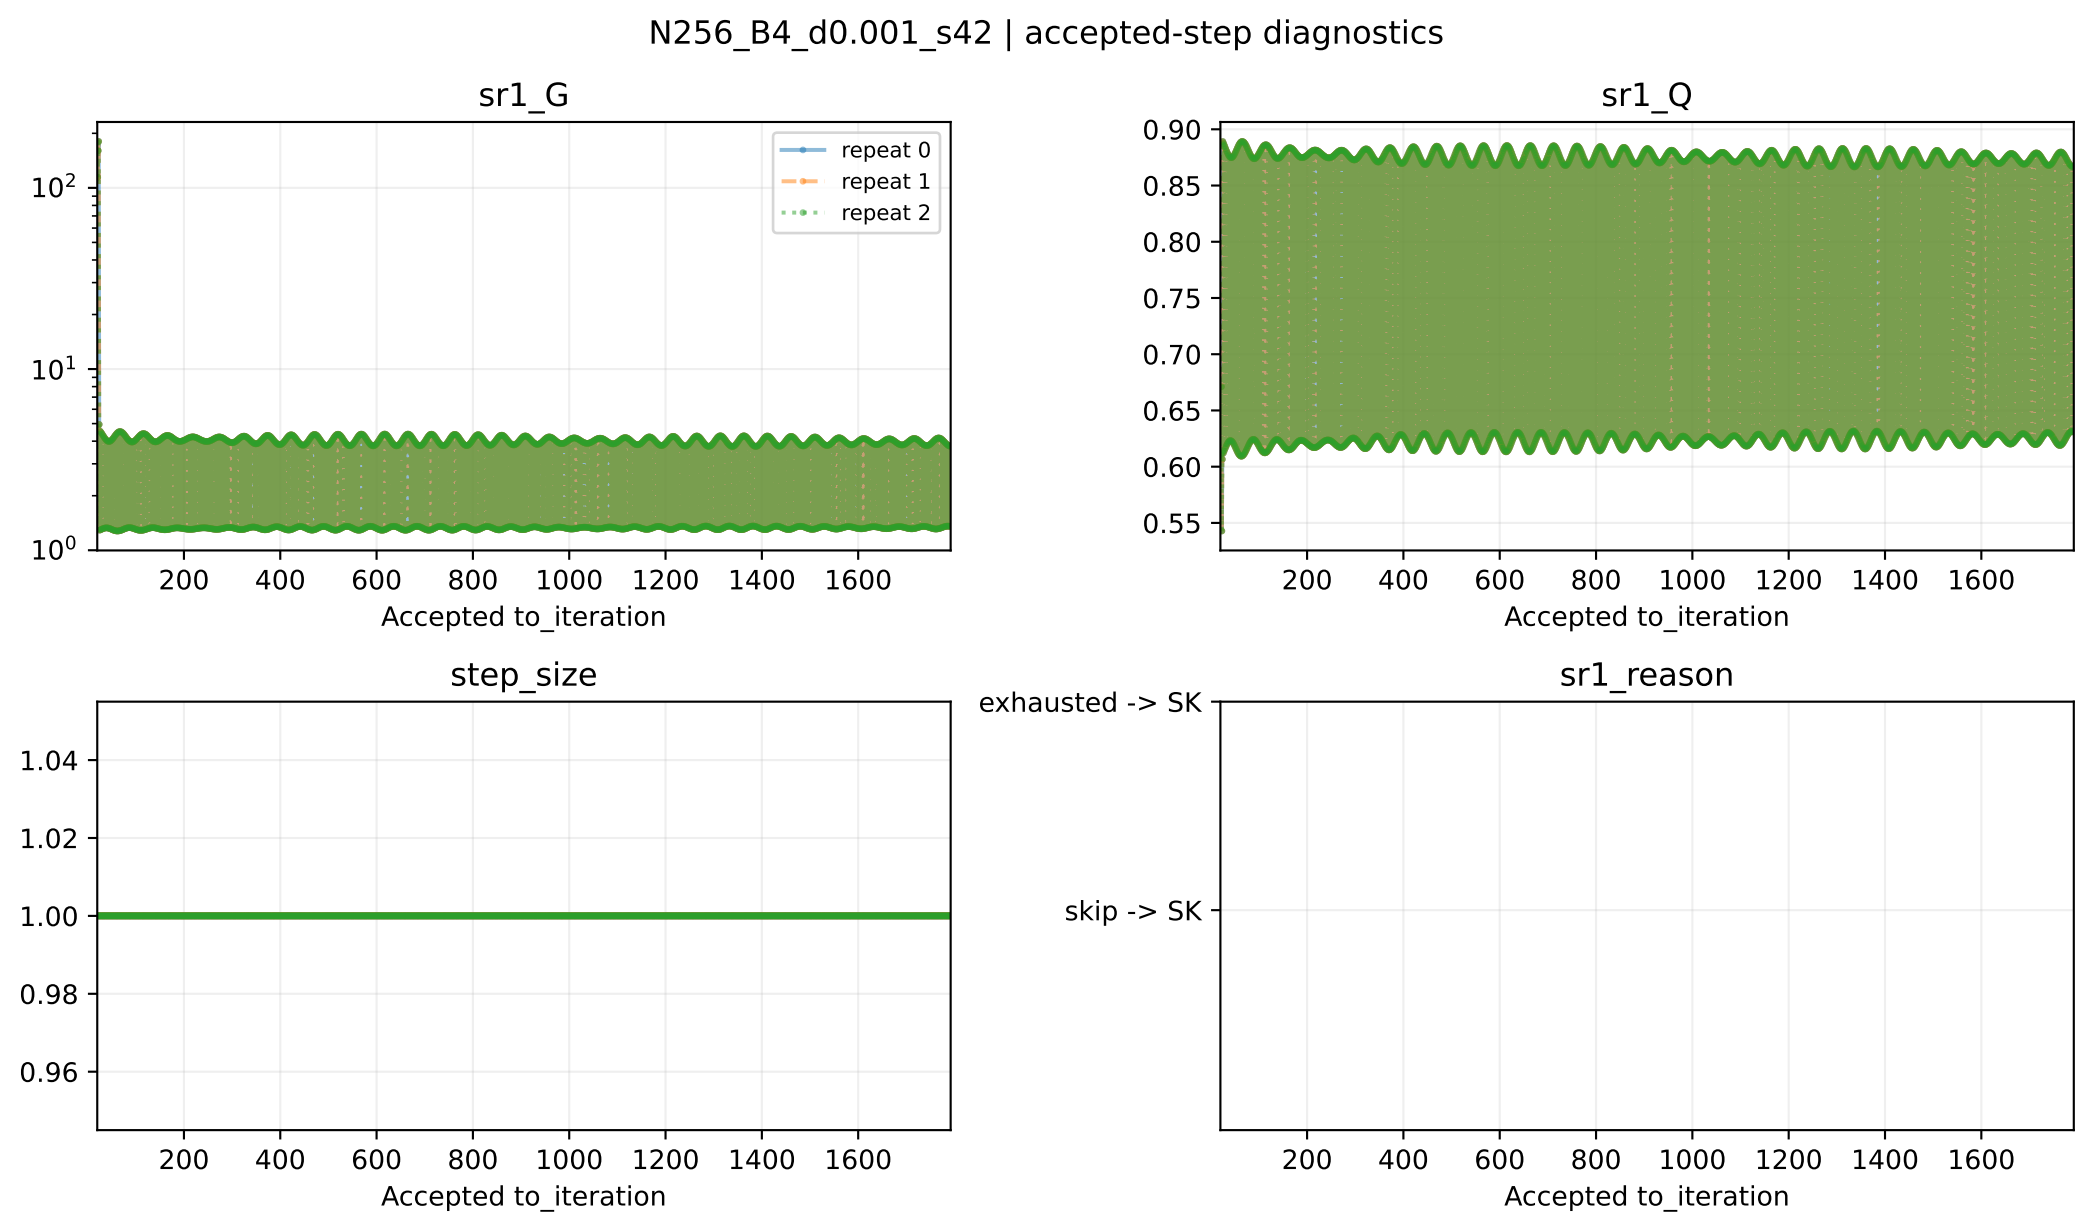

N256_B4_d0.001_s42 | accepted-step diagnostics
sr1_G
repeat 0
repeat 1
repeat 2
10^2
10^1
10^0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Accepted to_iteration
sr1_Q
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Accepted to_iteration
step_size
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Accepted to_iteration
sr1_reason
exhausted -> SK
skip -> SK
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Accepted to_iteration