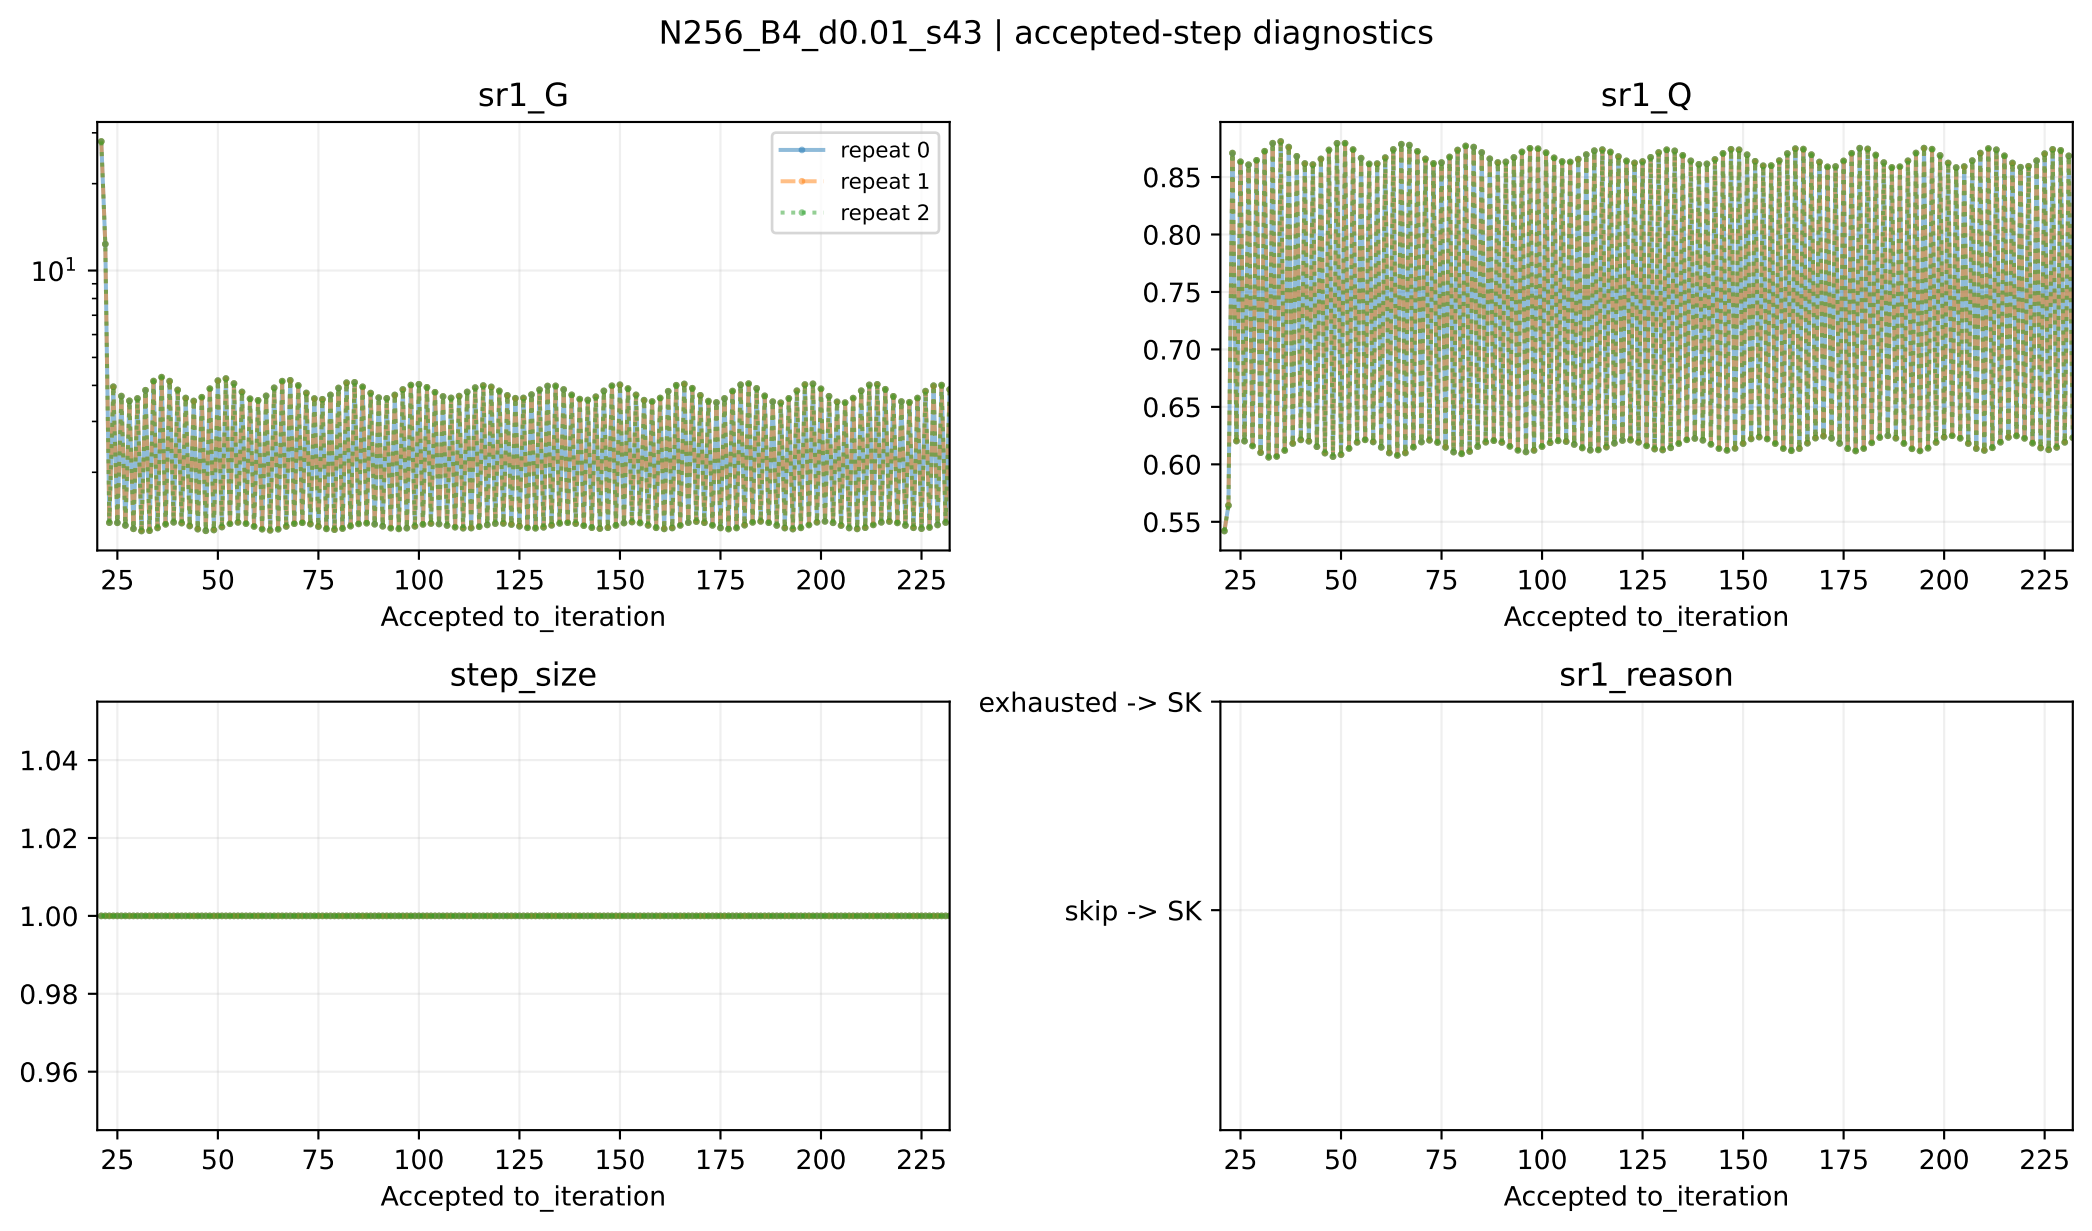
N256_B4_d0.01_s43 | accepted-step diagnostics
sr1_G
repeat 0
repeat 1
repeat 2
10^1
25 50 75 100 125 150 175 200 225
Accepted to_iteration
sr1_Q
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
25 50 75 100 125 150 175 200 225
Accepted to_iteration
step_size
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
25 50 75 100 125 150 175 200 225
Accepted to_iteration
sr1_reason
exhausted -> SK
skip -> SK
25 50 75 100 125 150 175 200 225
Accepted to_iteration