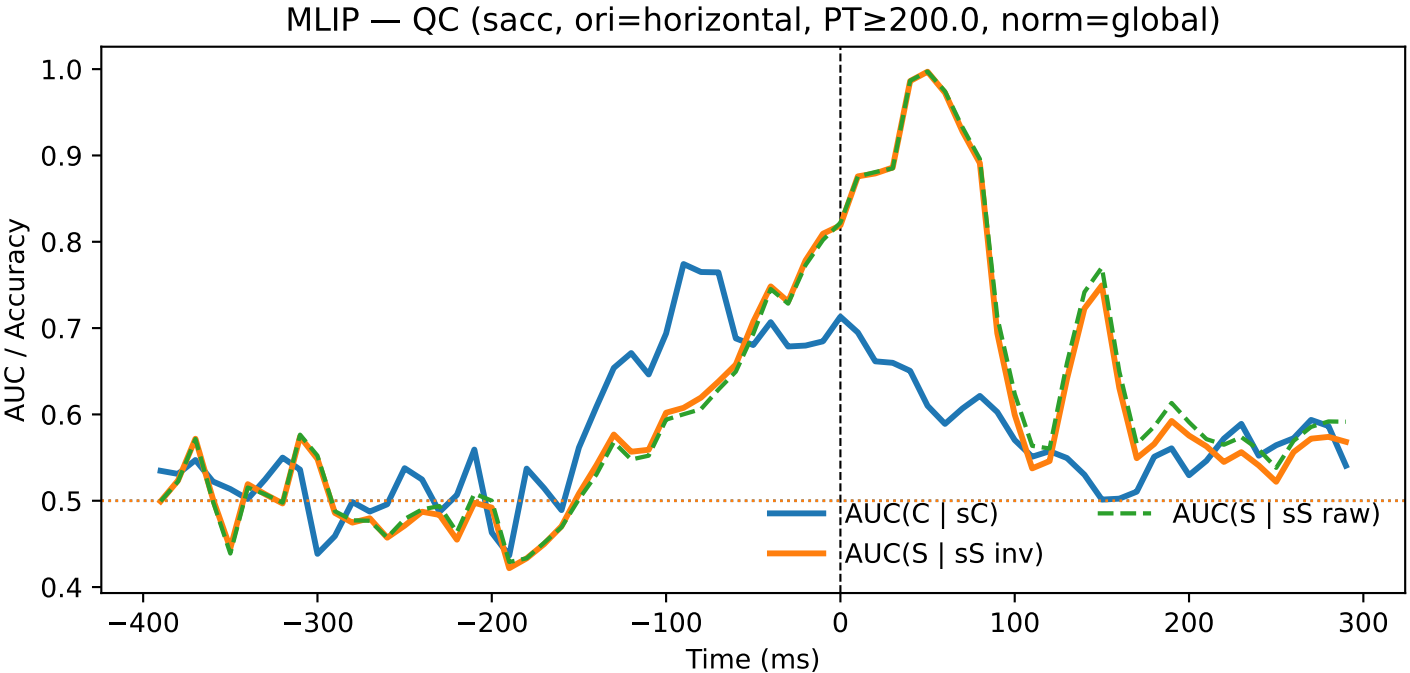
MLIP — QC (sacc, ori=horizontal, PT≥200.0, norm=global)
AUC / Accuracy
Time (ms)
AUC(C | sC)
AUC(S | sS inv)
AUC(S | sS raw)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
−400
−300
−200
−100
0
100
200
300